Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 4424
CALIBRATION DATE: 31-Jul-26

SBE 16plus CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

```
g =  -1.019010e+00
h =   1.382667e-01
i =  -3.642903e-04
j =   4.691311e-05

CPcor = -9.5700e-008
CTcor =  3.2500e-006
```


BATH TEMP (° C)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (S/m)	INSTRUMENT OUTPUT (Hz)	INSTRUMENT COND (S/m)	RESIDUAL (S/m)
22.0000	0.0000	0.00000	2721.10	0.0000	0.00000
1.0000	34.6002	2.95925	5375.72	2.9592	-0.00001
4.5000	34.5801	3.26463	5577.65	3.2646	0.00001
15.0000	34.5371	4.24097	6178.25	4.2410	-0.00000
18.5000	34.5279	4.58422	6375.65	4.5842	-0.00000
24.0000	34.5181	5.13915	6682.12	5.1391	-0.00001
29.0000	34.5121	5.65807	6956.13	5.6581	0.00002
32.5000	34.5088	6.02840	7145.00	6.0284	-0.00001

f = Instrument Output (Hz) / 1000.0

t = temperature (°C); p = pressure (decibars); δ = CTcor; ε = CPcor;

Conductivity (S/m) = $(g + h * f^2 + i * f^3 + j * f^4) / (1 + \delta * t + \varepsilon * p)$

Residual (Siemens/meter) = instrument conductivity - bath conductivity

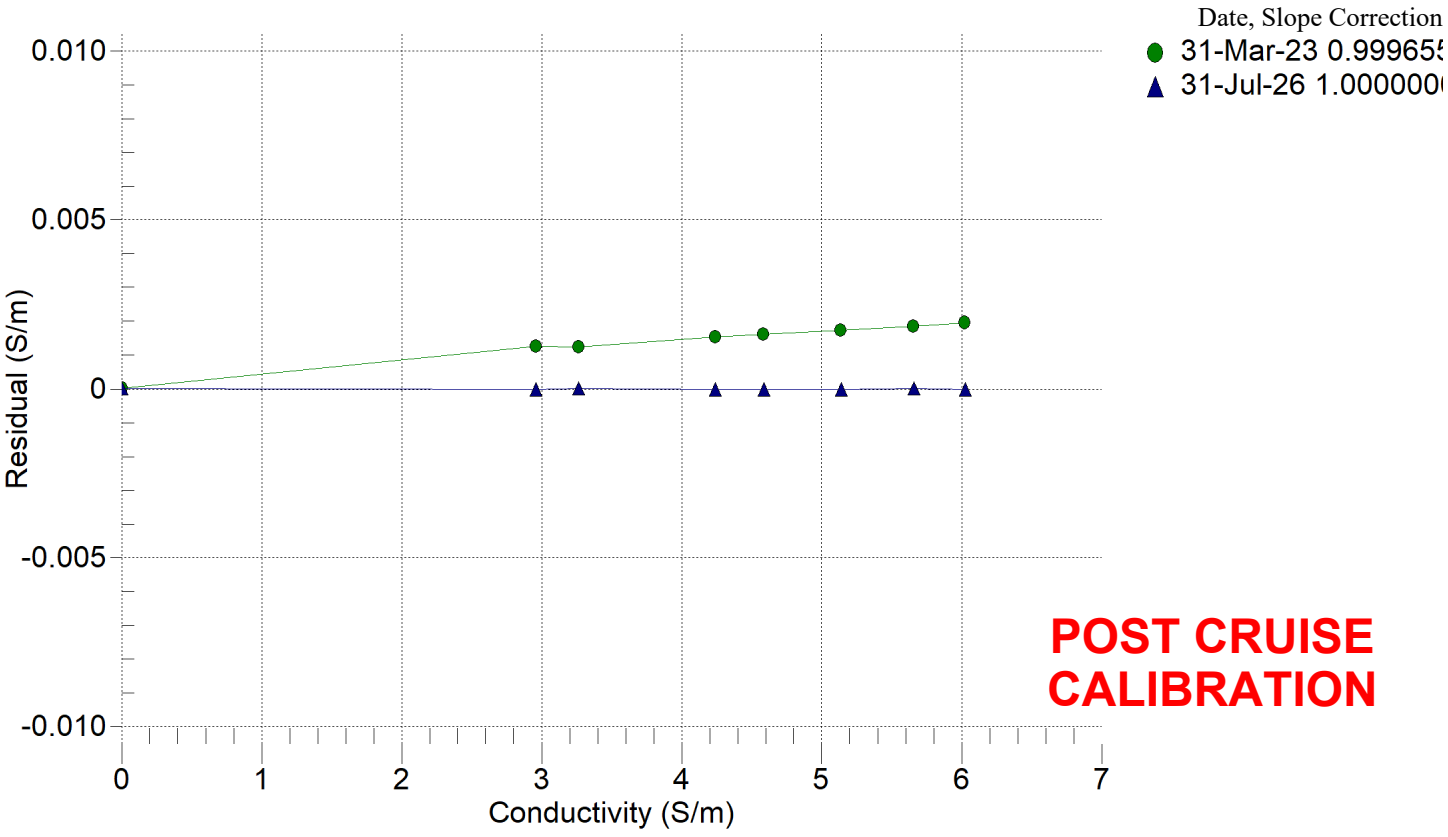

POST CRUISE CALIBRATION