Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2024
CALIBRATION DATE: 09-Aug-26

SBE 37 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

```
g =  -9.991309e-01
h =   1.478699e-01
i =  -4.849423e-05
j =   2.922566e-05

CPcor = -9.5700e-008
CTcor =  3.2500e-006
WBOTC =   3.8161e-06
```


BATH TEMP (° C)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (S/m)	INSTRUMENT OUTPUT (Hz)	INSTRUMENT COND (S/m)	RESIDUAL (S/m)
22.0000	0.0000	0.00000	2598.65	0.00000	0.00000
1.0000	34.6246	2.96114	5165.91	2.96114	0.00001
4.5000	34.6048	3.26673	5360.59	3.26673	-0.00000
15.0000	34.5628	4.24379	5939.55	4.24376	-0.00003
18.5000	34.5539	4.58730	6129.85	4.58731	0.00001
24.0000	34.5444	5.14263	6425.27	5.14265	0.00002
29.0000	34.5395	5.66206	6689.45	5.66207	0.00001
32.5000	34.5375	6.03285	6871.62	6.03283	-0.00001

f = Instrument Output(Hz) * sqrt(1.0 + WBOTC * t) / 1000.0

t = temperature (°C); p = pressure (decibars); δ = CTcor; ε = CPcor;

Conductivity (S/m) = $(g + h * f^2 + i * f^3 + j * f^4) / (1 + \delta * t + \varepsilon * p)$

Residual (Siemens/meter) = instrument conductivity - bath conductivity

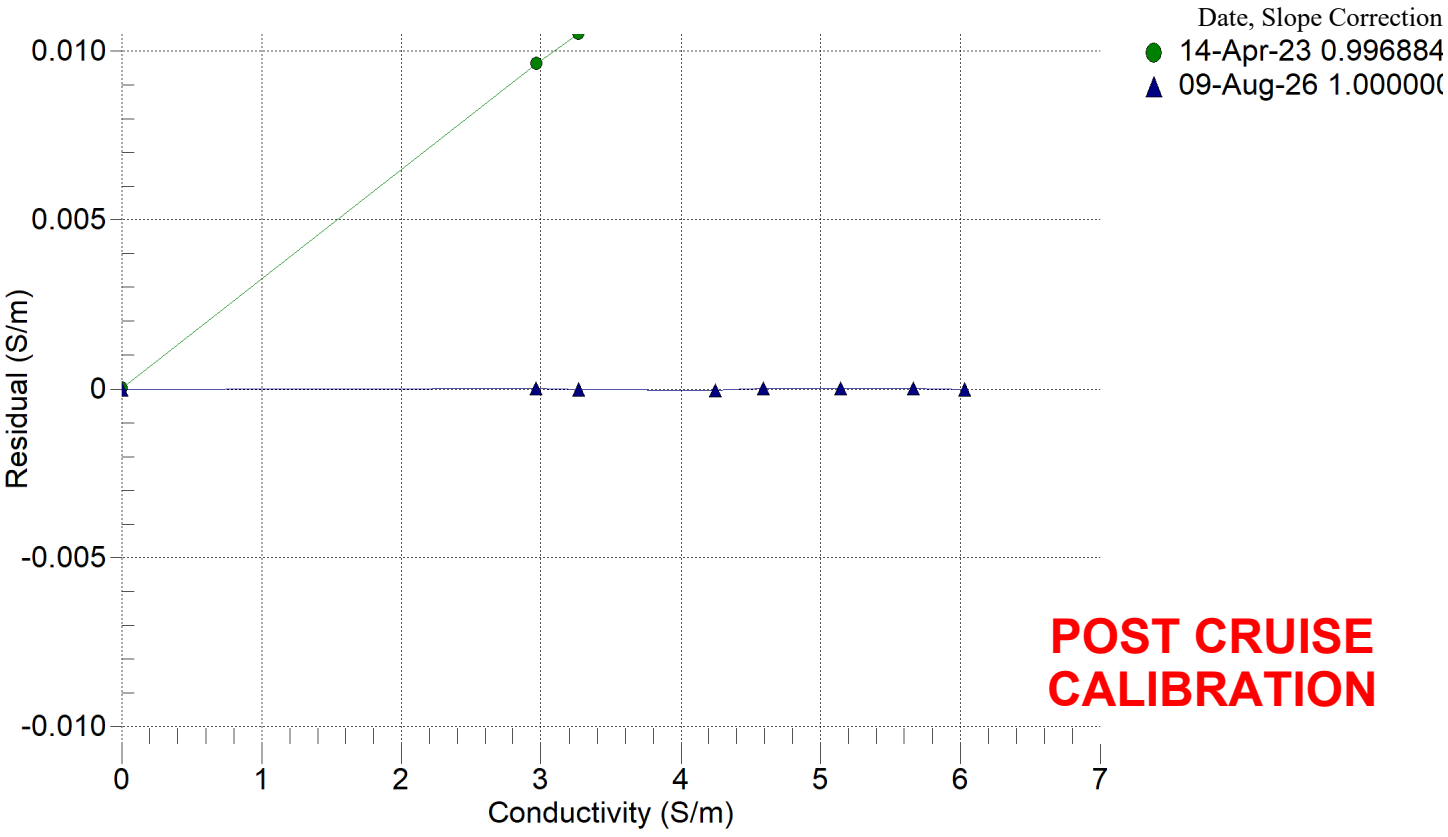

POST CRUISE CALIBRATION