Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2024
CALIBRATION DATE: 18-Aug-26

SBE 37 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

g =	-9.926558e-01	CPcor =	-9.5700e-008
h =	1.470055e-01	CTcor =	3.2500e-006
i =	-9.517951e-05	WBOTC =	3.8161e-06
j =	3.334983e-05		


BATH TEMP (° C)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (S/m)	INSTRUMENT OUTPUT (Hz)	INSTRUMENT COND (S/m)	RESIDUAL (S/m)
22.0000	0.0000	0.00000	2598.64	0.00000	0.00000
1.0000	34.6687	2.96455	5181.25	2.96456	0.00002
4.5000	34.6492	3.27051	5376.88	3.27049	-0.00001
15.0000	34.6077	4.24872	5958.57	4.24871	-0.00002
18.5000	34.5991	4.59265	6149.73	4.59266	0.00000
24.0000	34.5897	5.14863	6446.44	5.14865	0.00002
29.0000	34.5849	5.66867	6711.74	5.66867	-0.00000
32.5000	34.5824	6.03980	6894.63	6.03979	-0.00001

f = Instrument Output(Hz) * sqrt(1.0 + WBOTC * t) / 1000.0

t = temperature (°C); p = pressure (decibars); δ = CTcor; ε = CPcor;

Conductivity (S/m) = $(g + h * f^2 + i * f^3 + j * f^4) / (1 + \delta * t + \varepsilon * p)$

Residual (Siemens/meter) = instrument conductivity - bath conductivity

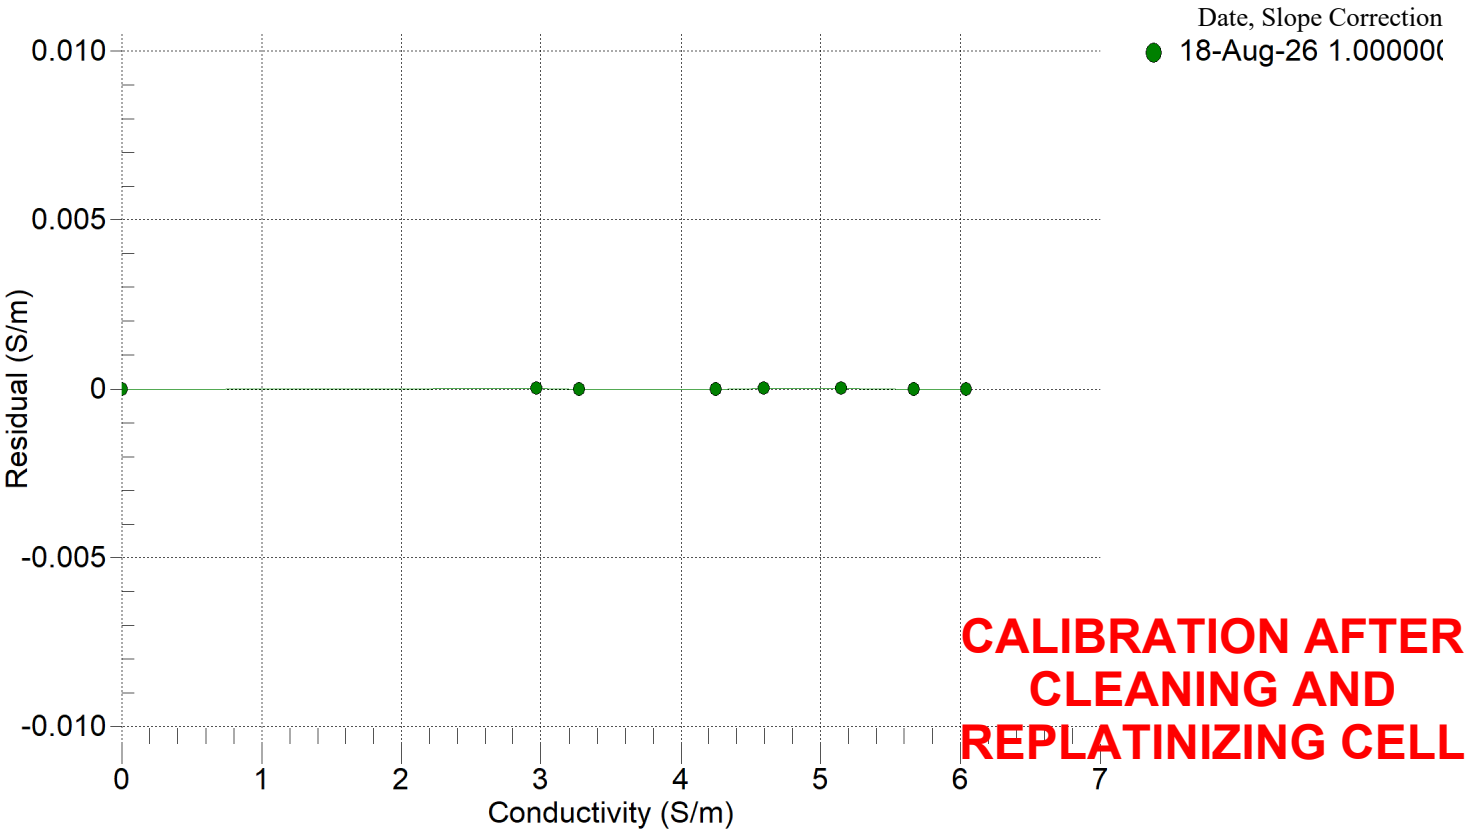

CALIBRATION AFTER CLEANING AND REPLATINIZING CELL