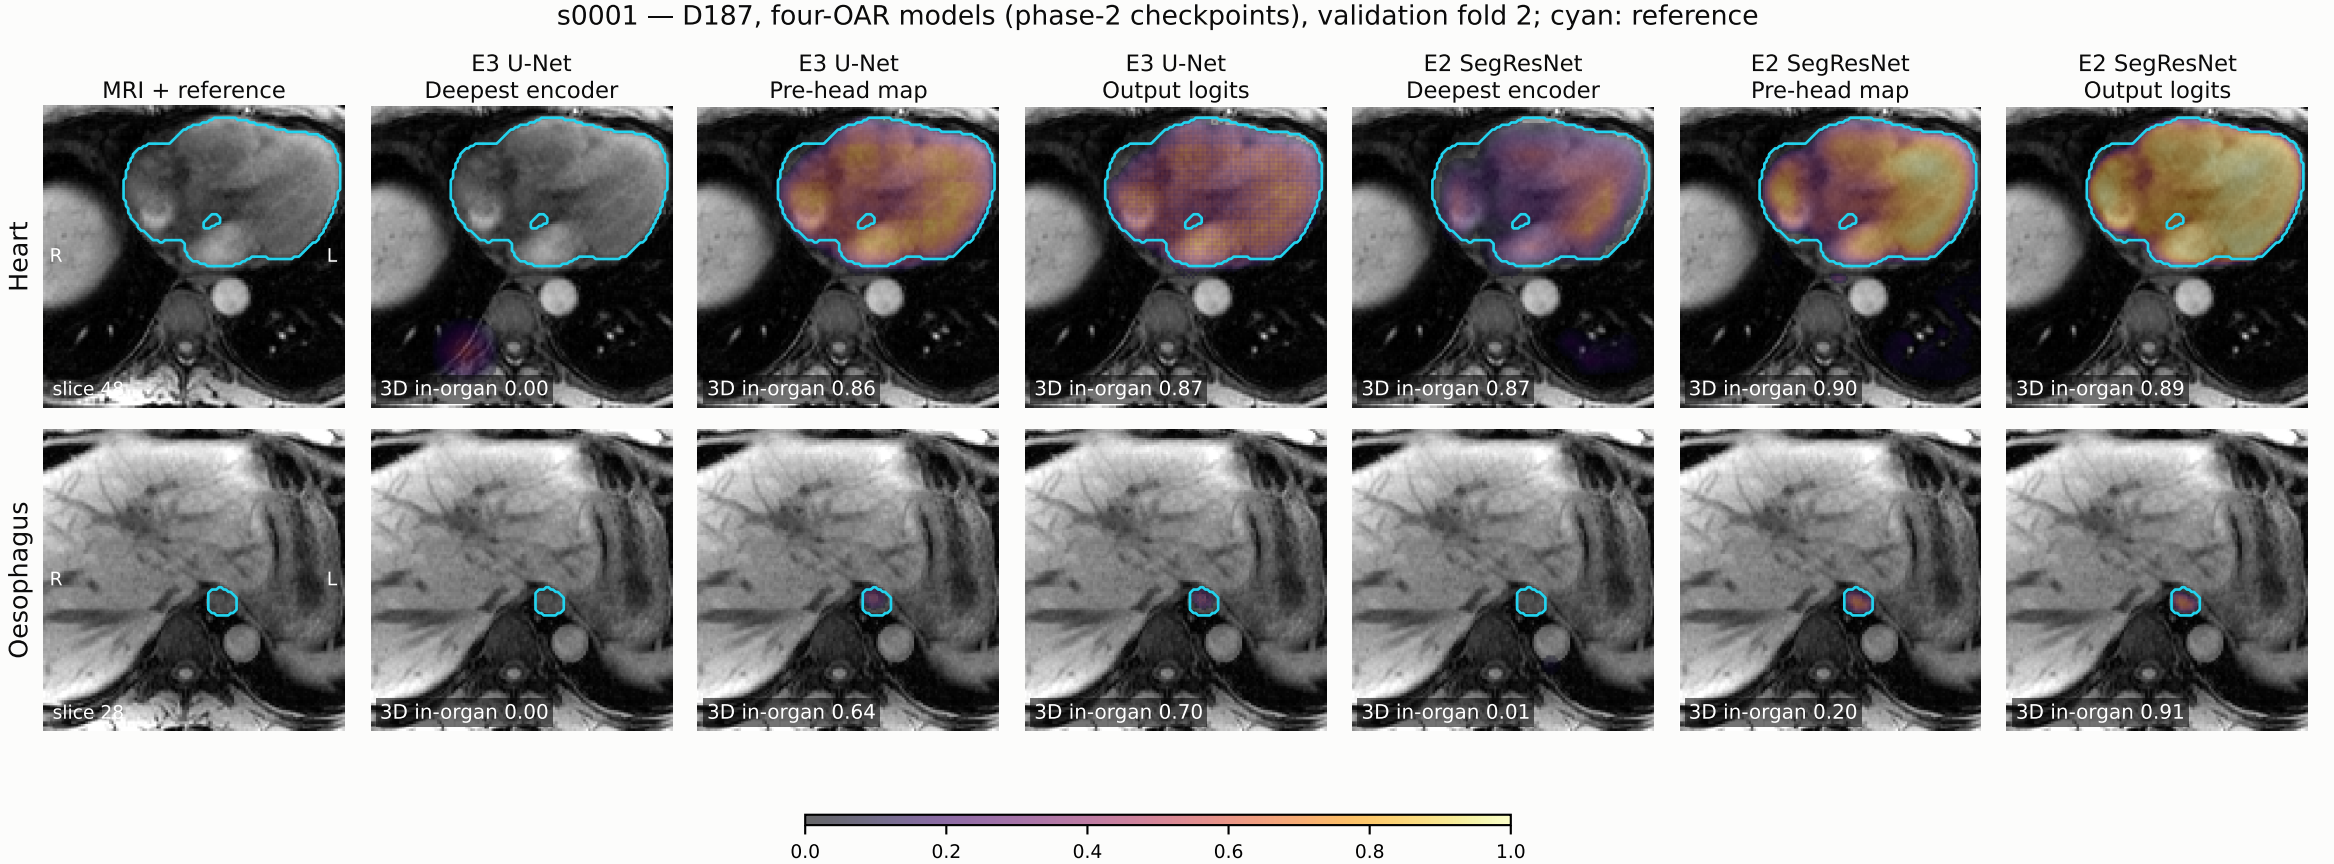

s0001 — D187, four-OAR models (phase-2 checkpoints), validation fold 2; cyan: reference
MRI + reference
E3 U-Net
Deepest encoder
E3 U-Net
Pre-head map
E3 U-Net
Output logits
E2 SegResNet
Deepest encoder
E2 SegResNet
Pre-head map
E2 SegResNet
Output logits
Heart
Oesophagus
R
L
3D in-organ 0.00
3D in-organ 0.86
3D in-organ 0.87
3D in-organ 0.87
3D in-organ 0.90
3D in-organ 0.89
3D in-organ 0.00
3D in-organ 0.64
3D in-organ 0.70
3D in-organ 0.01
3D in-organ 0.20
3D in-organ 0.91
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0