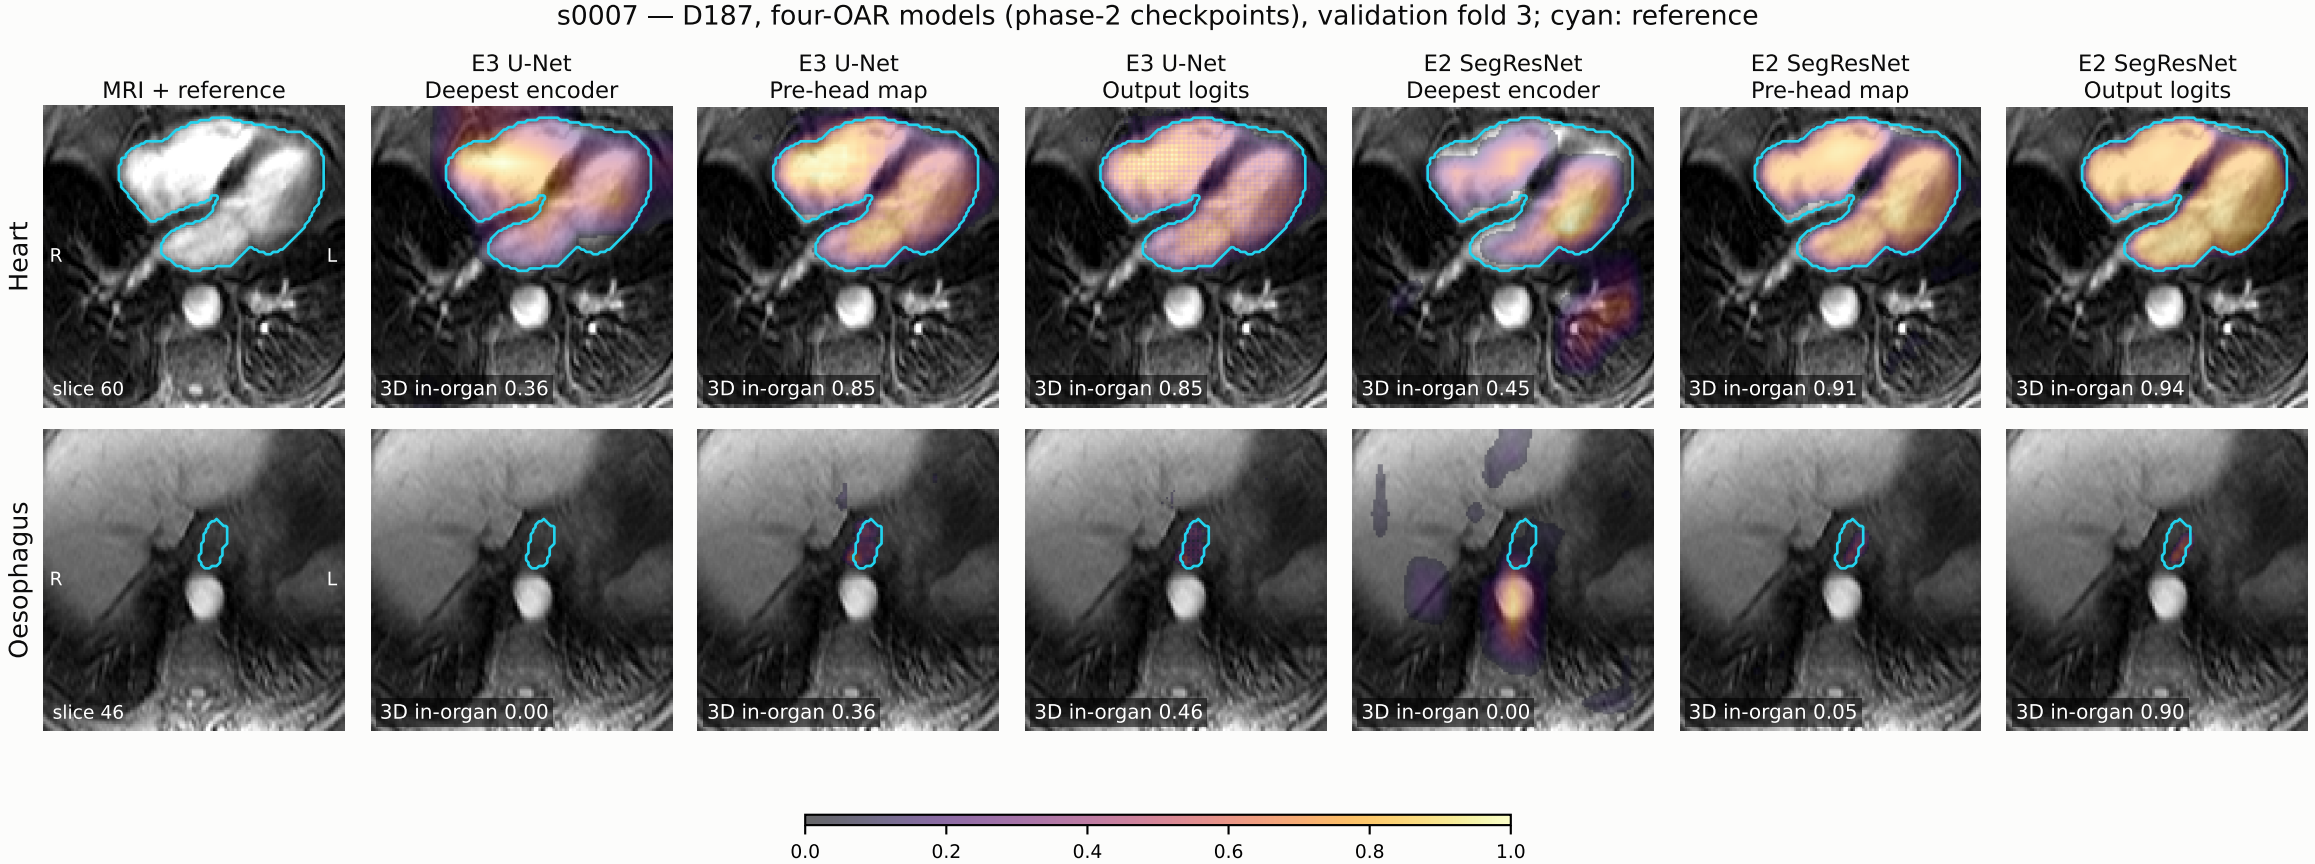

s0007 — D187, four-OAR models (phase-2 checkpoints), validation fold 3; cyan: reference
MRI + reference
E3 U-Net Deepest encoder
E3 U-Net Pre-head map
E3 U-Net Output logits
E2 SegResNet Deepest encoder
E2 SegResNet Pre-head map
E2 SegResNet Output logits
Heart
Oesophagus
R
L
slice 60
3D in-organ 0.36
3D in-organ 0.85
3D in-organ 0.85
3D in-organ 0.45
3D in-organ 0.91
3D in-organ 0.94
slice 46
3D in-organ 0.00
3D in-organ 0.36
3D in-organ 0.46
3D in-organ 0.00
3D in-organ 0.05
3D in-organ 0.90
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0