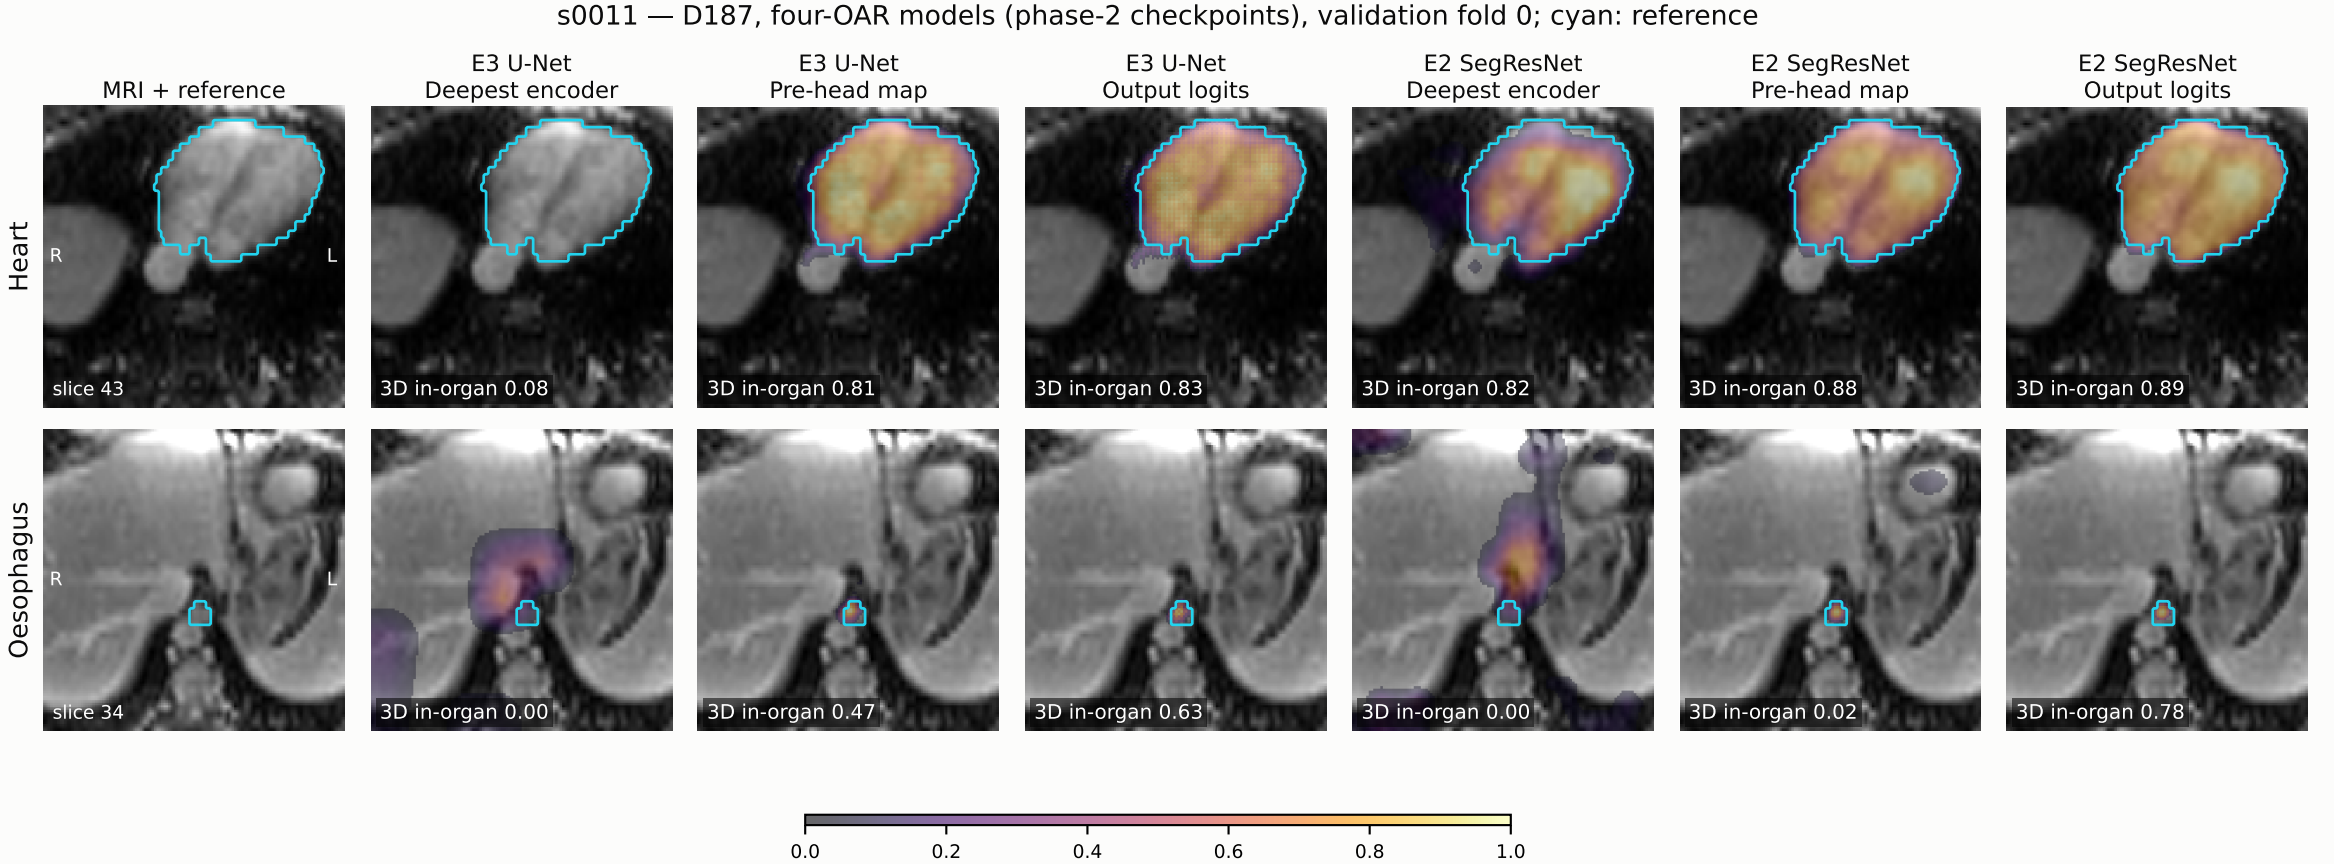

s0011 — D187, four-OAR models (phase-2 checkpoints), validation fold 0; cyan: reference
MRI + reference
E3 U-Net
Deepest encoder
E3 U-Net
Pre-head map
E3 U-Net
Output logits
E2 SegResNet
Deepest encoder
E2 SegResNet
Pre-head map
E2 SegResNet
Output logits
Heart
Oesophagus
R
L
slice 43
3D in-organ 0.08
3D in-organ 0.81
3D in-organ 0.83
3D in-organ 0.82
3D in-organ 0.88
3D in-organ 0.89
slice 34
3D in-organ 0.00
3D in-organ 0.47
3D in-organ 0.63
3D in-organ 0.00
3D in-organ 0.02
3D in-organ 0.78
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0