




ENTREGABLE

Nº 4

GRUPO 03

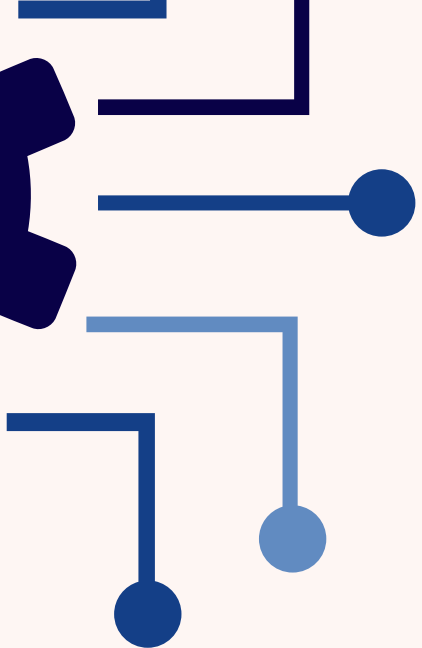

IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD




Maximización de la autonomía funcional mediante una locomoción más independiente, segura y controlada en silla de ruedas, tanto en el hogar como en espacios públicos.

NECESIDAD INMEDIATA

- Manejo seguro e independiente de la silla de ruedas.
- Control de velocidad, equilibrio y postura.
- Adaptación a rampas, veredas, desniveles y obstáculos.
- Reducción de la dependencia hacia cuidadores.

A mediano plazo, optimizar la locomoción en silla de ruedas mediante el entrenamiento progresivo en desplazamientos seguros, eficientes y con menor fatiga, favoreciendo su adaptación al hogar y a la vía pública. Además de fortalecer el uso funcional de miembros superiores para prevenir lesiones por sobreuso en hombros, codos y muñecas.

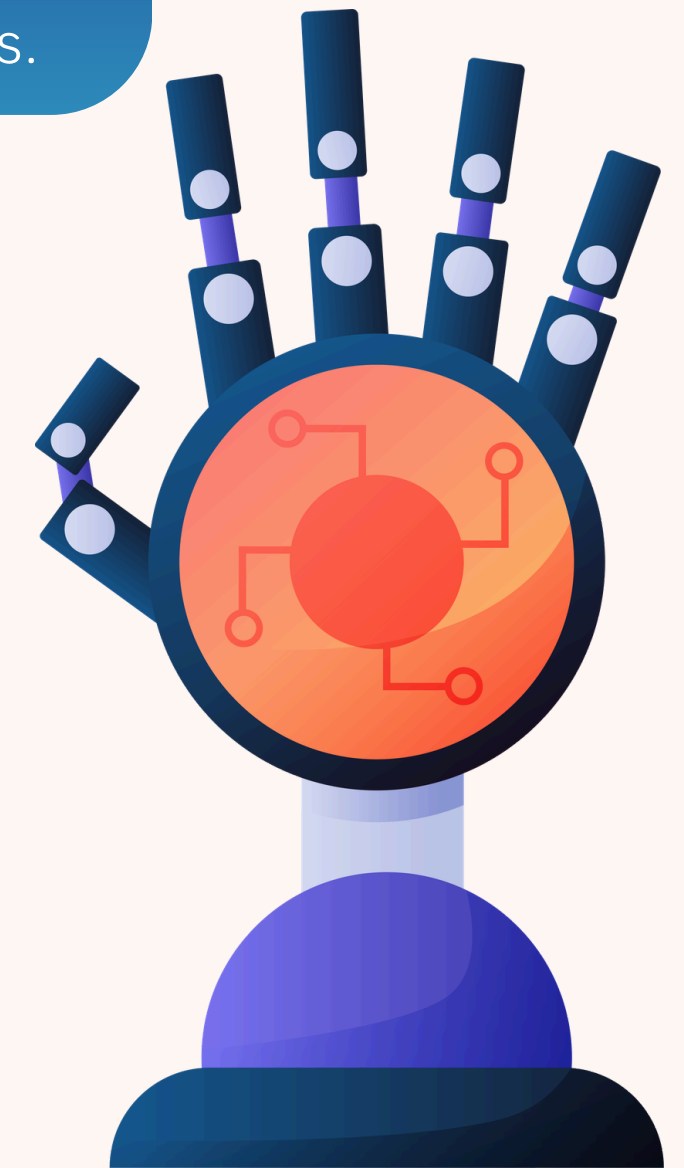

TECNOLOGÍA 1

Detachable Motor Assist for Wheelchair



TECNOLOGÍA 4

Portable Ultra Light Power Wheelchair with Carbon Fiber Material



<https://www.youtube.com/watch?si=qv3FdyqiKckaDf79&v=dvGJq91l4Ec&feature=youtu.be>

TECNOLOGÍA 6

e-motion: sistema de asistencia eléctrica para silla de ruedas




TECNOLOGÍA ?

Power-Flex Power Base Attachment (Base motorizada adaptable Power-Flex para silla de ruedas manual)



Power-Flex



Manual Wheelchair





Best of Both

TECNOLOGÍA 9

Dispositivo de rueda delantera acoplable (FreeWheel Wheelchair Attachment)



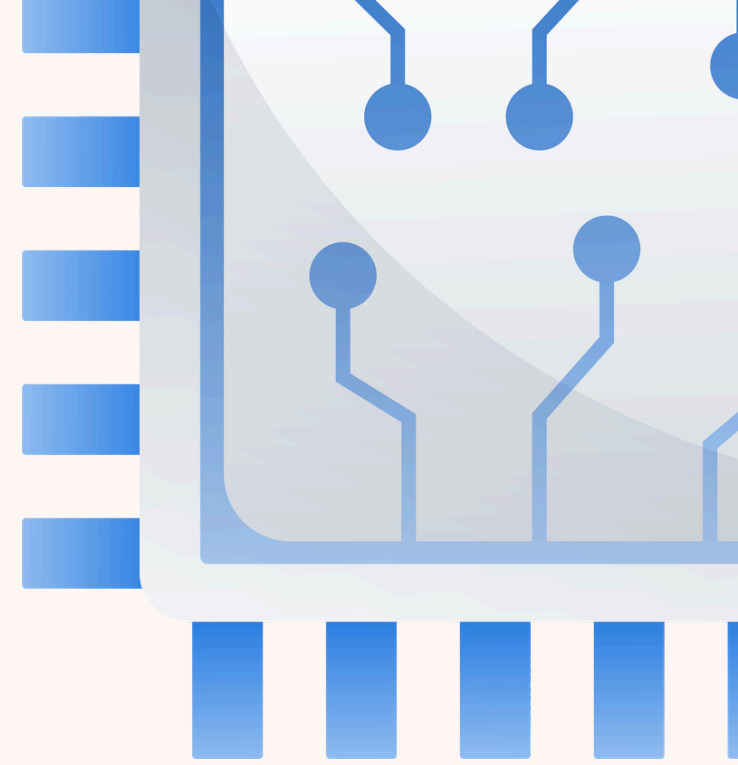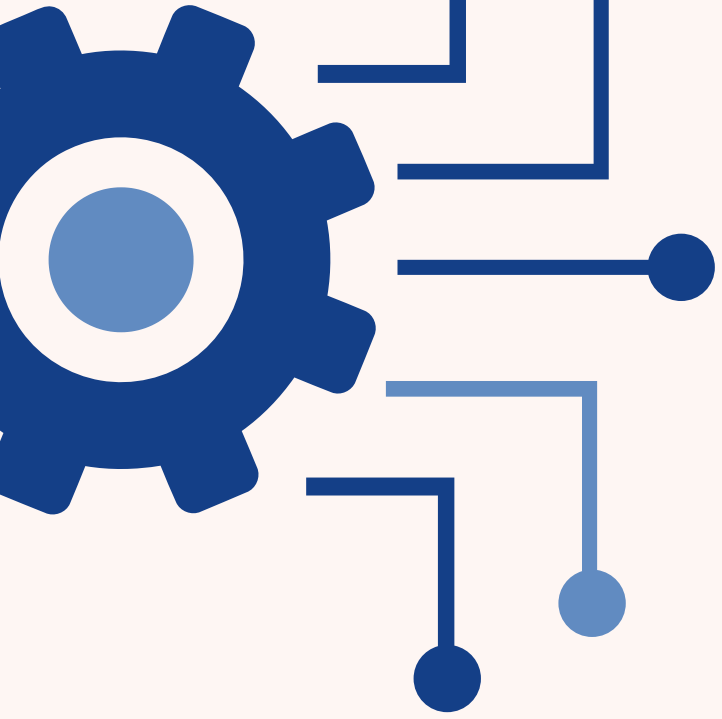

GRACIAS

