



Настройка системы повышения разборчивости речи на основе модели слухового восприятия и компрессии динамического диапазона сигнала по аудиограмме


Порог слышимости в норме

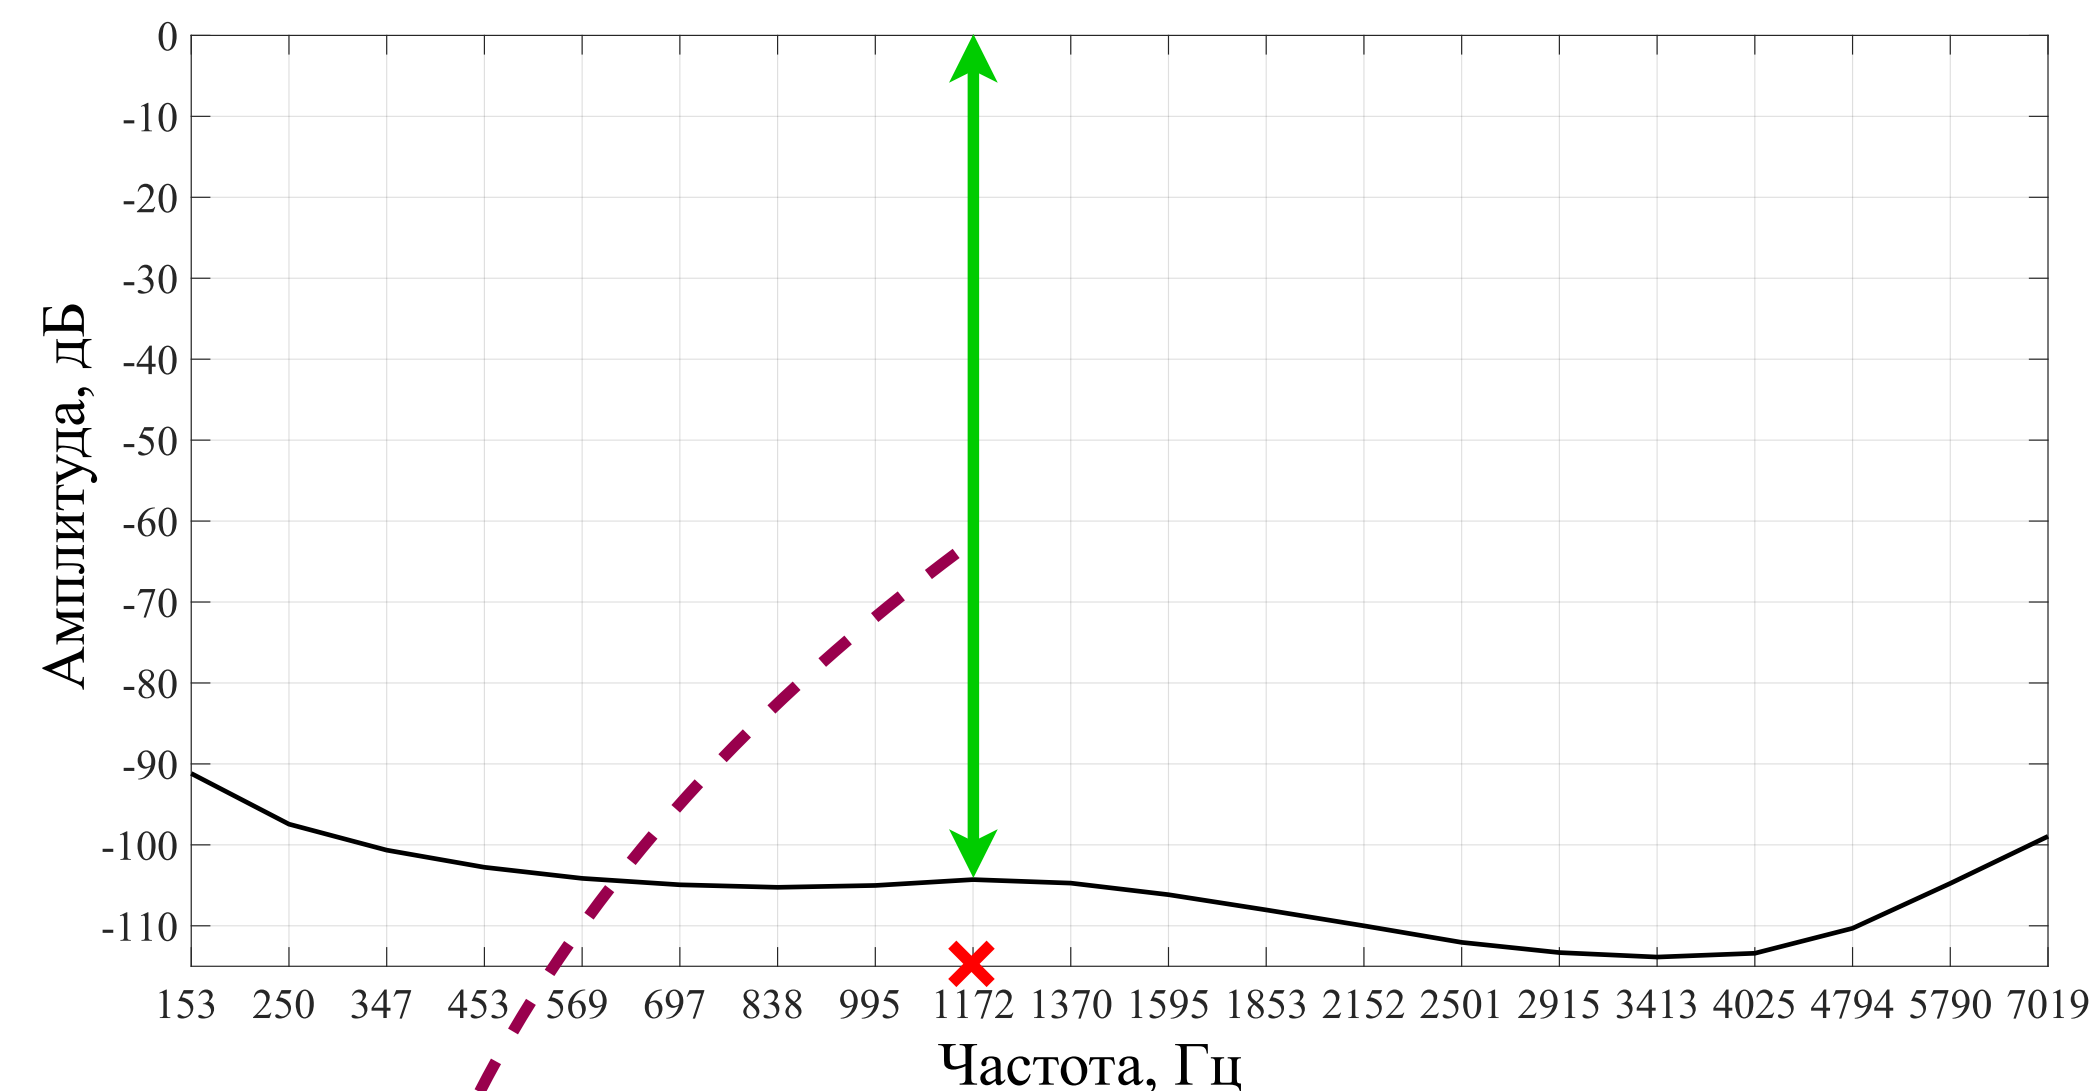


Порог слышимости при наличии патологии

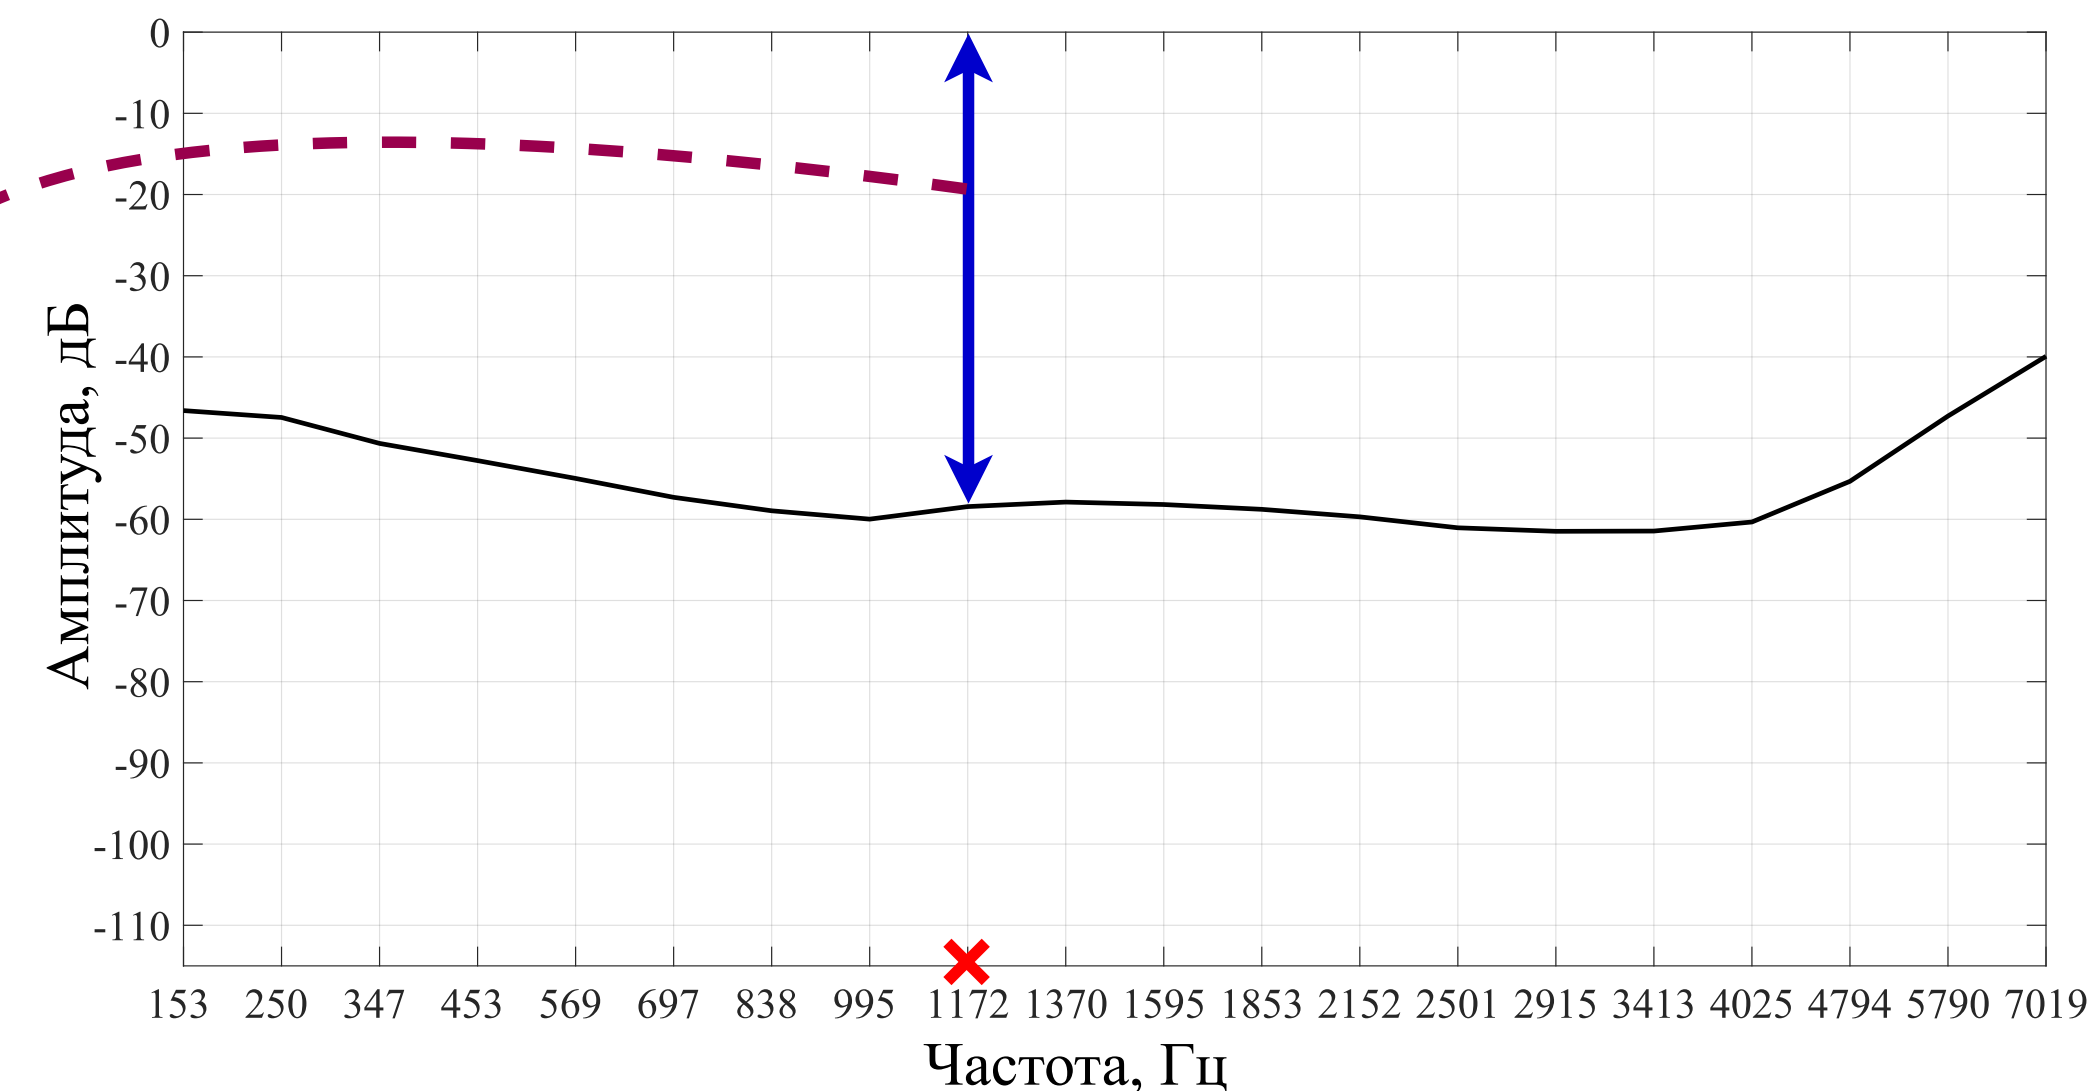

КДД для частоты 1172 Гц

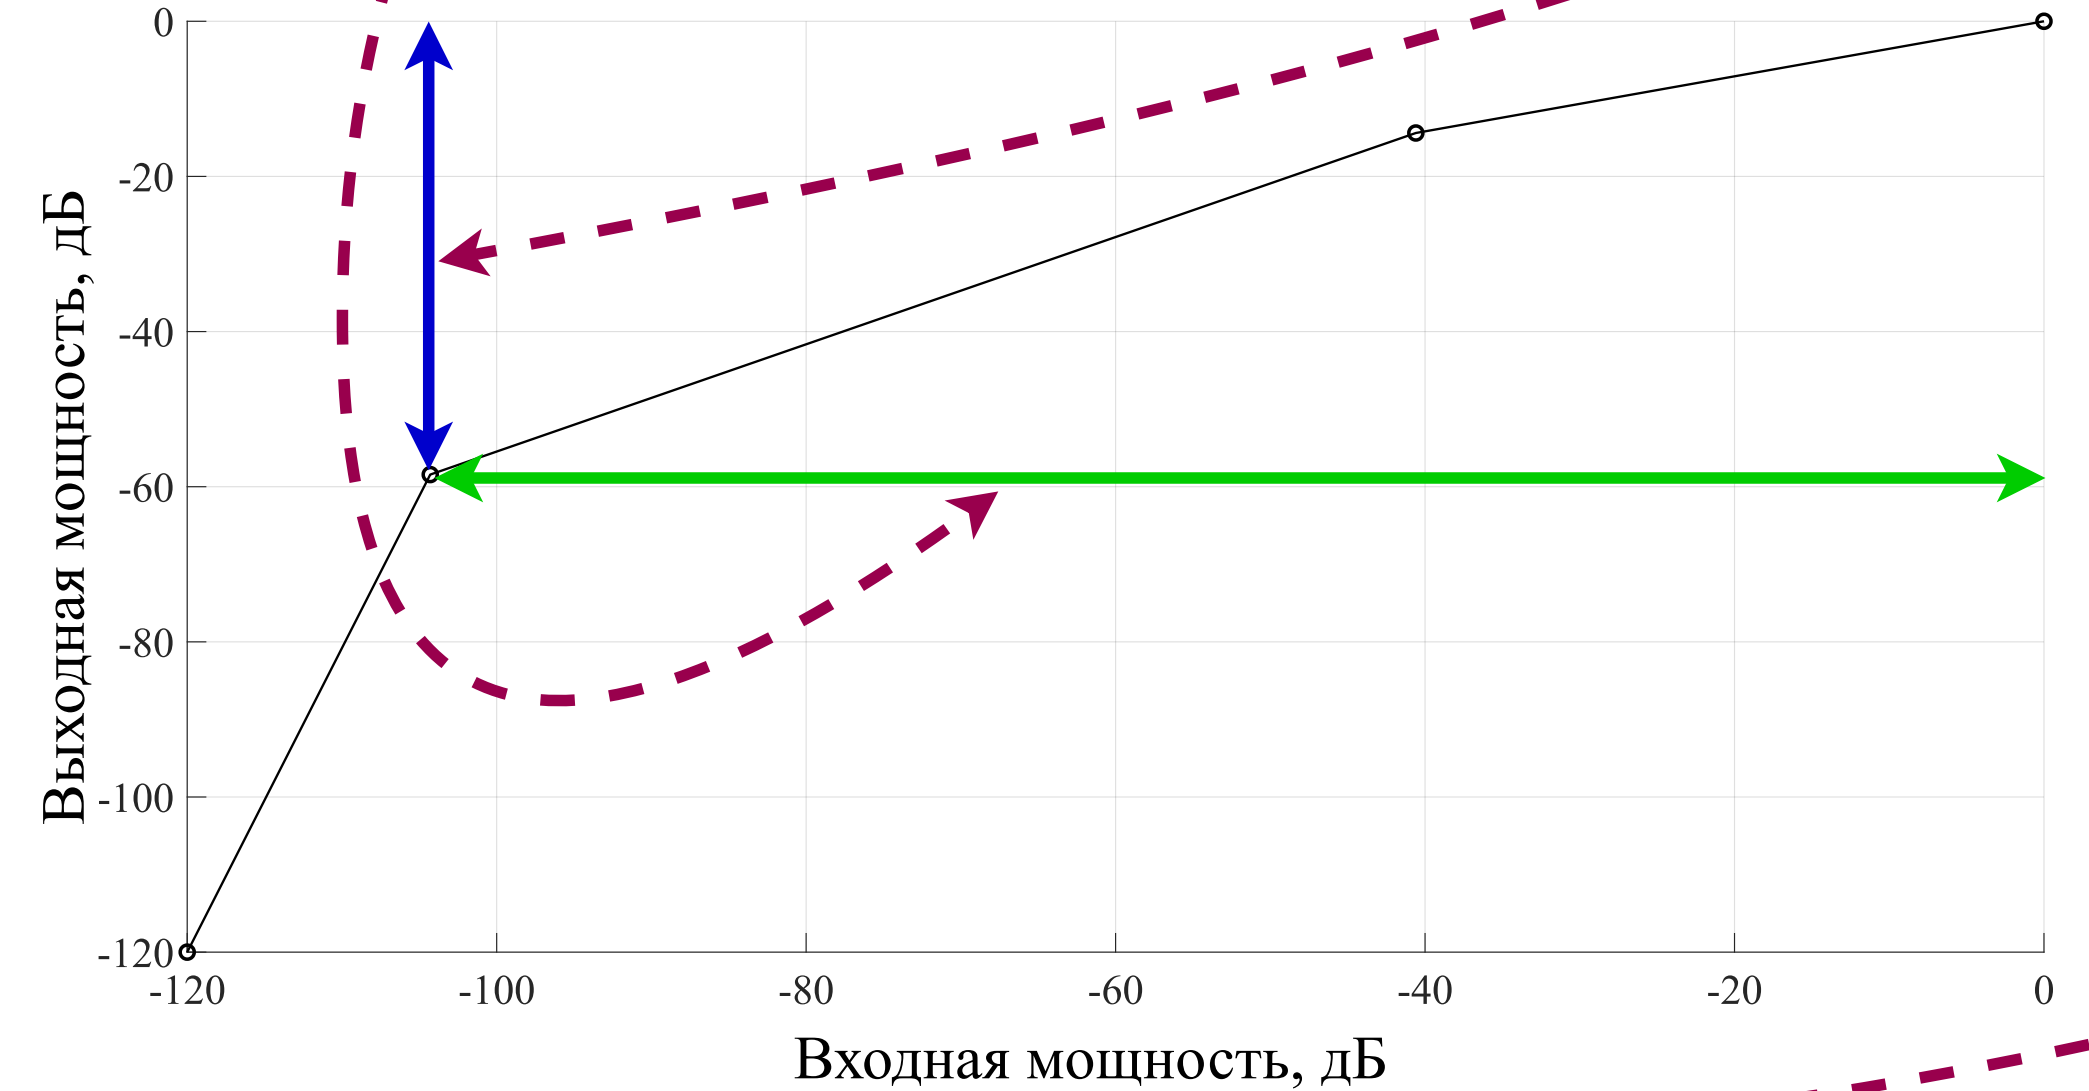

Аудиограмма человека со второй степенью потерь слуха

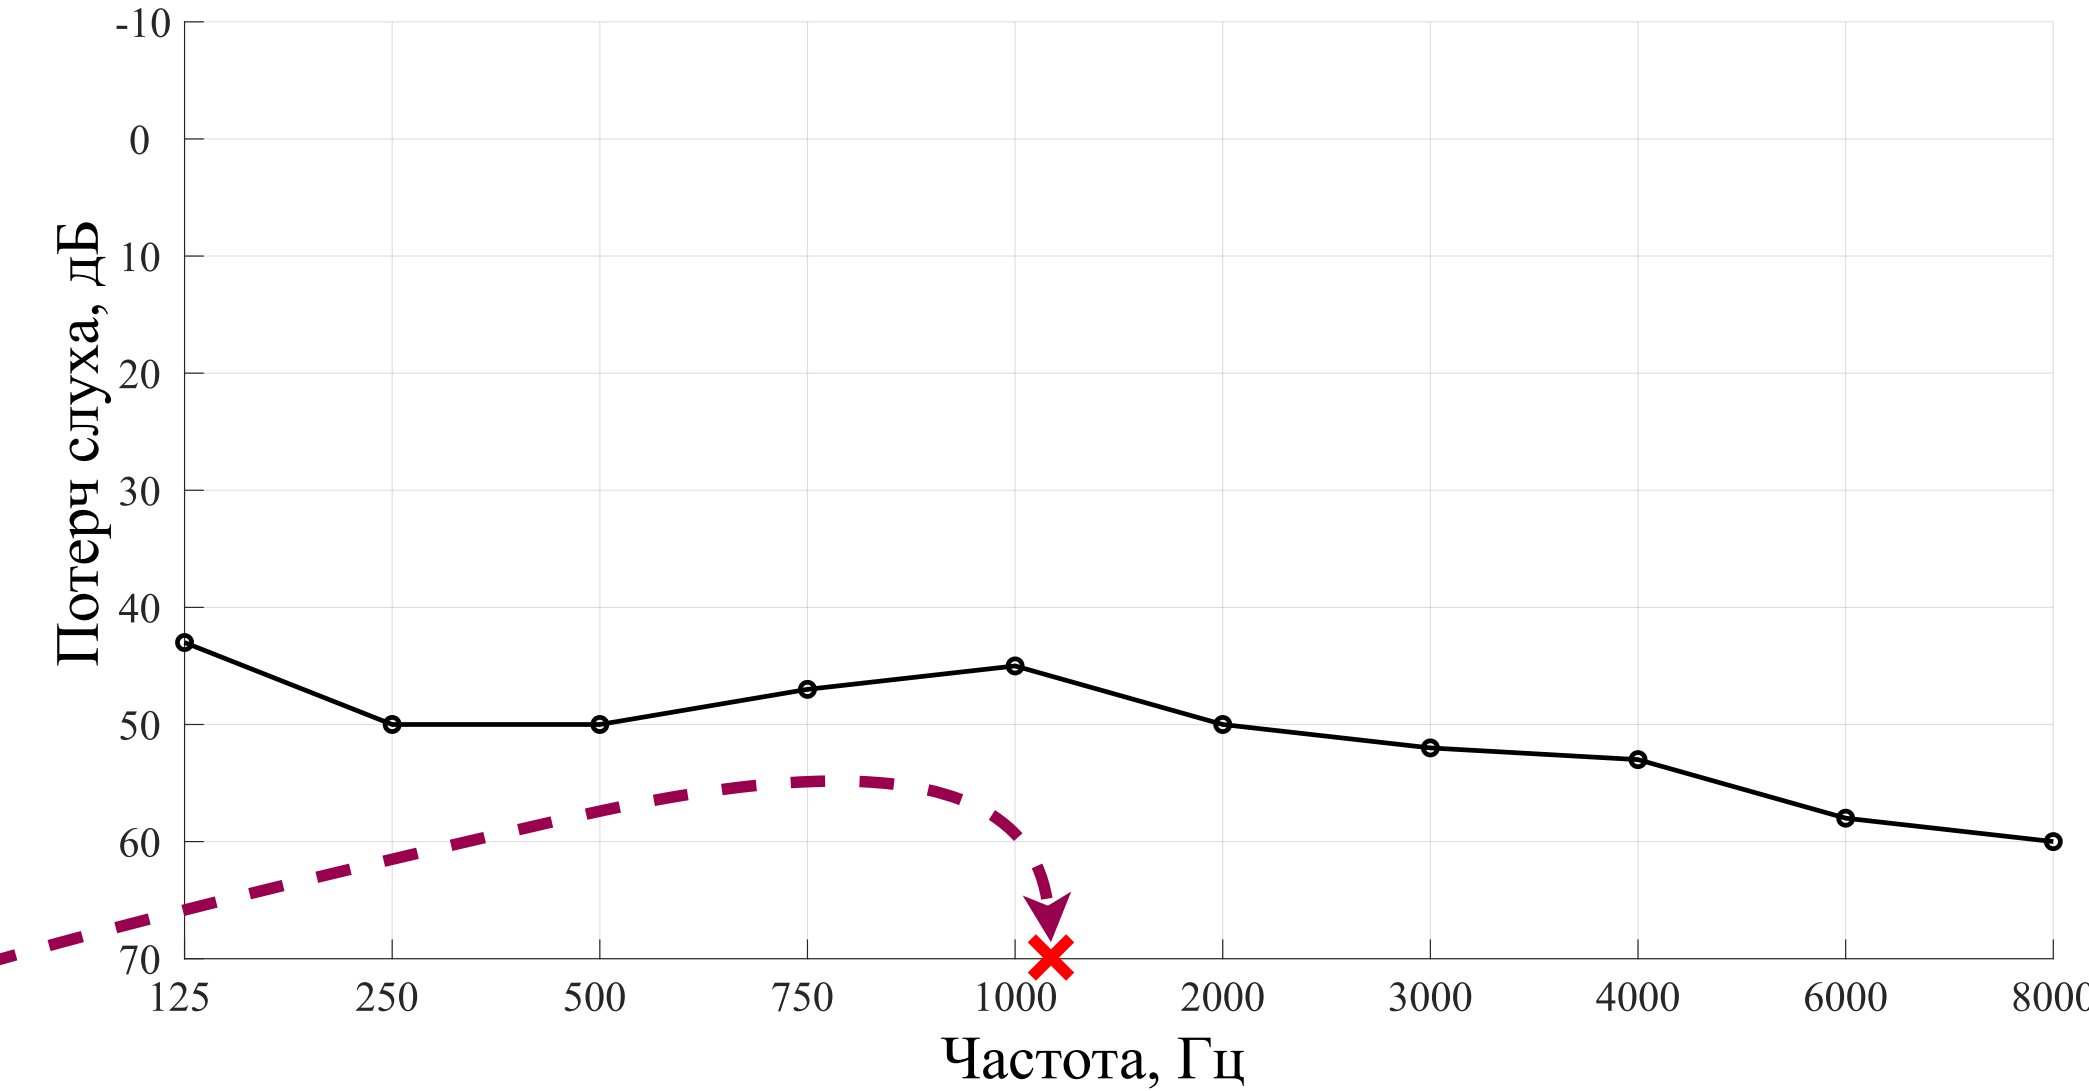

Амплитудно-частотная характеристика банка фильтров

