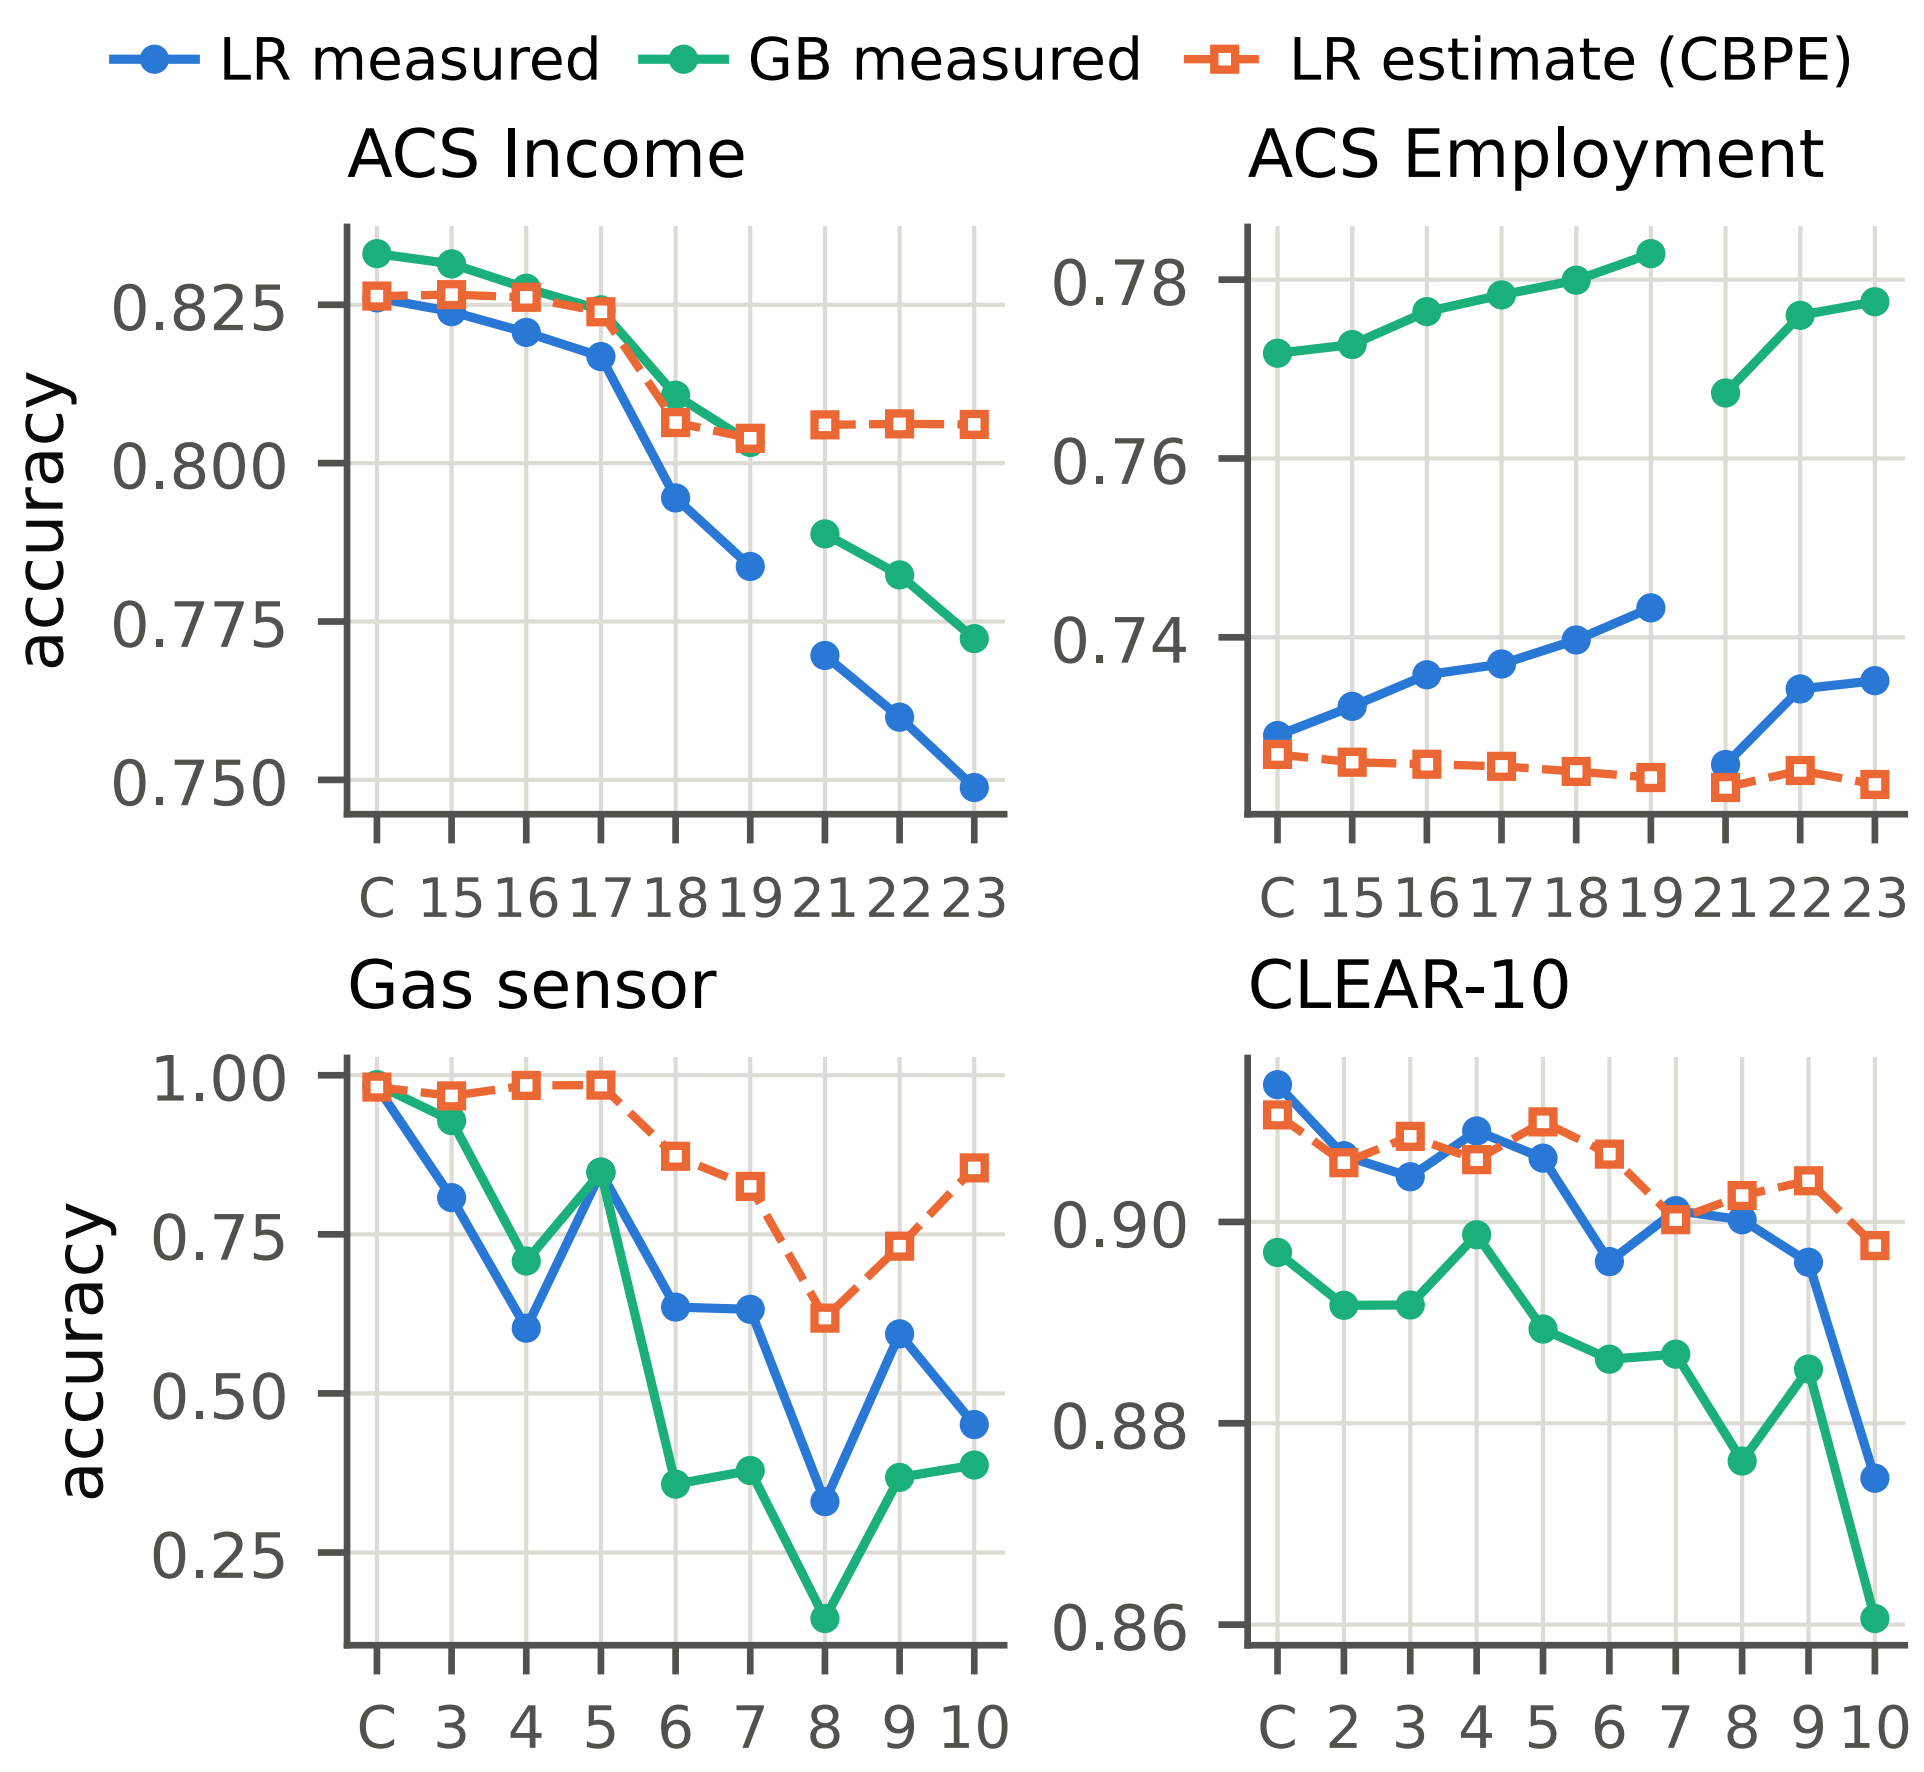
LR measured
GB measured
LR estimate (CBPE)
ACS Income
ACS Employment
Gas sensor
CLEAR-10
accuracy
0.825
0.800
0.775
0.750
0.78
0.76
0.74
1.00
0.75
0.50
0.25
0.90
0.88
0.86
C 15 16 17 18 19 21 22 23
C 3 4 5 6 7 8 9 10
C 2 3 4 5 6 7 8 9 10