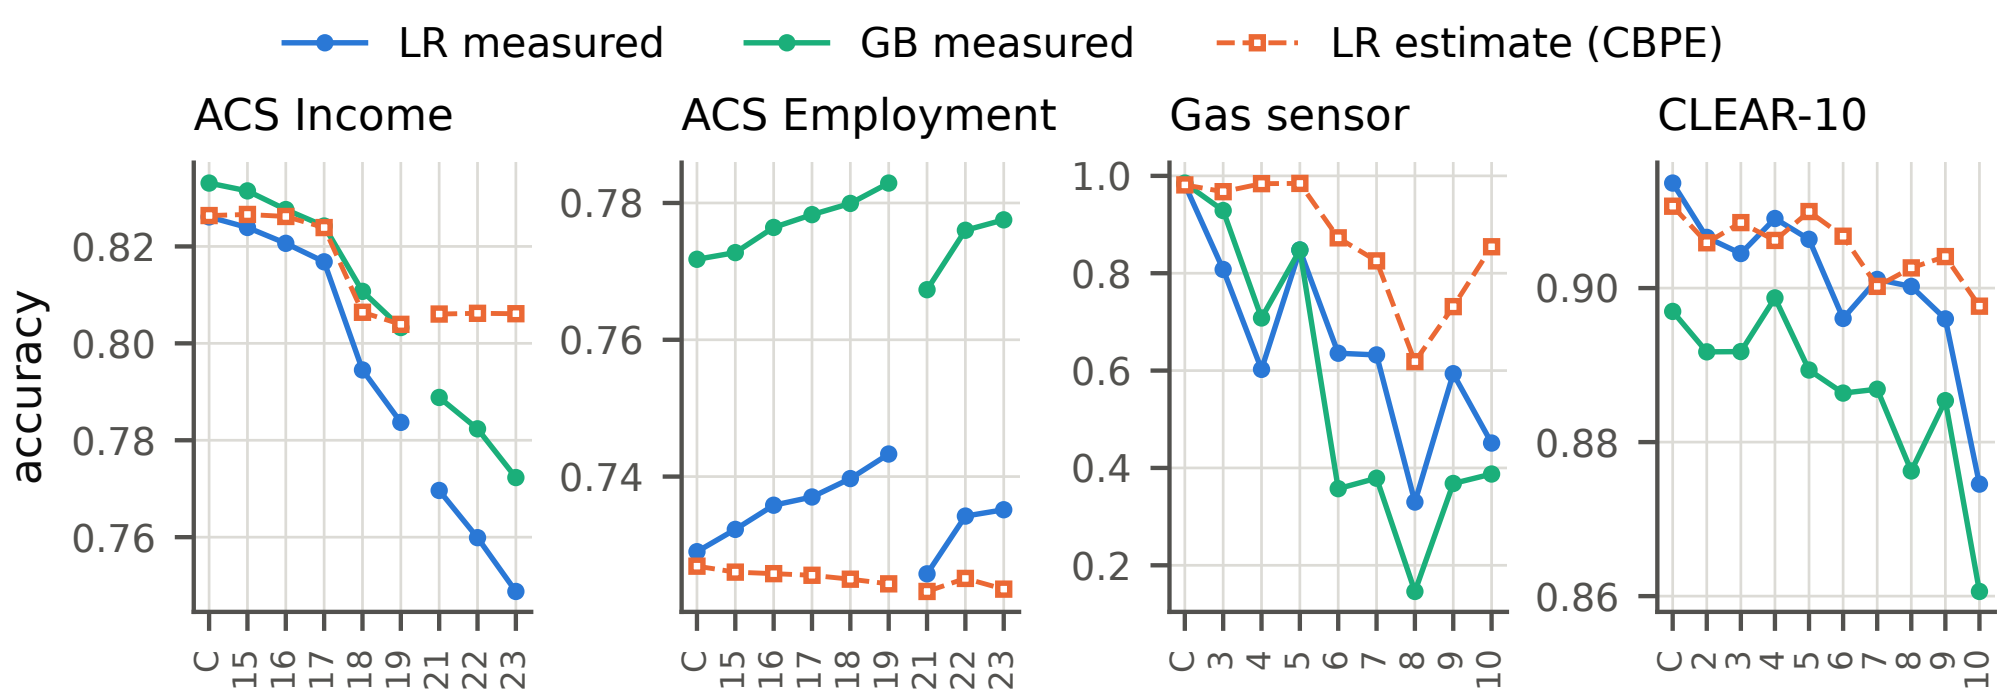
LR measured
GB measured
LR estimate (CBPE)
ACS Income
ACS Employment
Gas sensor
CLEAR-10
accuracy
0.82
0.80
0.78
0.76
0.78
0.76
0.74
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.90
0.88
0.86
C
15
16
17
18
19
21
22
23
C
15
16
17
18
19
21
22
23
C
3
4
5
6
7
8
9
10
C
2
3
4
5
6
7
8
9
10