

Периодичность: Ежедневно



Диспенсер Ecomulti Compact 4


** Используя тест-полоски QT-10 всегда проверяйте концентрацию раствора Suma Bac D10 после его приготовления и до пиковых часов работы ресторана.

Если концентрация раствора ниже 100 ppm, замените его свежим раствором, приготовленным с использованием автоматической системы дозирования Diversey.

Термометры должны быть промаркированы в соответствии с типом продукта (сырая/готовая продукция).

Один и тот же термометр не должен использоваться для измерения сырой и готовой продукции.

В течение дня после каждого использования

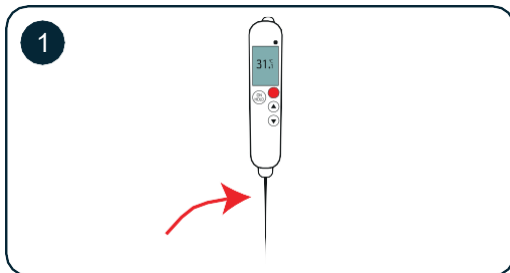

Отсоедините шуп от термометра (если шуп съемный). Если термометр не закрыт водонепроницаемым корпусом, не помещайте его полностью в воду.

В течение дня после каждого использования



Заполните небольшую ёмкость раствором Suma Light D1.2, приготовленным с использованием системы дозирования Diversey. Промойте термометр раствором Suma Light D1.2 с помощью щетки или пада.

В течение дня после каждого использования




Тщательно промойте шуп термометра проточной водой в средней раковине 3-х секционной мойки. (Температура: 50-65 °C).

В течение дня после каждого использования



Заполните небольшую ёмкость раствором Suma Bac D10 (200 ppm), приготовленным с использованием системы дозирования Diversey. Поместите шупы в раствор Suma Bac D10 и выдержите 5 минут.

В течение дня после каждого использования

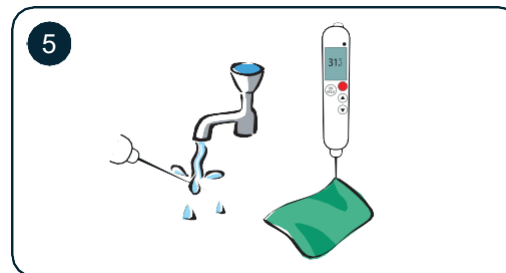

После проведения дезинфекции термометр необходимо ополоснуть проточной горячей водой температурой 50-65 °C в средней раковине 3-х секционной мойки. Протрите термометр насухо чистой салфеткой, а затем поместите его в чистый и сухой контейнер.

Результат: Термометр чистый и продезинфицированный.

Suma Bac
conc
D10 conc




Suma
Light
D1.2



Инвентарь:



Щётка



Салфетка



Перчатки



Гastroемкость

● Используйте инструменты синего цвета в зоне сырого продукта.
Используйте инструменты зеленого цвета в зонах готовой продукции.

DOCUMENT
HACCP_KFC_MEMO
N°-68 - 13/05/ 2025

