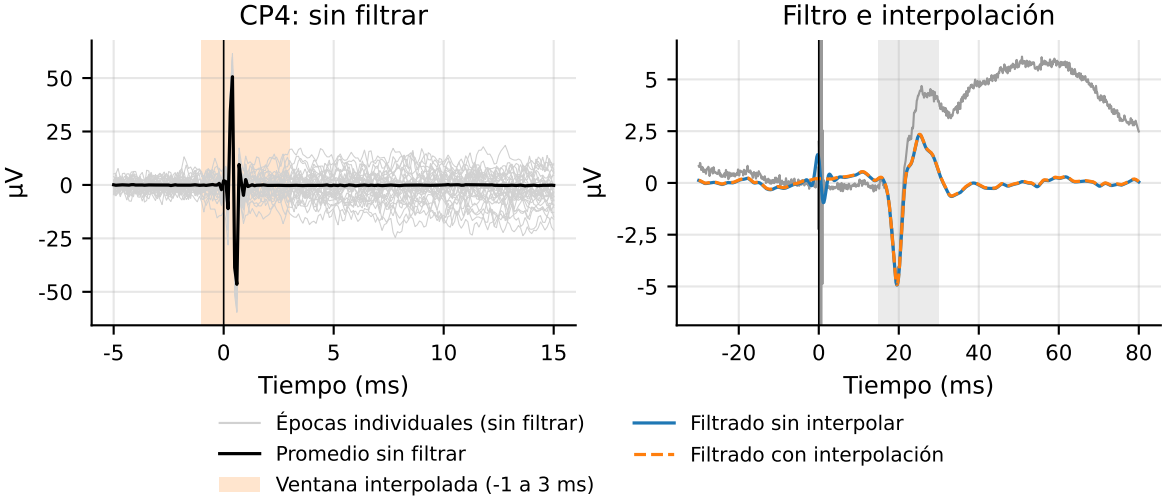

CP4: sin filtrar
µV
50
25
0
-25
-50
-5
0
5
10
15
Tiempo (ms)
Filtro e interpolación
µV
5
2,5
0
-2,5
-5
-20
0
20
40
60
80
Tiempo (ms)
Épocas individuales (sin filtrar)
Promedio sin filtrar
Ventana interpolada (-1 a 3 ms)
Filtrado sin interpolar
Filtrado con interpolación