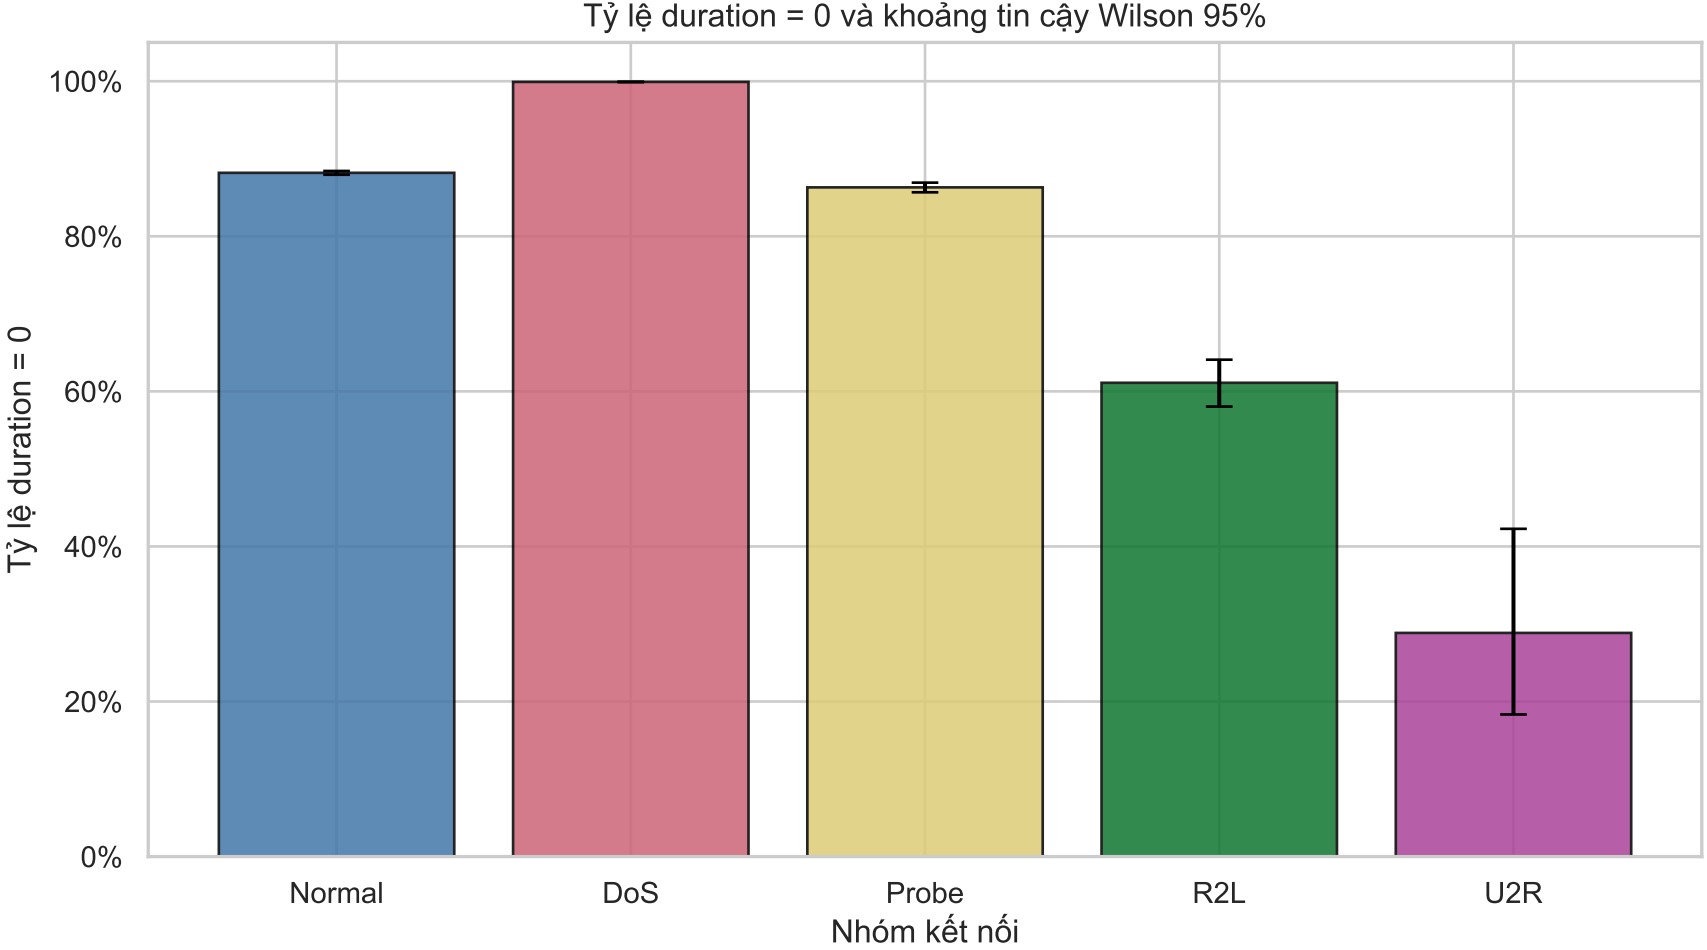
Tỷ lệ duration = 0 và khoảng tin cậy Wilson 95%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Tỷ lệ duration = 0
Normal
DoS
Probe
R2L
U2R
Nhóm kết nối