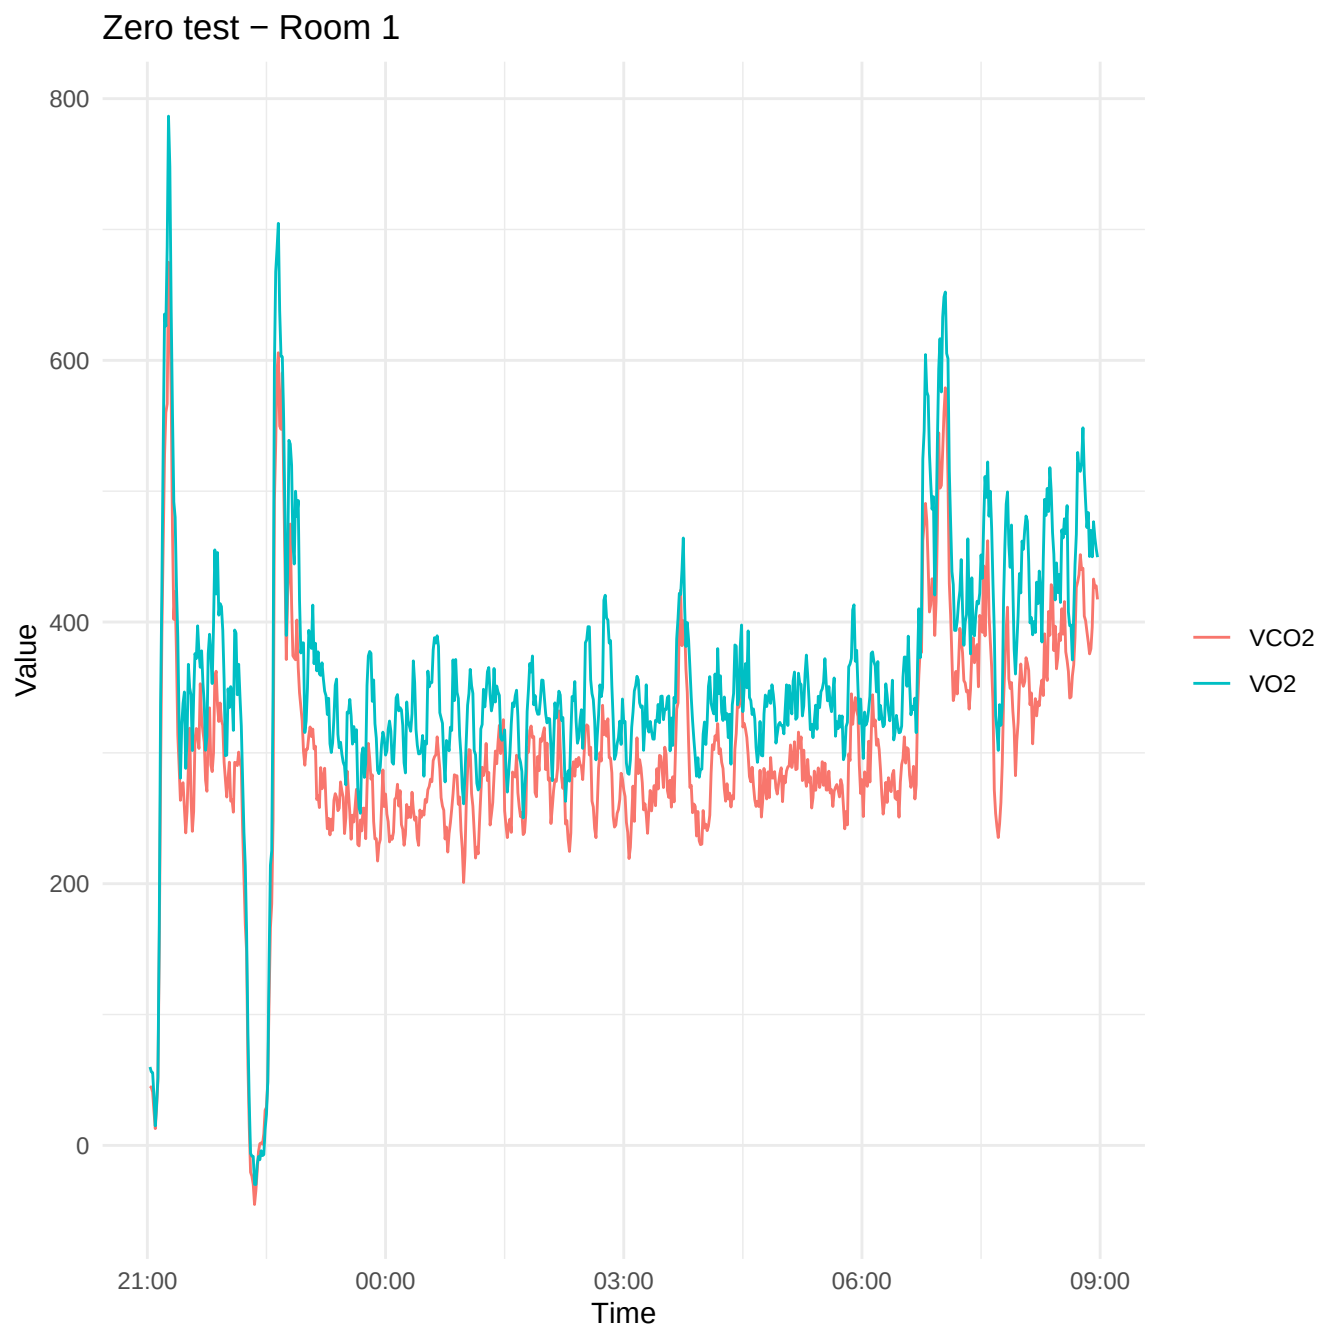
Zero test − Room 1
800
600
400
200
0
Value
21:00
00:00
03:00
06:00
09:00
Time
VCO2
VO2

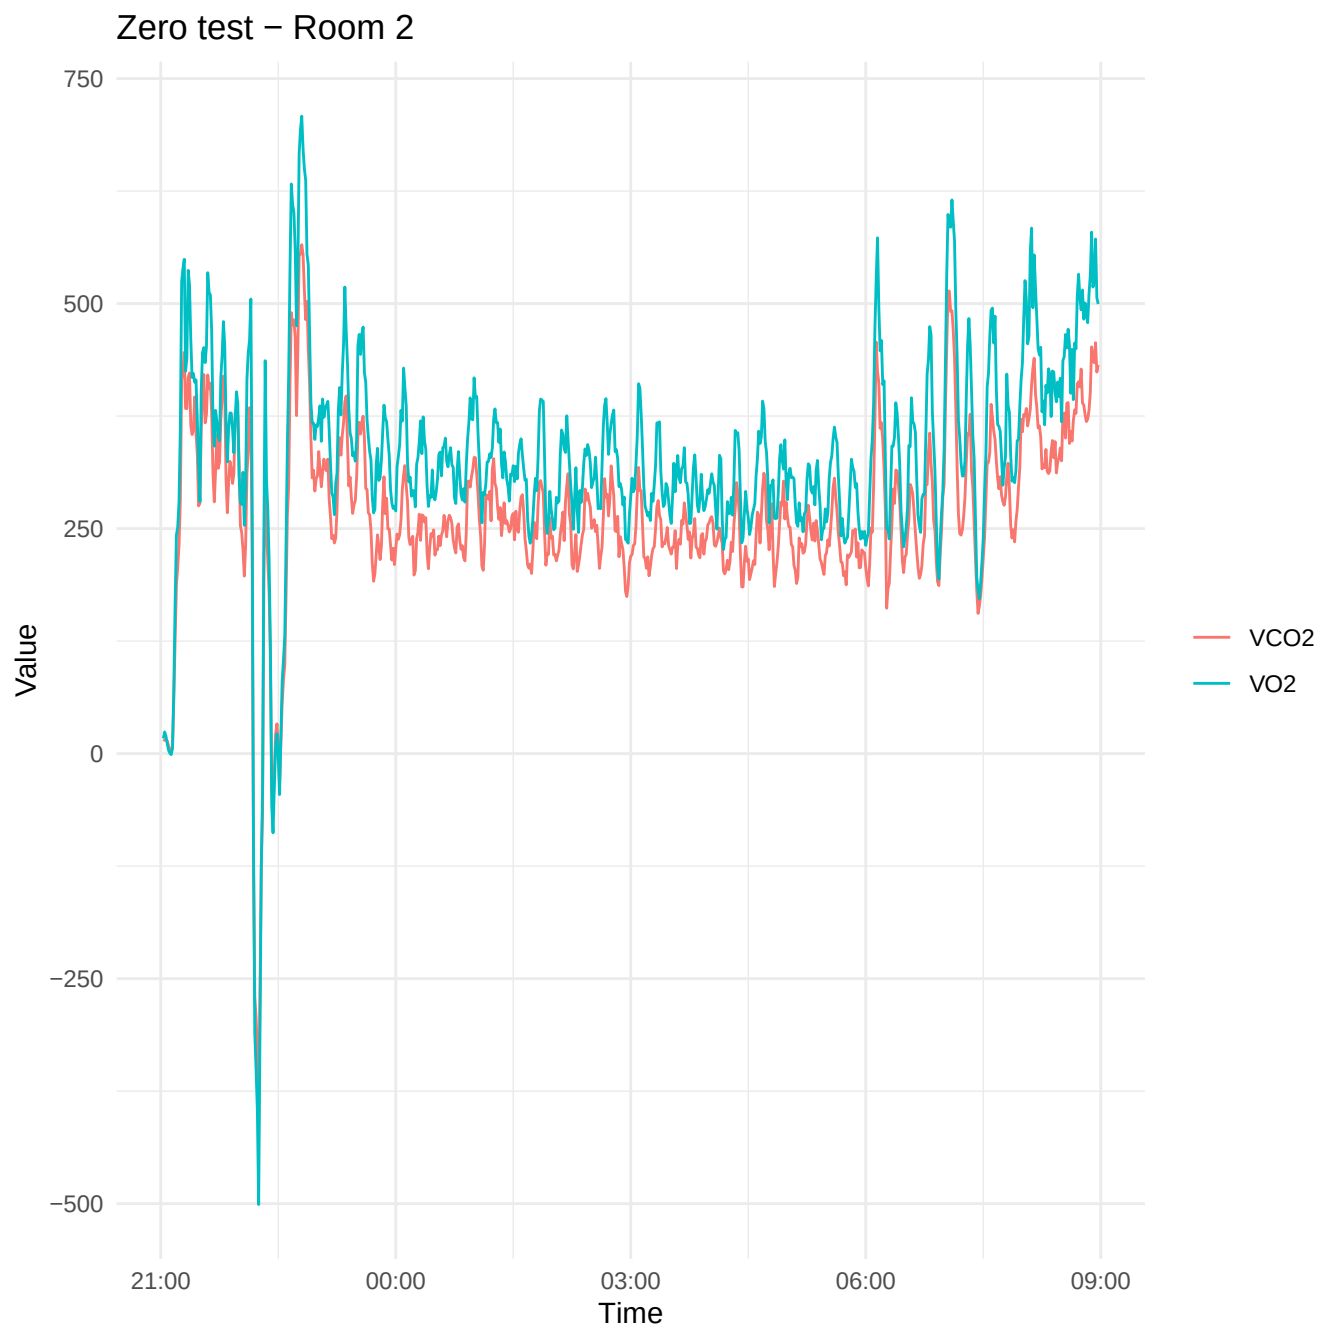
Zero test − Room 2
750
500
250
0
−250
−500
Value
21:00
00:00
03:00
06:00
09:00
Time
VCO2
VO2

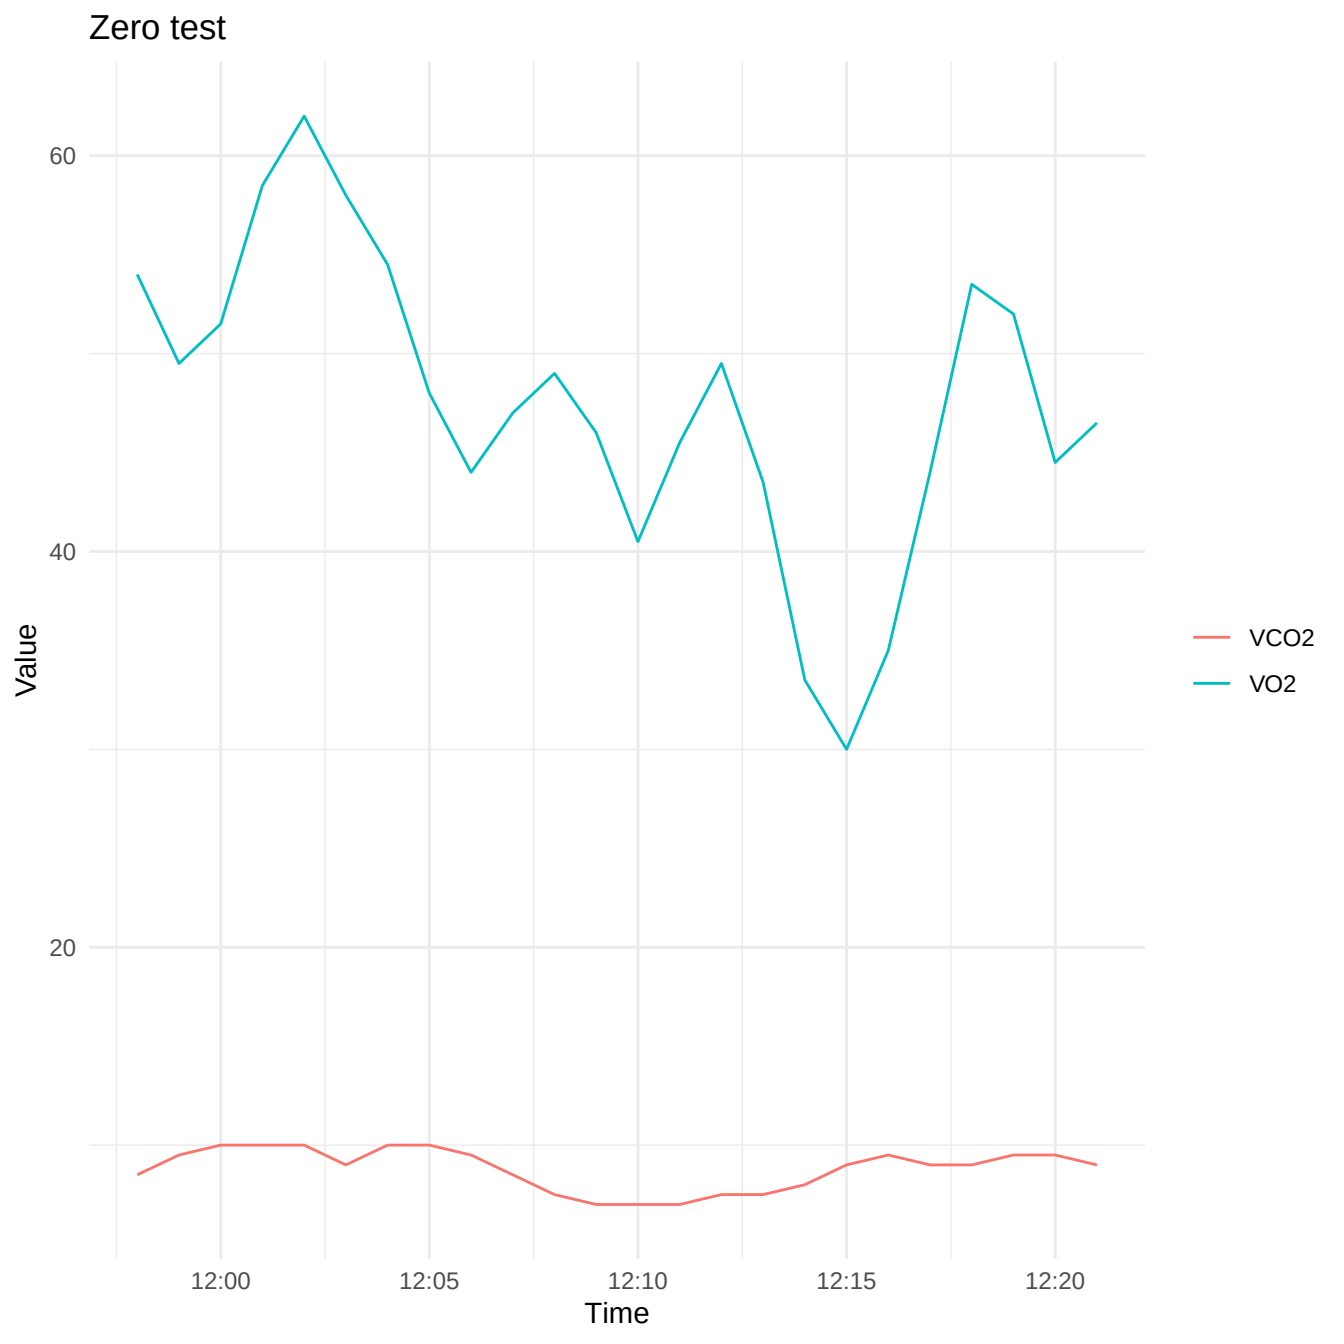
Zero test
60
40
20
Value
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
Time
VCO2
VO2