

Standard Name3 of 3

↑

20A 0494 CD

↓

Visual Hue Request:

New StdRetrieve StdStore StdList StdUpdate Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal
Date: 15-Jun-20Time: 09:03:02

Batch Name1 of 1

↑

FA21-ITN-B102 FBM15293 1-1 3018672/III/21 I1

↓


New BatRetrieve BatStore BatList BatUpdate Bat

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal
Date: 09-Apr-21Time: 15:13:29

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 0.80

I:c Ratio: (2.00 1.00)

DeltaD65 / 10F11 / 10

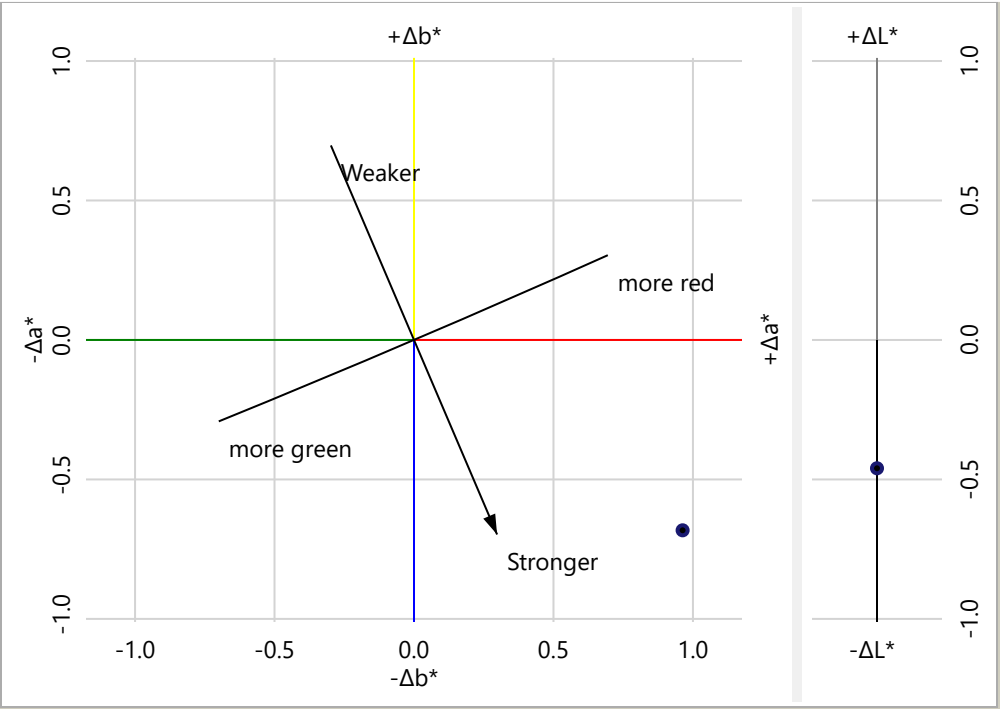

- Single/All
- CMC Plot
- Zoom Out
- Zoom In
- Print Form

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/E	Color	Comments
FA21-ITN-B102 FBM15293 1-1 3018672/III/21 I1	D65 10 Deg	-0.46	0.96	-0.68	-0.24	0.41	0.42	0.64		Warn	darker	more saturated more red
FA21-ITN-B102 FBM15293 1-1 3018672/III/21 I1	F11 10 Deg	-0.49	0.80	-0.89	-0.27	0.42	0.36	0.61	0.29	Warn	darker	more saturated more red