

Standard Name25 of 35

↑

20B 1083 CRD

↓

Visual Hue Request:

New StdRetrieve StdStore StdList StdUpdate Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 25-Jan-21Time: 08:34:43

Batch Name4 of 4

↑

TMKF-21-00323 285933 1-1 3004077/I/21

↓

New BatRetrieve BatStore BatList BatUpdate Bat


Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal

Date: 20-Mar-21Time: 08:51:36

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 1.00

I:c Ratio: (2.00 1.00)

DeltaU3500 / 10D65 / 10A / 10

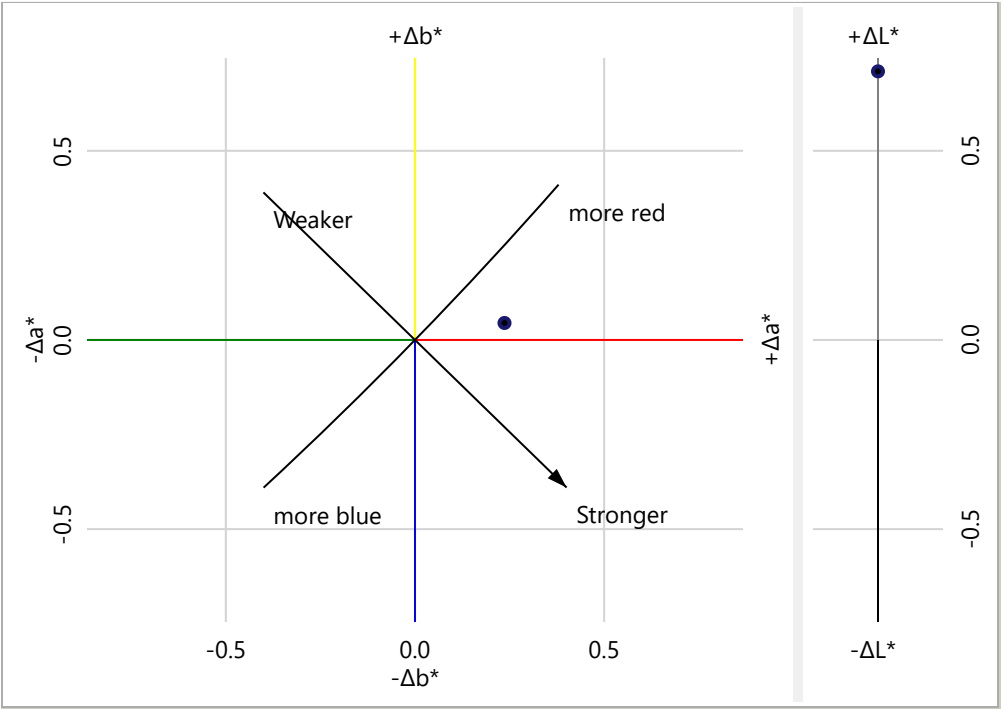

- Single/All
- CMC Plot
- Zoom Out
- Zoom In
- Print Form

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/E	Color	Comments
TMKF-21-00323 285933 1-1 3004077/I/21	U3500 10 Deg	0.71	0.23	0.05	0.40	0.11	0.23	0.47		Pass	lighter	more saturated more red
TMKF-21-00323 285933 1-1 3004077/I/21	D65 10 Deg	0.68	0.20	-0.04	0.38	0.14	0.09	0.41	0.12	Pass	lighter	more saturated more red
TMKF-21-00323 285933 1-1 3004077/I/21	A 10 Deg	0.69	0.09	0.01	0.38	0.06	0.05	0.39	0.20	Pass	lighter	more saturated more red