

Standard Name 40 of 82

↑

21C 0033 ARL

↓

Visual Hue Request:

New Std

Retrieve Std

Store Std

List Std

Update Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 06-Sep-21 Time: 11:20:34

Batch Name 3 of 3

↑

SJS7091 572584 1-1 3052261/VII/21

↓

New Bat

Retrieve Bat

Store Bat

List Bat

Update Bat

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal


Date: 10-Sep-21 Time: 11:44:31

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 1.00

I:c Ratio: (2.00 1.00)

Measured by:

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/E	Color	Comments	
SJS7091 572584 1-1 3052261/VII/21	D65 10 Deg	0.04	-0.14	-0.30	0.02	0.15	0.35	0.38		Pass	too light	too bright	too blue
SJS7091 572584 1-1 3052261/VII/21	F11 10 Deg	-0.02	-0.11	-0.39	-0.01	0.14	0.45	0.47	0.11	Pass	too dark	too bright	too blue
SJS7091 572584 1-1 3052261/VII/21	A 10 Deg	0.01	-0.12	-0.40	0.00	0.24	0.42	0.48	0.11	Pass	too light	too bright	too blue

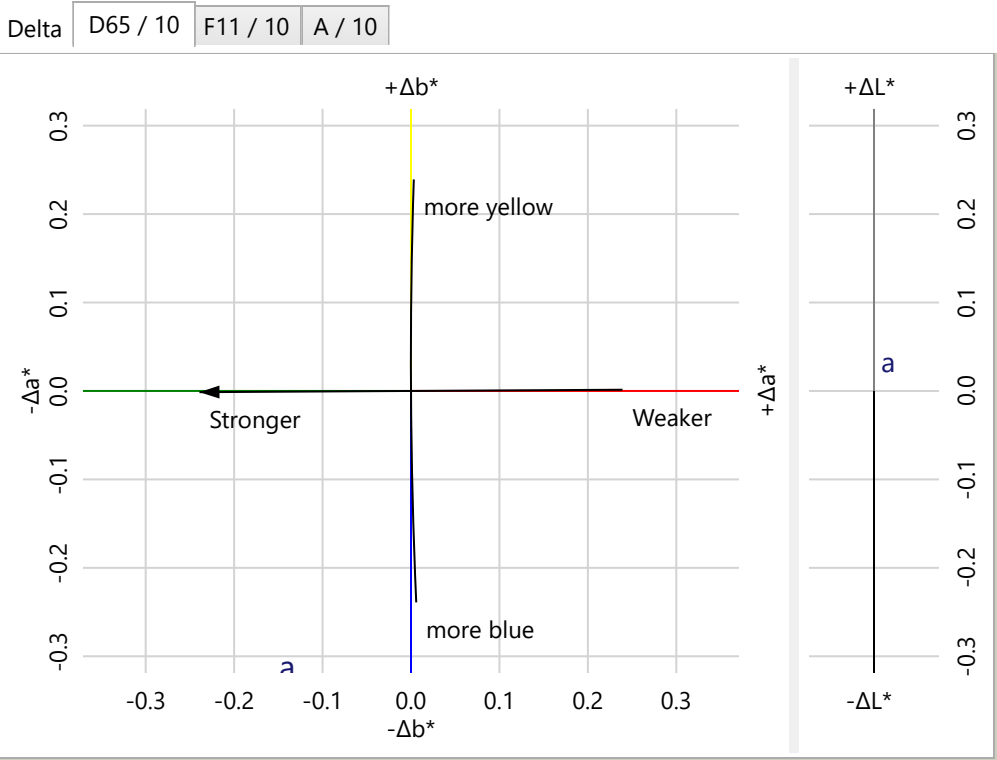

Single/All

CMC Plot

Zoom Out

Zoom In

Print Form