

Standard Name 79 of 82

↑

9B 1080-3 BRM

↓

Visual Hue Request:

New Std	Retrieve Std	Store Std	List Std	Update Std
---------	--------------	-----------	----------	------------

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal
Date: 10-Sep-21 Time: 11:42:00

Batch Name 1 of 2

↑

/ATR17080 B2209610AA-001 6-2 3053190/VII/21

↓

New Bat	Retrieve Bat	Store Bat	List Bat	Update Bat
---------	--------------	-----------	----------	------------


Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal
Date: 10-Sep-21 Time: 11:42:16

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 1.00
I:c Ratio: (2.00 1.00)

Measured by:

▼

<u>Batch Name</u>	<u>III/Obs</u>	<u>DL*</u>	<u>Da*</u>	<u>Db*</u>	<u>DL*/ISL</u>	<u>DC*/cSC</u>	<u>DH*/SH</u>	<u>CMC DE</u>	<u>M.I.</u>	<u>P/E</u>	<u>Color</u>	<u>Comments</u>
-------------------	----------------	------------	------------	------------	----------------	----------------	---------------	---------------	-------------	------------	--------------	-----------------

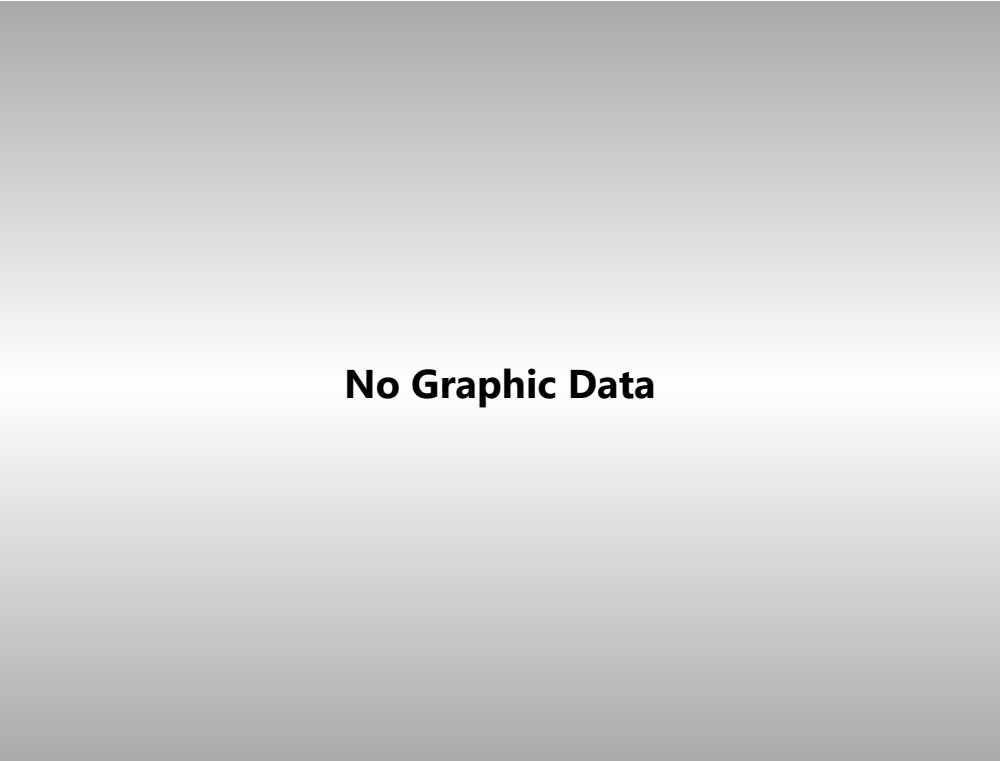

Single/All

CMC Plot

Zoom Out

Zoom In

Print Form