

Standard Name25 of 35

↑

20B 1083 CRD

↓

Visual Hue Request:

New StdRetrieve StdStore StdList StdUpdate Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 25-Jan-21Time: 08:34:43

Batch Name3 of 4

↑

TMKF-21-00321 282642 1-1 3004077/I/21

↓

New BatRetrieve BatStore BatList BatUpdate Bat


Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal

Date: 20-Mar-21Time: 08:49:51

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 1.00

I:c Ratio: (2.00 1.00)

DeltaU3500 / 10D65 / 10A / 10

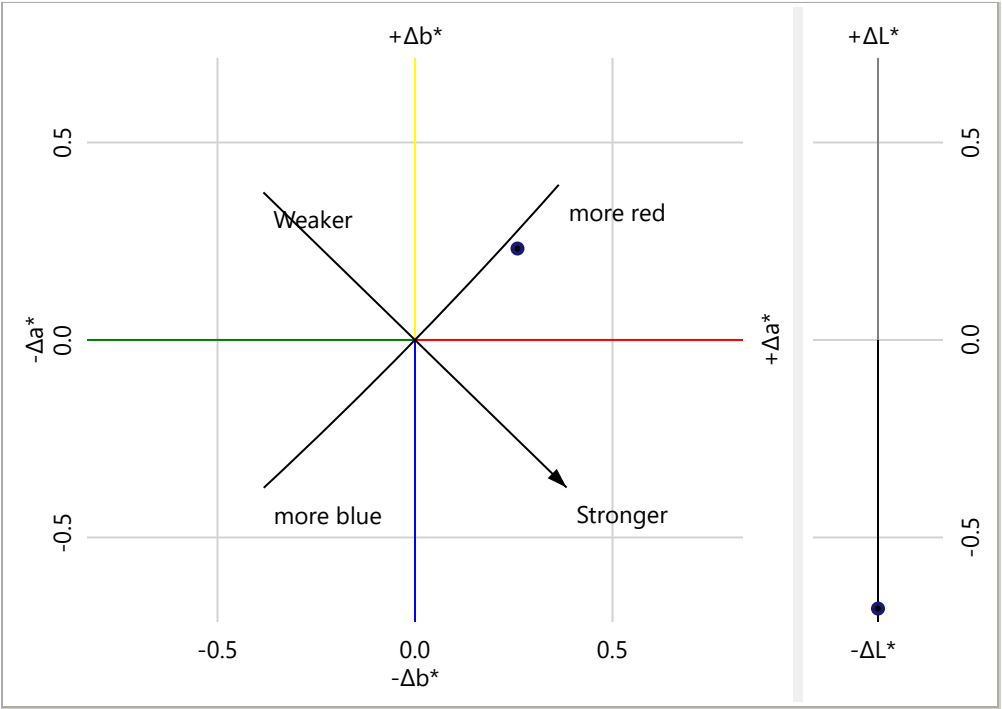

- Single/All
- CMC Plot
- Zoom Out
- Zoom In
- Print Form

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/E	Color	Comments
TMKF-21-00321 282642 1-1 3004077/I/21	U3500 10 Deg	0.68	0.26	0.23	-0.38	0.03	0.40	0.56		Pass	darker	more saturated more red
TMKF-21-00321 282642 1-1 3004077/I/21	D65 10 Deg	-0.69	0.39	0.20	-0.38	0.16	0.41	0.59	0.16	Pass	darker	more saturated more red
TMKF-21-00321 282642 1-1 3004077/I/21	A 10 Deg	-0.61	0.58	0.31	-0.34	0.31	0.57	0.73	0.38	Pass	darker	more saturated more red