

Standard Name 34 of 34

↑

7B 0650-6 ARD

↓

Visual Hue Request:

New Std	Retrieve Std	Store Std	List Std	Update Std
---------	--------------	-----------	----------	------------

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 26-Jul-18 Time: 10:46:45

Batch Name 1 of 3

↑

F3C17109 PR2122/68444 1-1 3051721/VII/21..

↓

New Bat	Retrieve Bat	Store Bat	List Bat	Update Bat
---------	--------------	-----------	----------	------------

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal

Date: 26-Sep-21 Time: 08:25:53


CMC DE Pass/Fail Tolerance: 1.00

I:c Ratio: (2.00 1.00)

Measured by:

▼

<u>Batch Name</u>	<u>III/Obs</u>	<u>DL*</u>	<u>Da*</u>	<u>Db*</u>	<u>DL*/ISL</u>	<u>DC*/cSC</u>	<u>DH*/SH</u>	<u>CMC DE</u>	<u>M.I.</u>	<u>P/E</u>	<u>Color</u>	<u>Comments</u>
-------------------	----------------	------------	------------	------------	----------------	----------------	---------------	---------------	-------------	------------	--------------	-----------------

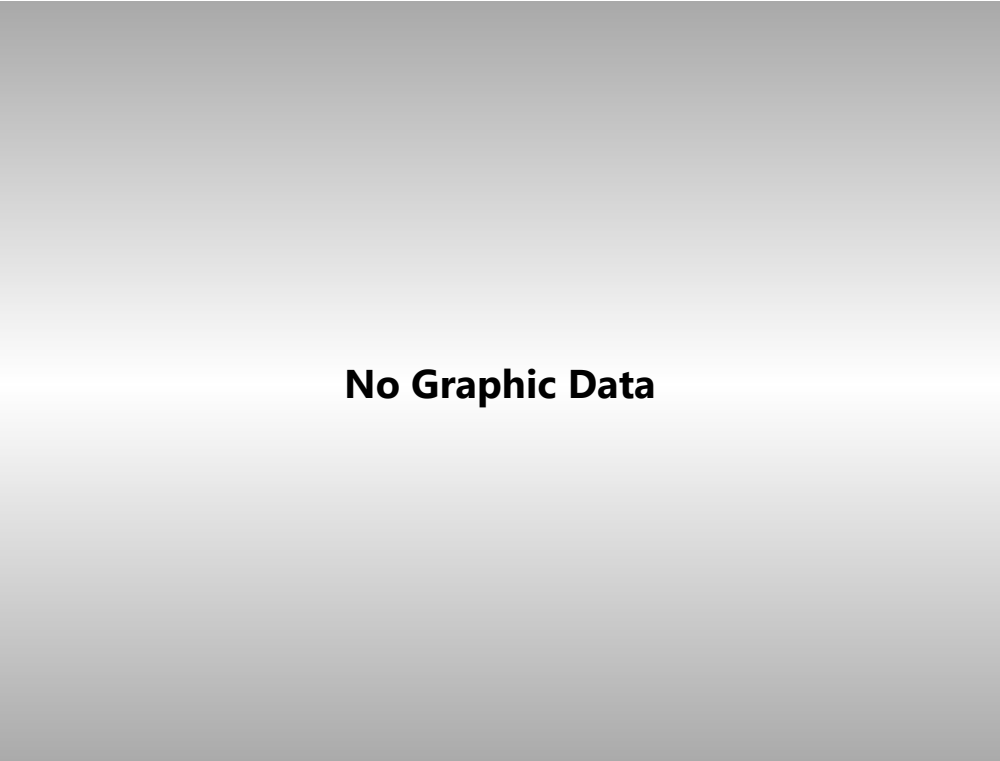

Single/All

CMC Plot

Zoom Out

Zoom In

Print Form