

Standard Name43 of 65

↑ AE66 Beige ToneF21 ↓

Visual Hue Request:

New StdRetrieve StdStore StdList Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 14-Dec-19Time: 07:56:49

Batch Name1 of 1

↑ 60017204 POA22102A/E8253 1-1 3029644 ↓

New BatRetrieve BatStore BatList Bat


Instrument Setup: %R LAV SCI UV 400

Date: 06-May-21Time: 16:48:52

Batch Name

60017204 POA22102A/E8253 1-1 3029644/IV/21 I1

60017204 POA22102A/E8253 1-1 3029644/IV/21 I1

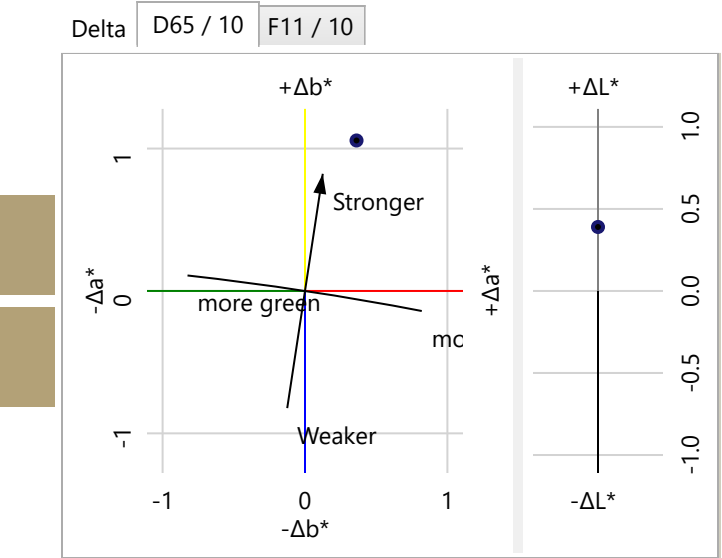

Single/AllZoom InZoom OutCMC PlotPrint Form

DataColor TOOLS 2.4.4S/N NO. 8823242

Standard %R						
400-450nm	32.79	28.36	24.69	21.34	19.05	18.00
460-510nm	18.12	18.52	21.42	26.51	31.71	33.07
520-570nm	32.81	32.30	32.13	32.28	33.01	34.31
580-630nm	36.13	37.84	39.02	39.44	39.93	41.35
640-690nm	44.19	48.64	54.23	60.40	66.97	71.71
700nm	76.89					

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 0.80

I:c Ratio: (2.00 1.00)

III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/F	Color	Comments
D65 10 Deg	0.39	0.36	1.06	0.16	0.65	-0.21	0.70		Warn	lighter	more saturated more red
F11 10 Deg	1.15	-1.32	2.57	0.47	1.32	1.87	2.34	2.38	Fail	lighter	more saturated more green