

Standard Name 50 of 73

↑

19053/220277L-A

↓

Visual Hue Request:

New Std	Retrieve Std	Store Std	List Std	Update Std
---------	--------------	-----------	----------	------------

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 16-Jun-22 Time: 08:57:33

Batch Name 1 of 1

↑

PR2223/615994 3-1 3058475/X/22 FLUSH PINK

↓

New Bat	Retrieve Bat	Store Bat	List Bat	Update Bat
---------	--------------	-----------	----------	------------

Instrument Setup: %R LAV SCI UV 400


Date: 02-Nov-22 Time: 10:32:40

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 1.00

I:c Ratio: (2.00 1.00)

Measured by:

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/E	Color Comments			
SPQ19053 PR2223/615994 3-1 3058475/X/22 FLUSH PINK	D65 10 Deg	0.76	0.57	0.36	0.28	0.51	0.28	0.65		Pass	too light	too bright	too yellow	
SPQ19053 PR2223/615994 3-1 3058475/X/22 FLUSH PINK	F11 10 Deg	0.81	0.59	0.43	0.30	0.54	0.28	0.68	0.08	Pass	too light	too bright	too yellow	
SPQ19053 PR2223/615994 3-1 3058475/X/22 FLUSH PINK	A 10 Deg	0.85	0.62	0.51	0.31	0.58	0.30	0.72	0.16	Pass	too light	too bright	too yellow	

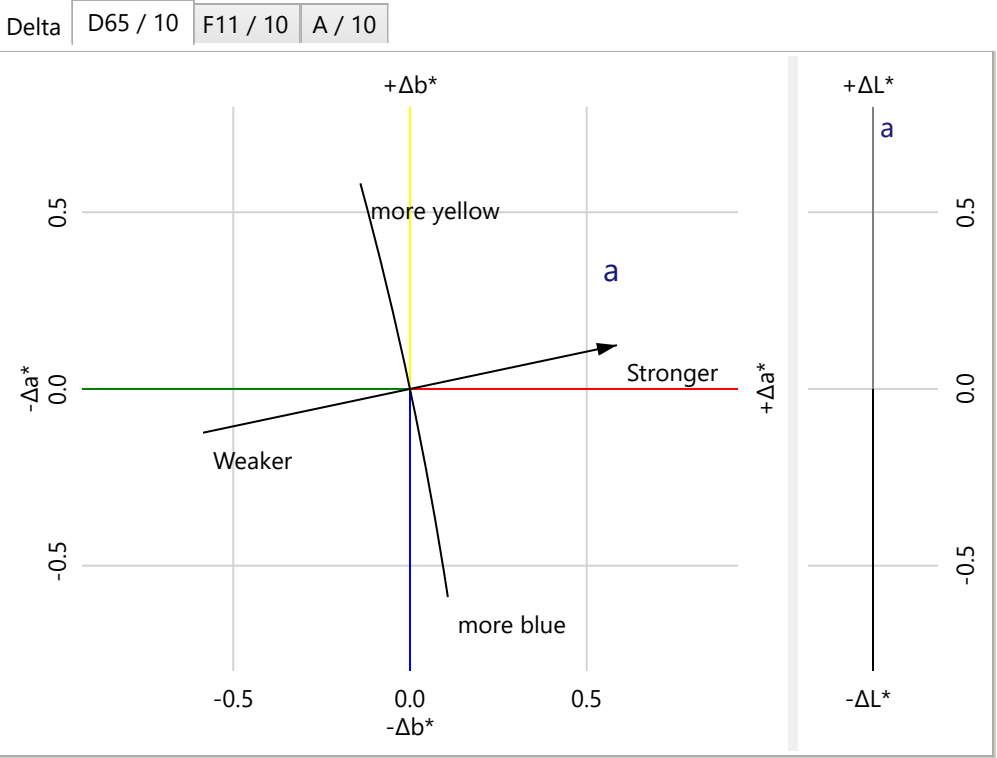

Single/All

CMC Plot

Zoom Out

Zoom In

Print Form