

Standard Name 222 of 222

↑

21B 0328 BRD

↓

Visual Hue Request:

New StdRetrieve StdStore StdList StdUpdate Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 19-Sep-21 Time: 09:28:14

Batch Name 3 of 3

↑

R1117235 572584 1-1 3052261/VII/21 CCK F3T

↓

New BatRetrieve BatStore BatList BatUpdate Bat

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal


Date: 19-Sep-21 Time: 09:29:31

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 1.00

I:c Ratio: ( 2.00 1.00)

Measured by:

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/F	Color	Comments	
R1117235 572584 1-1 3052261/VII/21 CCK F3T18157	D65 10 Deg	0.74	-1.07	0.57	0.35	0.45	0.80	0.98		Warn	too light	too bright	too blue
R1117235 572584 1-1 3052261/VII/21 CCK F3T18157	F11 10 Deg	0.38	0.97	0.18	0.18	0.05	-0.86	0.88	2.08	Pass	too light	too bright	too yellow
R1117235 572584 1-1 3052261/VII/21 CCK F3T18157	A 10 Deg	0.64	0.23	-0.19	0.30	-0.10	-0.25	0.41	1.46	Pass	too light	too dull	too red

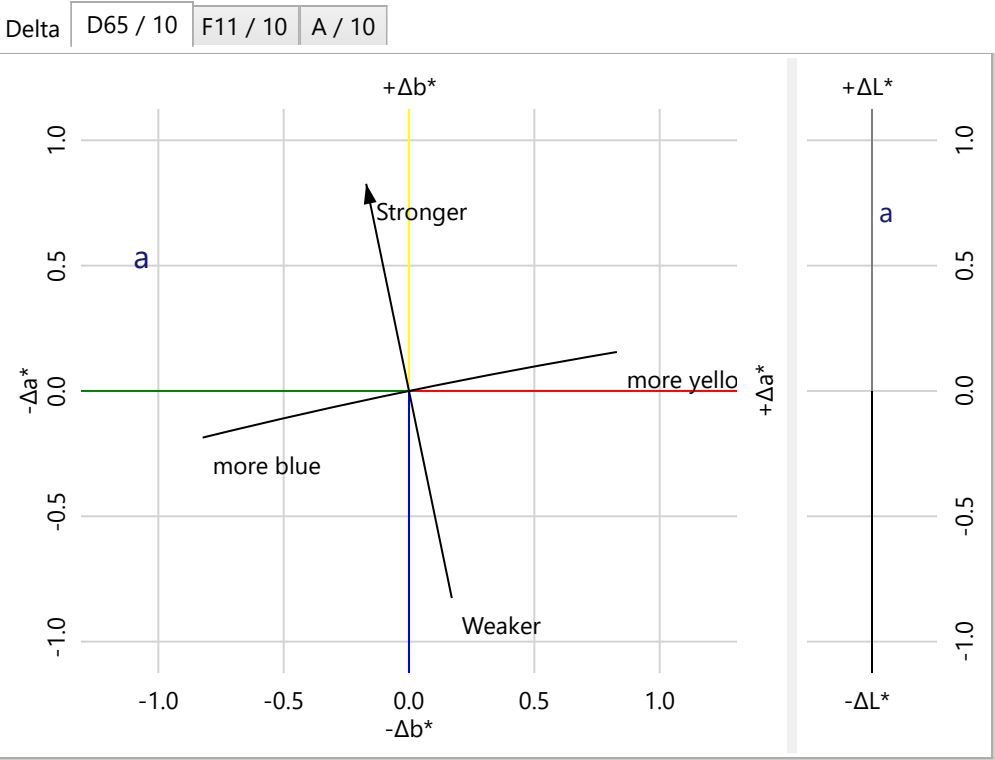

- Single/All
- CMC Plot
- Zoom Out
- Zoom In
- Print Form