

Standard Name31 of 161

↑

19053/190293D-C

↓

Visual Hue Request:

New StdRetrieve StdStore StdList StdUpdate Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 13-Dec-22Time: 16:26:06

Batch Name1 of 1

↑

3 5329885 1-1 3060225/X/22 GRAPHITE GREY

↓

New BatRetrieve BatStore BatList BatUpdate Bat

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal


Date: 01-Feb-23Time: 15:58:05

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 1.00

I:c Ratio: ( 2.00 1.00)

Measured by:

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/F	Color	Comments	
SPQ19053 5329885 1-1 3060225/X/22 GRAPHITE GREY	D65 10 Deg	0.82	0.23	-0.29	0.59	0.45	0.22	0.77		Warn	too light	too bright	too red
SPQ19053 5329885 1-1 3060225/X/22 GRAPHITE GREY	F11 10 Deg	0.77	0.30	-0.42	0.55	0.46	0.51	0.88	0.16	Warn	too light	too bright	too red
SPQ19053 5329885 1-1 3060225/X/22 GRAPHITE GREY	A 10 Deg	0.83	0.26	-0.27	0.59	0.49	0.03	0.77	0.02	Warn	too light	too bright	too red

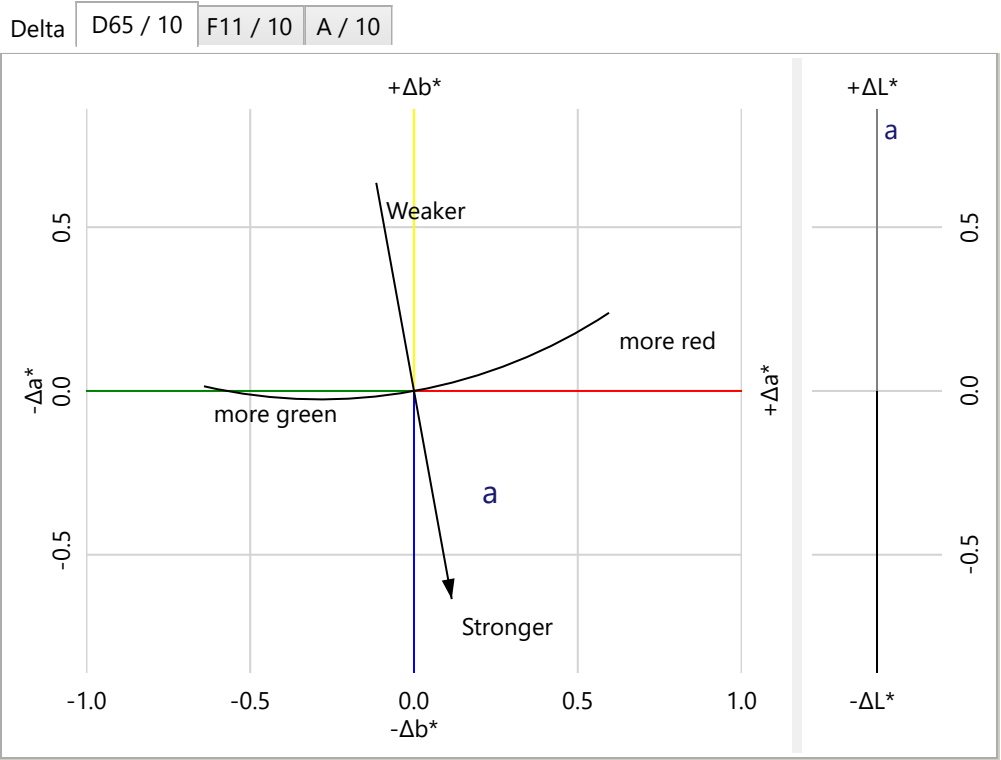

Single/All

CMC Plot

Zoom Out

Zoom In

Print Form