

Standard Name141 of 164

↑

17080/220109M-C

↓

Visual Hue Request:

New StdRetrieve StdStore StdList StdUpdate Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 01-Nov-22Time: 20:20:53

Batch Name1 of 1

↑

PR2223/616268 33435 EXP2201130 UTILITY BL

↓

New BatRetrieve BatStore BatList BatUpdate Bat

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal


Date: 08-Nov-22Time: 14:58:35

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 1.00

I:c Ratio: (2.00 1.00)

Measured by:

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/E	Color	Comments	
R1117150 PR2223/616268 33435 EXP2201130 UTILITY BL	D65 10 Deg	-1.22	-0.06	0.72	-0.57	-0.42	-0.35	0.79		Warn	too dark	too dull	too green
R1117150 PR2223/616268 33435 EXP2201130 UTILITY BL	F11 10 Deg	-1.21	0.08	0.75	-0.57	-0.45	-0.20	0.76	0.13	Warn	too dark	too dull	too green
R1117150 PR2223/616268 33435 EXP2201130 UTILITY BL	A 10 Deg	-1.16	0.24	0.79	-0.55	-0.49	-0.13	0.75	0.25	Pass	too dark	too dull	too green

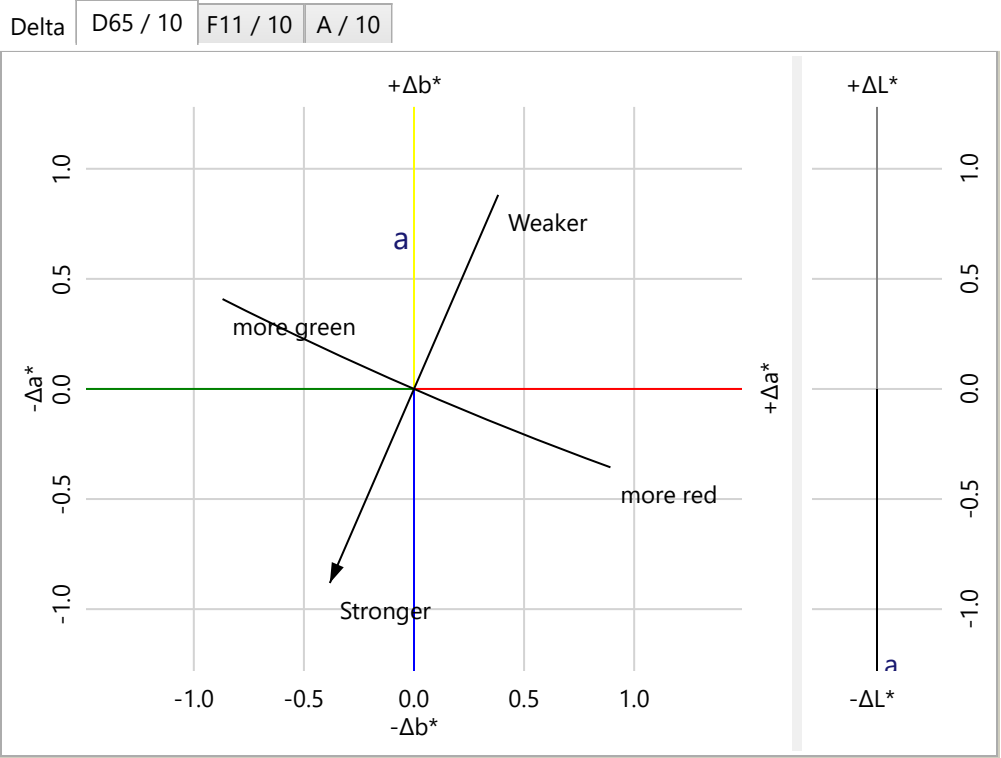

Single/All

CMC Plot

Zoom Out

Zoom In

Print Form