

Standard Name75 of 76

↑

21C 1047 ARD

↓

Visual Hue Request:

New StdRetrieve StdStore StdList StdUpdate Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 16-Dec-21Time: 10:23:22

Batch Name1 of 3

↑

F3T18157 5309723 4-4 3029150/V/22

↓

New BatRetrieve BatStore BatList BatUpdate Bat

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal


Date: 06-Jul-22Time: 13:09:02

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 1.00

I:c Ratio: ( 2.00 1.00)

Measured by:

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/E	Color	Comments	
F3T18157 5309723 4-4 3029150/V/22	D65 10 Deg	0.03	-0.67	0.76	0.01	-0.39	-0.44	0.59		Pass	too light	too dull	too green
F3T18157 5309723 4-4 3029150/V/22	F11 10 Deg	0.06	-0.59	0.94	0.03	-0.42	-0.37	0.56	0.18	Pass	too light	too dull	too green
F3T18157 5309723 4-4 3029150/V/22	A 10 Deg	0.04	-0.40	0.74	0.02	-0.30	-0.34	0.46	0.22	Pass	too light	too dull	too green

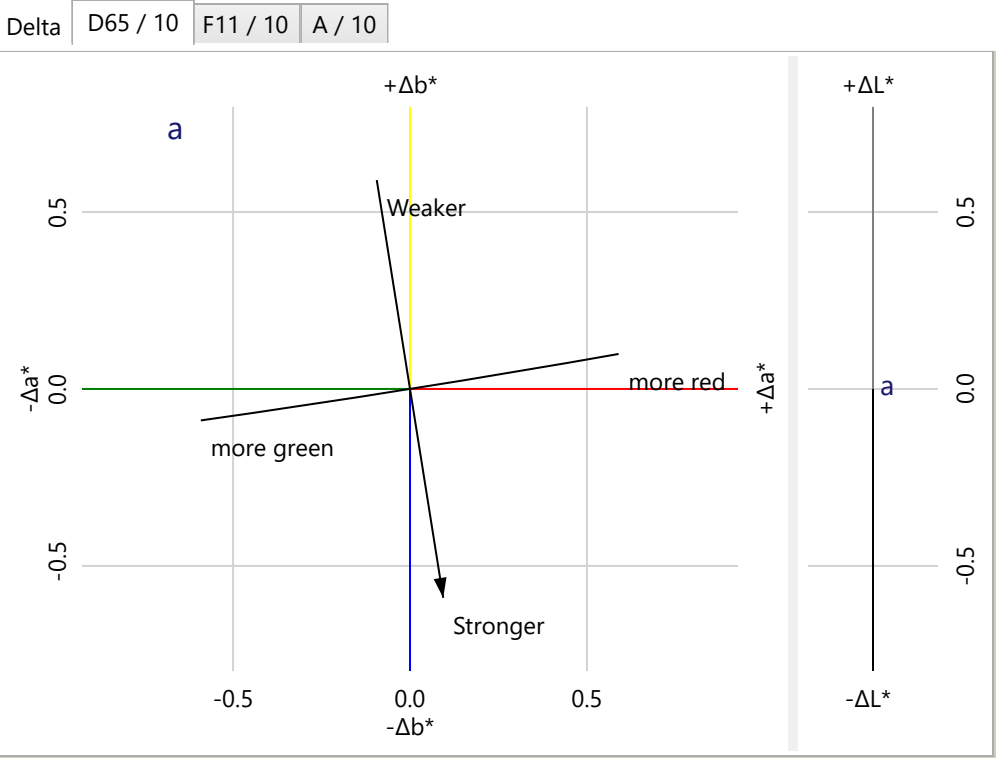

Single/All

CMC Plot

Zoom Out

Zoom In

Print Form