

Standard Name 222 of 222

↑

21B 0328 BRD

↓

Visual Hue Request:

New Std

Retrieve Std

Store Std

List Std

Update Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 19-Sep-21 Time: 09:28:14

Batch Name 2 of 3

↑

SJS7091 572584 1-1 3052261/VII/21

↓

New Bat

Retrieve Bat

Store Bat

List Bat

Update Bat

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal


Date: 19-Sep-21 Time: 09:29:15

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 1.00

I:c Ratio: ( 2.00 1.00)

Measured by:

Batch Name			III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/E	Color	Comments
SJS7091 572584	1-1	3052261/VII/21	D65 10 Deg	1.08	-0.35	0.19	0.52	0.15	0.26	0.60		Pass	too light	too blue
SJS7091 572584	1-1	3052261/VII/21	F11 10 Deg	0.84	1.07	-0.08	0.40	-0.10	-0.92	1.00	1.42	Pass	too light	too yellow
SJS7091 572584	1-1	3052261/VII/21	A 10 Deg	1.04	0.49	-0.24	0.49	-0.11	-0.53	0.73	0.83	Pass	too light	too red

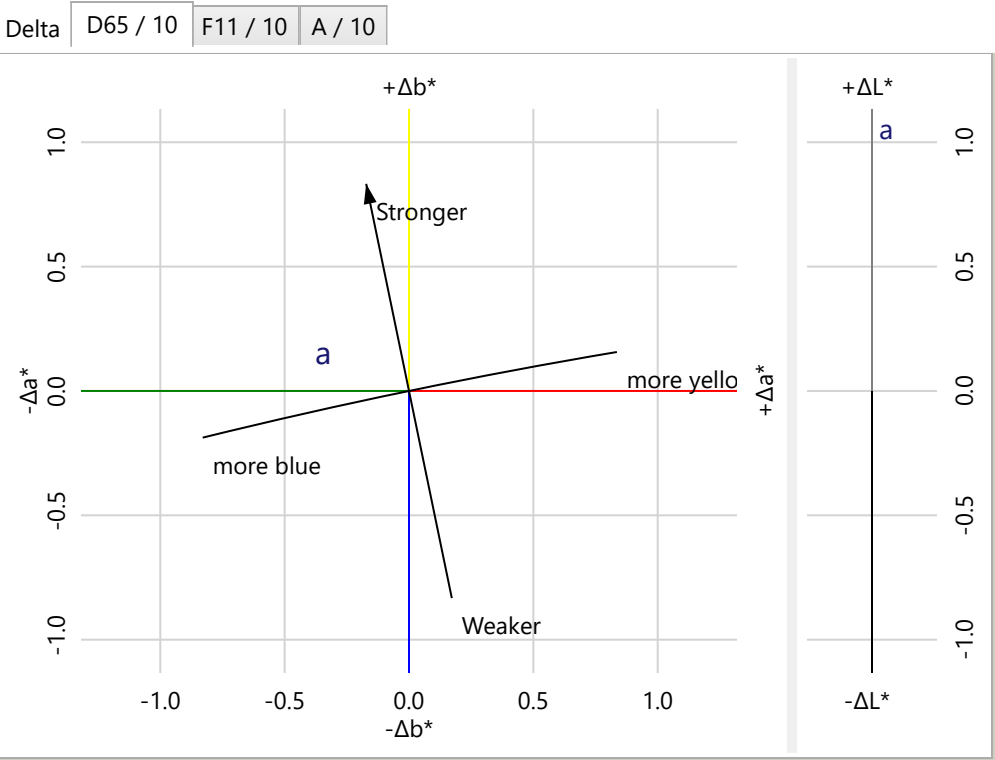

- Single/All
- CMC Plot
- Zoom Out
- Zoom In
- Print Form