

Standard Name151 of 152

↑

20C 0701-1 ARD

↓

Visual Hue Request:

New StdRetrieve StdStore StdList StdUpdate Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 13-Aug-20Time: 11:50:07

Batch Name2 of 3

↑

B22165410A-001 1-1 3046847/VII/22 MALDIVE

↓

New BatRetrieve BatStore BatList BatUpdate Bat

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal


Date: 22-Sep-22Time: 13:54:06

CMC DE Pass/Fail Tolerance:1.00

I:c Ratio: (2.001.00)

Measured by:

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/E	Color	Comments	
R1117235 B22165410A-001 1-1 3046847/VII/22 MALDIVE	D65 10 Deg	0.04	-0.61	1.40	0.02	0.32	-0.78	0.84		Warn	too light	too bright	too yellow
R1117235 B22165410A-001 1-1 3046847/VII/22 MALDIVE	F11 10 Deg	0.06	-0.20	1.51	0.03	0.13	-0.95	0.96	0.42	Warn	too light	too bright	too yellow
R1117235 B22165410A-001 1-1 3046847/VII/22 MALDIVE	A 10 Deg	0.08	-0.11	1.32	0.04	-0.05	-0.78	0.78	0.48	Warn	too light	too dull	too yellow

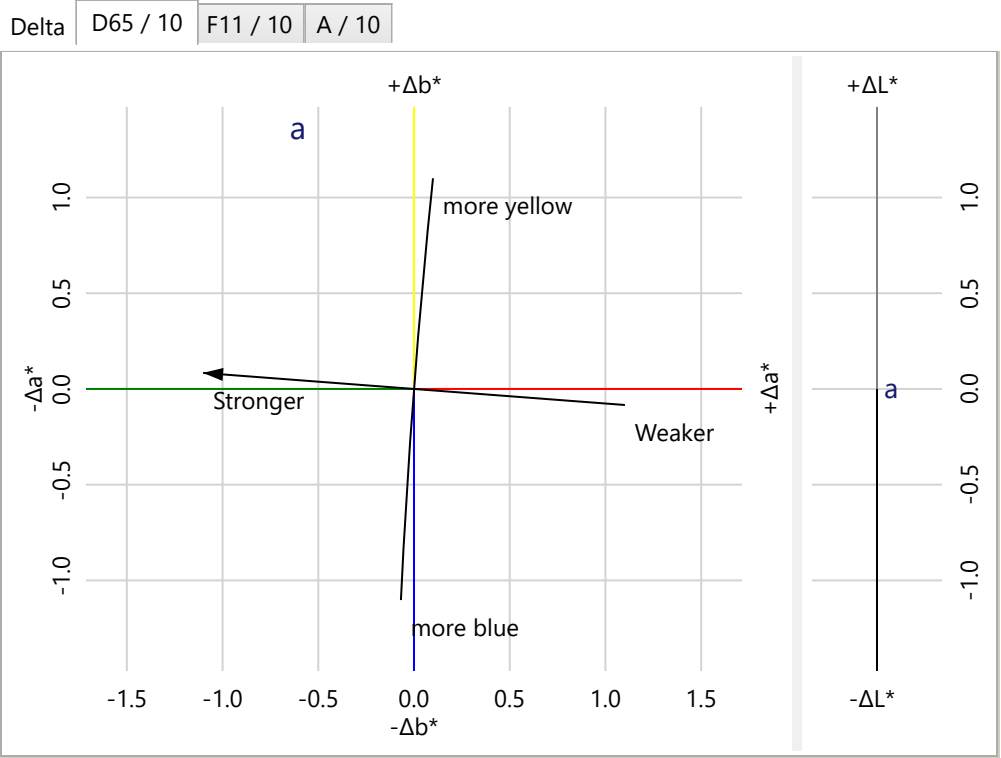

Single/All

CMC Plot

Zoom Out

Zoom In

Print Form