

Standard Name164 of 219

↑

18402/171350S-D

↓

Visual Hue Request:

New StdRetrieve StdStore StdList StdUpdate Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 06-Feb-23Time: 21:54:41

Batch Name4 of 5

↑

13455 4501883251 85434 EXP2300650 BLACK

↓

New BatRetrieve BatStore BatList BatUpdate Bat

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal


Date: 26-Sep-23Time: 13:18:45

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 1.00

I:c Ratio: (2.00 1.00)

Measured by:

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/F	Color	Comments	
R2213455 4501883251 85434 EXP2300650 BLACK	D65 10 Deg	-0.61	0.07	-0.57	-0.57	0.79	0.01	0.97		Warn	too dark	too bright	too red
R2213455 4501883251 85434 EXP2300650 BLACK	F11 10 Deg	-0.62	0.12	-0.63	-0.59	0.71	0.45	1.03	0.08	Fail	too dark	too bright	too red
R2213455 4501883251 85434 EXP2300650 BLACK	A 10 Deg	-0.65	-0.14	-0.61	-0.61	0.60	-0.60	1.05	0.20	Fail	too dark	too bright	too blue

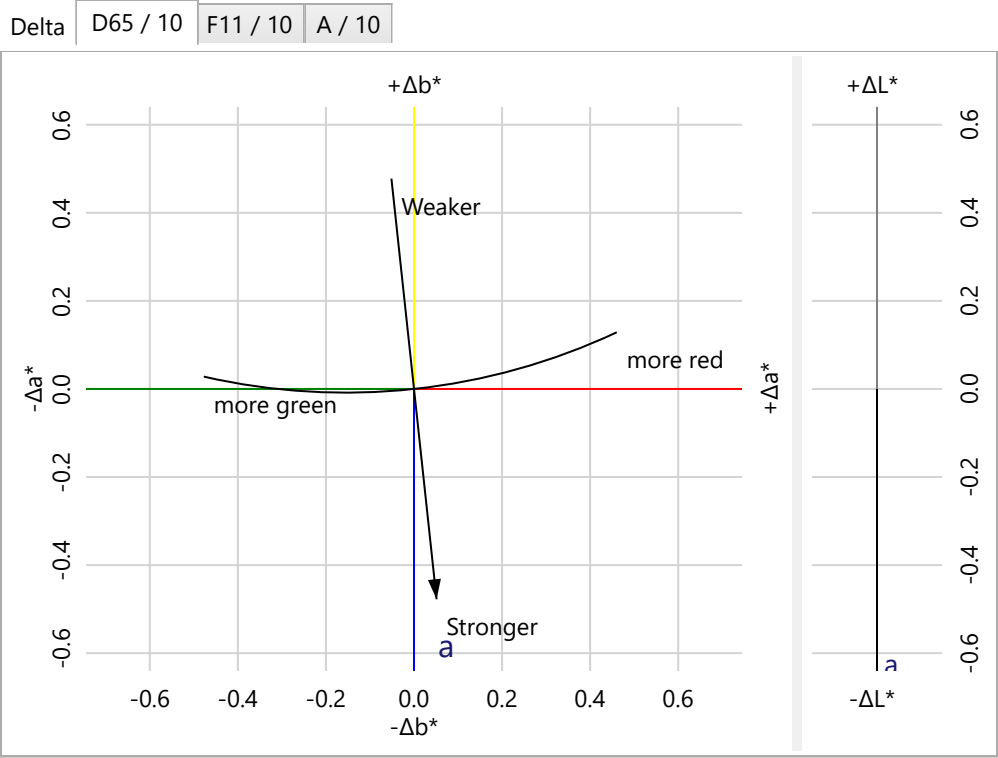

Single/All

CMC Plot

Zoom Out

Zoom In

Print Form