

Standard Name 315 of 344

↑

18157/220759M-A

↓

Visual Hue Request:

New StdRetrieve StdStore StdList StdUpdate Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 19-Oct-22Time: 14:01:15

Batch Name 2 of 2

↑

088711AA-001 79543 DOM2300528 RED DUST

↓

New BatRetrieve BatStore BatList BatUpdate Bat

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal


Date: 06-Jul-23Time: 15:18:41

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 1.00

I:c Ratio: (2.00 1.00)

Measured by:

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/F	Color	Comments	
SJS7091 B23088711AA-001 79543 DOM2300528 RED DUST	D65 10 Deg	0.35	0.02	-0.08	0.17	-0.01	-0.09	0.19		Pass	too light	too dull	too blue
SJS7091 B23088711AA-001 79543 DOM2300528 RED DUST	F11 10 Deg	0.28	-0.08	-0.19	0.13	-0.10	-0.16	0.23	0.17	Pass	too light	too dull	too blue
SJS7091 B23088711AA-001 79543 DOM2300528 RED DUST	A 10 Deg	0.34	-0.11	-0.07	0.16	-0.08	-0.02	0.18	0.13	Pass	too light	too dull	too blue

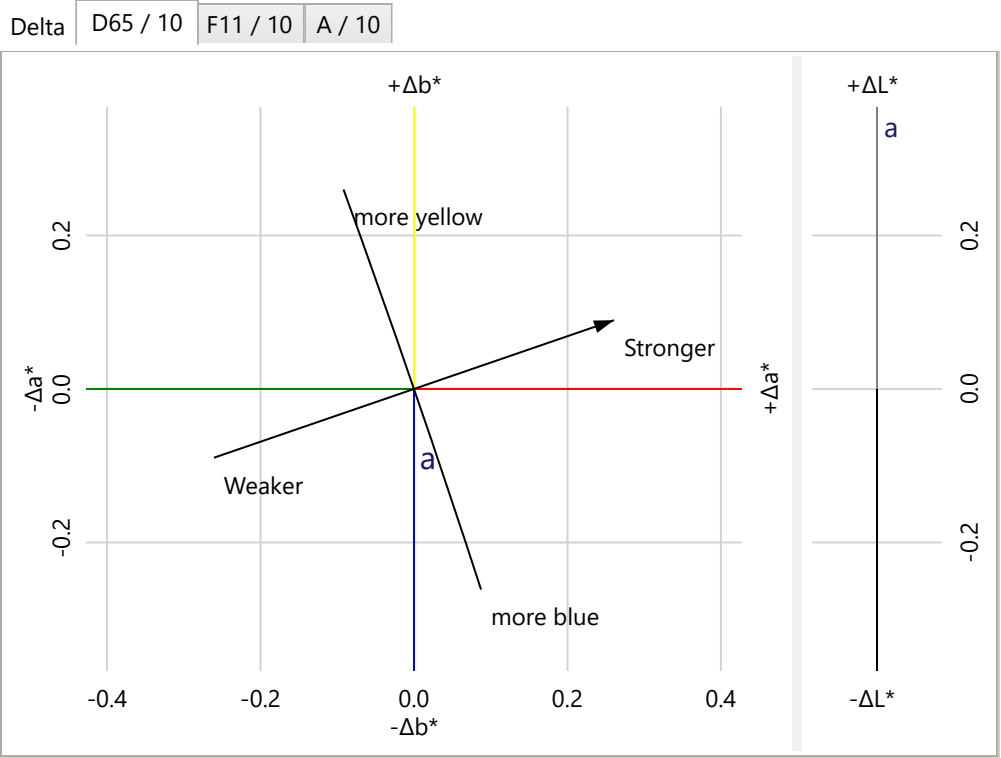

Single/All

CMC Plot

Zoom Out

Zoom In

Print Form