

Standard Name38 of 64

↑

17109/210497S-B

↓

Visual Hue Request:

New StdRetrieve StdStore StdList StdUpdate Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 30-Dec-22Time: 08:20:02

Batch Name2 of 3

↑

5 4501932443 104907 EXP2300888 TRUE RED

↓

New BatRetrieve BatStore BatList BatUpdate Bat

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal


Date: 21-Dec-23Time: 16:35:56

CMC DE Pass/Fail Tolerance:0.80

I:c Ratio: (2.00 1.00)

Measured by:

<u>Batch Name</u>	<u>III/Obs</u>	<u>DL*</u>	<u>Da*</u>	<u>Db*</u>	<u>DL*/ISL</u>	<u>DC*/cSC</u>	<u>DH*/SH</u>	<u>CMC DE</u>	<u>M.I.</u>	<u>P/F</u>	<u>Color</u>	<u>Comments</u>	
R2213455 4501932443 104907 EXP2300888 TRUE RED	D65 10 Deg	0.29	-0.82	-1.38	0.15	-0.47	-0.54	0.73		Warn	too light	too dull	too blue
R2213455 4501932443 104907 EXP2300888 TRUE RED	F11 10 Deg	0.22	-0.55	-1.49	0.11	-0.45	-0.64	0.79	0.38	Pass	too light	too dull	too blue

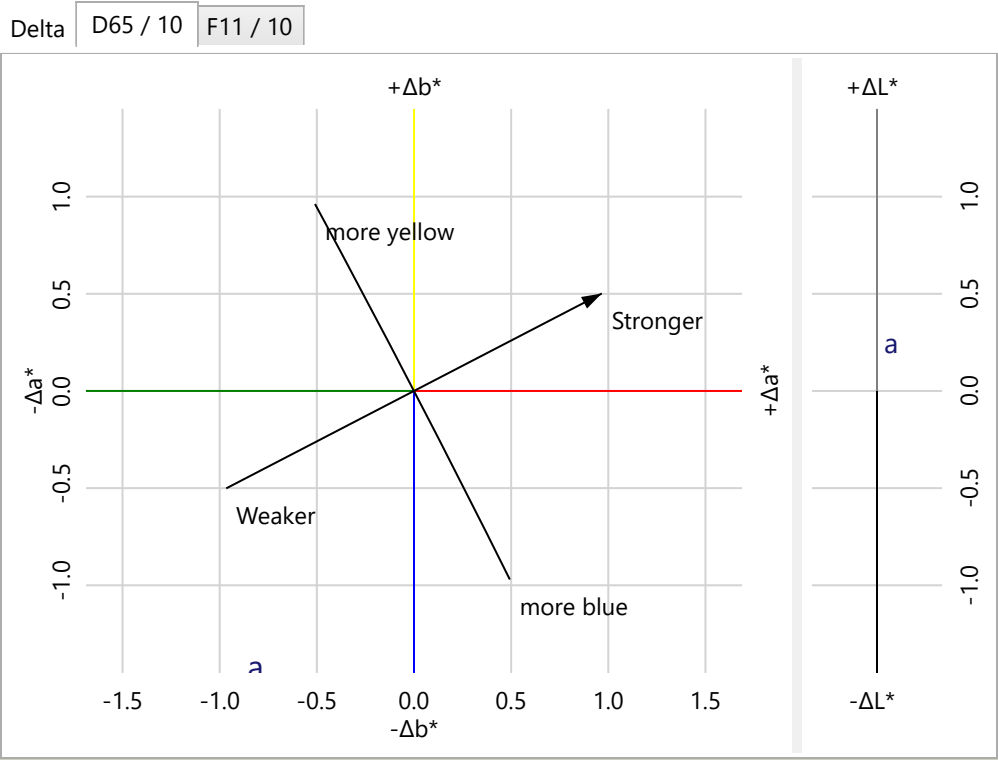

Single/All

CMC Plot

Zoom Out

Zoom In

Print Form