

Standard Name115 of 140

↑

17109/230096M-A

↓

Visual Hue Request:

New Std

Retrieve Std

Store Std

List Std

Update Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 23-Feb-23Time: 15:12:58

Batch Name1 of 2

↑

2324/68731 84992 EXP2300635 CYBER VIOLE

↓

New Bat

Retrieve Bat

Store Bat

List Bat

Update Bat

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal


Date: 09-Sep-23Time: 08:28:09

CMC DE Pass/Fail Tolerance:1.00

I:c Ratio: (2.00 1.00)

Measured by:

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/E	Color Comments			
F3C17109 PR2324/68731 84992 EXP2300635 CYBER VIOLE	D65 10 Deg	1.02	-0.18	0.35	0.49	-0.21	0.29	0.60		Pass	too light	too dull	too red	
F3C17109 PR2324/68731 84992 EXP2300635 CYBER VIOLE	F11 10 Deg	1.02	-0.25	0.34	0.48	-0.26	0.26	0.61	0.07	Pass	too light	too dull	too red	
F3C17109 PR2324/68731 84992 EXP2300635 CYBER VIOLE	A 10 Deg	1.03	-0.29	0.37	0.48	-0.25	0.35	0.65	0.11	Pass	too light	too dull	too red	

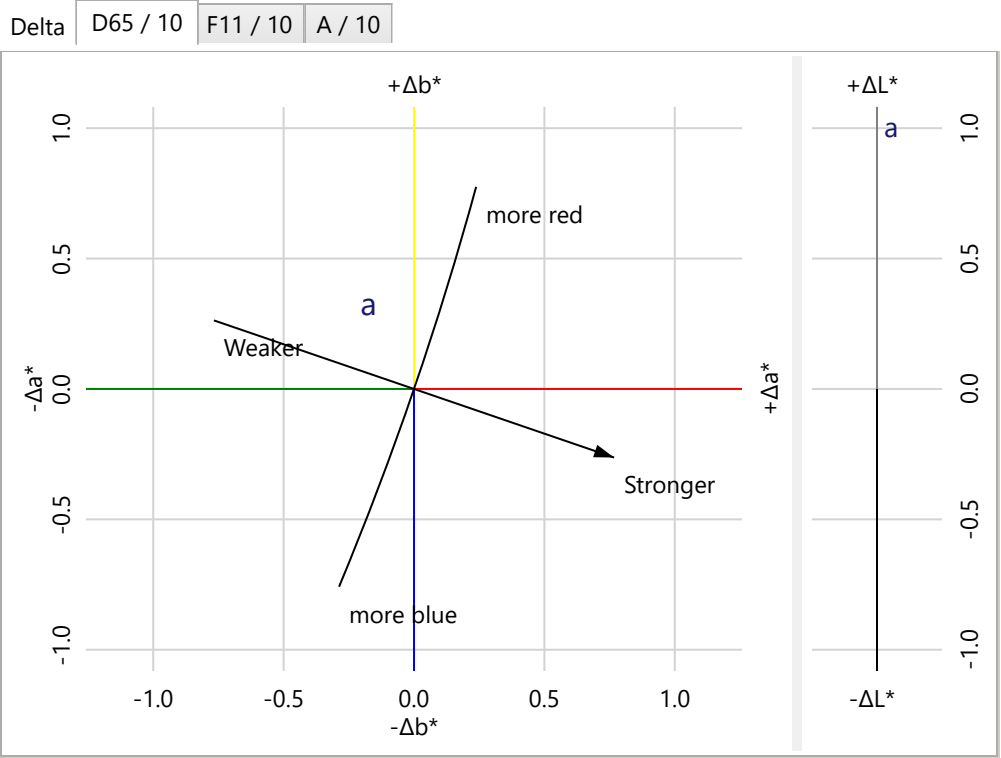

Single/All

CMC Plot

Zoom Out

Zoom In

Print Form