

Standard Name74 of 85

↑

19106/210972L-B

↓

Visual Hue Request:

New StdRetrieve StdStore StdList StdUpdate Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 20-May-23Time: 05:40:15

Batch Name1 of 3

↑

06 23090117IR-01 90879 EXXP2300370 POWDE

↓

New BatRetrieve BatStore BatList BatUpdate Bat

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal


Date: 02-Sep-23Time: 11:20:37

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 1.00

I:c Ratio: (2.00 1.00)

Measured by:

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/E	Color	Comments	
DKF19106 23090117IR-01 90879 EXXP2300370 POWDER BL	D65 10 Deg	-2.45	-0.33	-0.38	-0.89	0.44	0.05	0.99		Warn	too dark	too bright	too blue
DKF19106 23090117IR-01 90879 EXXP2300370 POWDER BL	F11 10 Deg	-2.46	-0.74	-0.47	-0.89	0.69	-0.32	1.17	0.43	Warn	too dark	too bright	too yellow
DKF19106 23090117IR-01 90879 EXXP2300370 POWDER BL	A 10 Deg	-2.52	-0.61	-0.38	-0.92	0.54	-0.23	1.09	0.33	Pass	too dark	too bright	too yellow

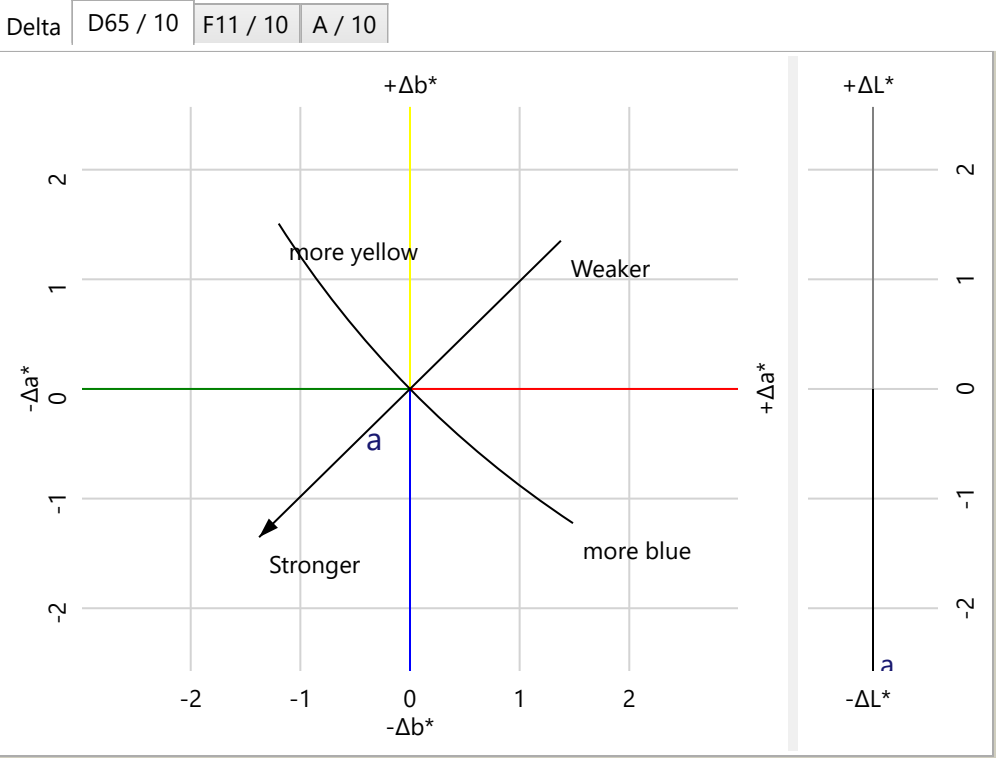

Single/All

CMC Plot

Zoom Out

Zoom In

Print Form