

Standard Name 149 of 159

↑

18402/220553L-B

↓

Visual Hue Request:

New StdRetrieve StdStore StdList StdUpdate Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal  
Date: 05-Sep-22Time: 11:31:02

Batch Name 1 of 2

↑

1-A01ACB 55041 EXP2300145MEADOWSWEE

↓

New BatRetrieve BatStore BatList BatUpdate Bat


Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal  
Date: 17-Mar-23Time: 11:41:30

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 1.00

I:c Ratio: ( 2.00 1.00)

Measured by:

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/F	Color	Comments	
HJY18402 LU00181-A01ACB 55041 EXP2300145MEADOWSWEE	55 10 Deg	0.55	-0.33	-0.27	0.20	-0.12	-0.39	0.45		Pass	too light	too dull	too blue
HJY18402 LU00181-A01ACB 55041 EXP2300145MEADOWSWEE	51 10 Deg	0.51	-0.47	-0.40	0.18	-0.17	-0.55	0.60	0.19	Pass	too light	too dull	too blue
HJY18402 LU00181-A01ACB 55041 EXP2300145MEADOWSWEE	40 10 Deg	0.49	-0.53	-0.32	0.18	-0.30	-0.48	0.59	0.21	Pass	too light	too dull	too blue

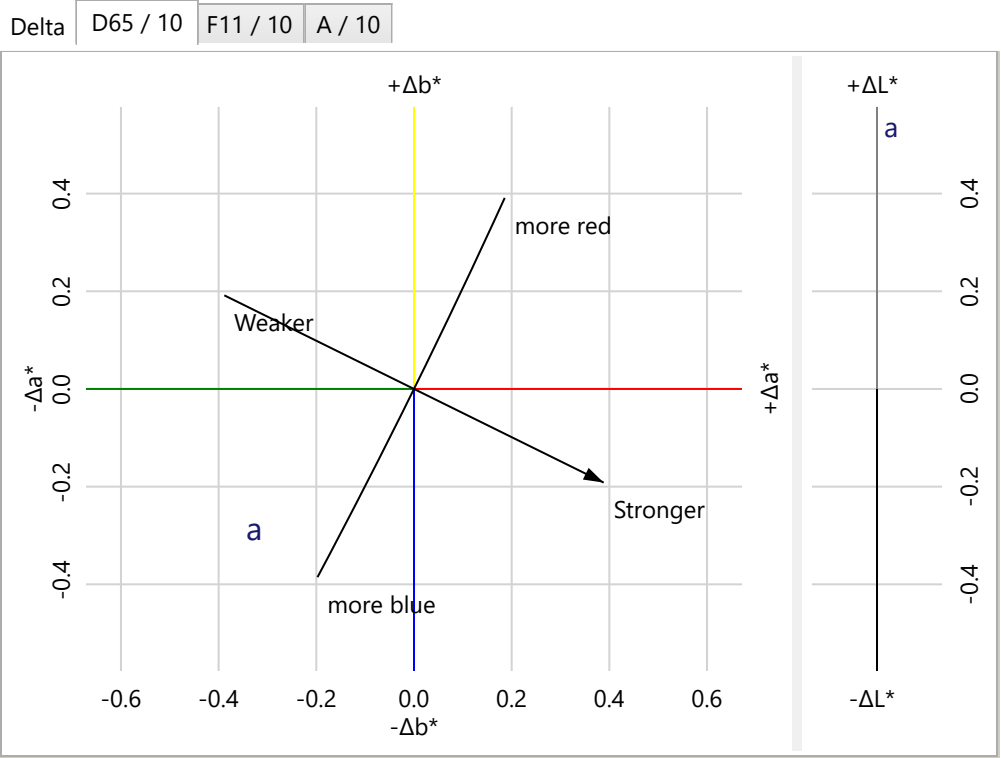

Single/All

CMC Plot

Zoom Out

Zoom In

Print Form