

Standard Name 84 of 110

↑

19053/230149M-B

↓

Visual Hue Request:

New StdRetrieve StdStore StdList StdUpdate Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 06-Mar-23Time: 13:28:03

Batch Name 1 of 1

↑

A23070228-1083 85227 EXP2300640 CORAL KI

↓

New BatRetrieve BatStore BatList BatUpdate Bat

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal


Date: 19-Aug-23Time: 09:51:09

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 1.00

I:c Ratio: (2.00 1.00)

Measured by:

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/F	Color	Comments	
SPQ19053 DA23070228-1083 85227 EXP2300640 CORAL KI	D65 10 Deg	0.19	0.36	-0.35	0.08	0.03	-0.41	0.42		Pass	too light	too bright	too blue
SPQ19053 DA23070228-1083 85227 EXP2300640 CORAL KI	F11 10 Deg	0.26	0.42	-0.27	0.10	0.05	-0.40	0.42	0.10	Pass	too light	too bright	too red
SPQ19053 DA23070228-1083 85227 EXP2300640 CORAL KI	A 10 Deg	0.21	0.06	-0.18	0.08	-0.03	-0.14	0.17	0.36	Pass	too light	too dull	too red

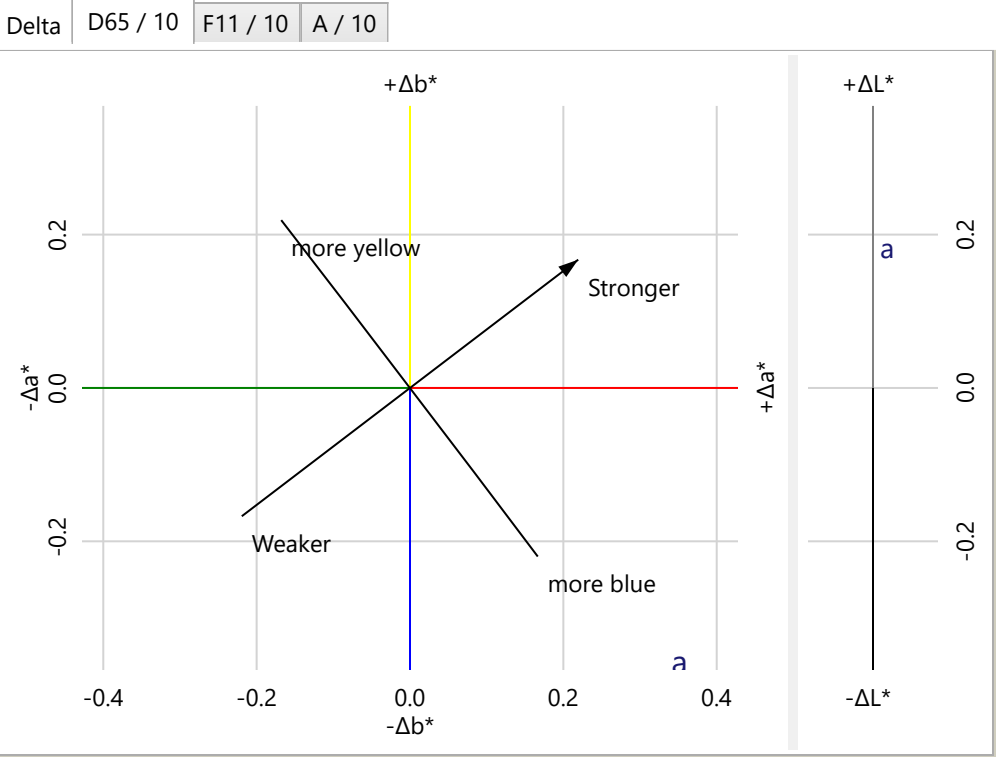

Single/All

CMC Plot

Zoom Out

Zoom In

Print Form