

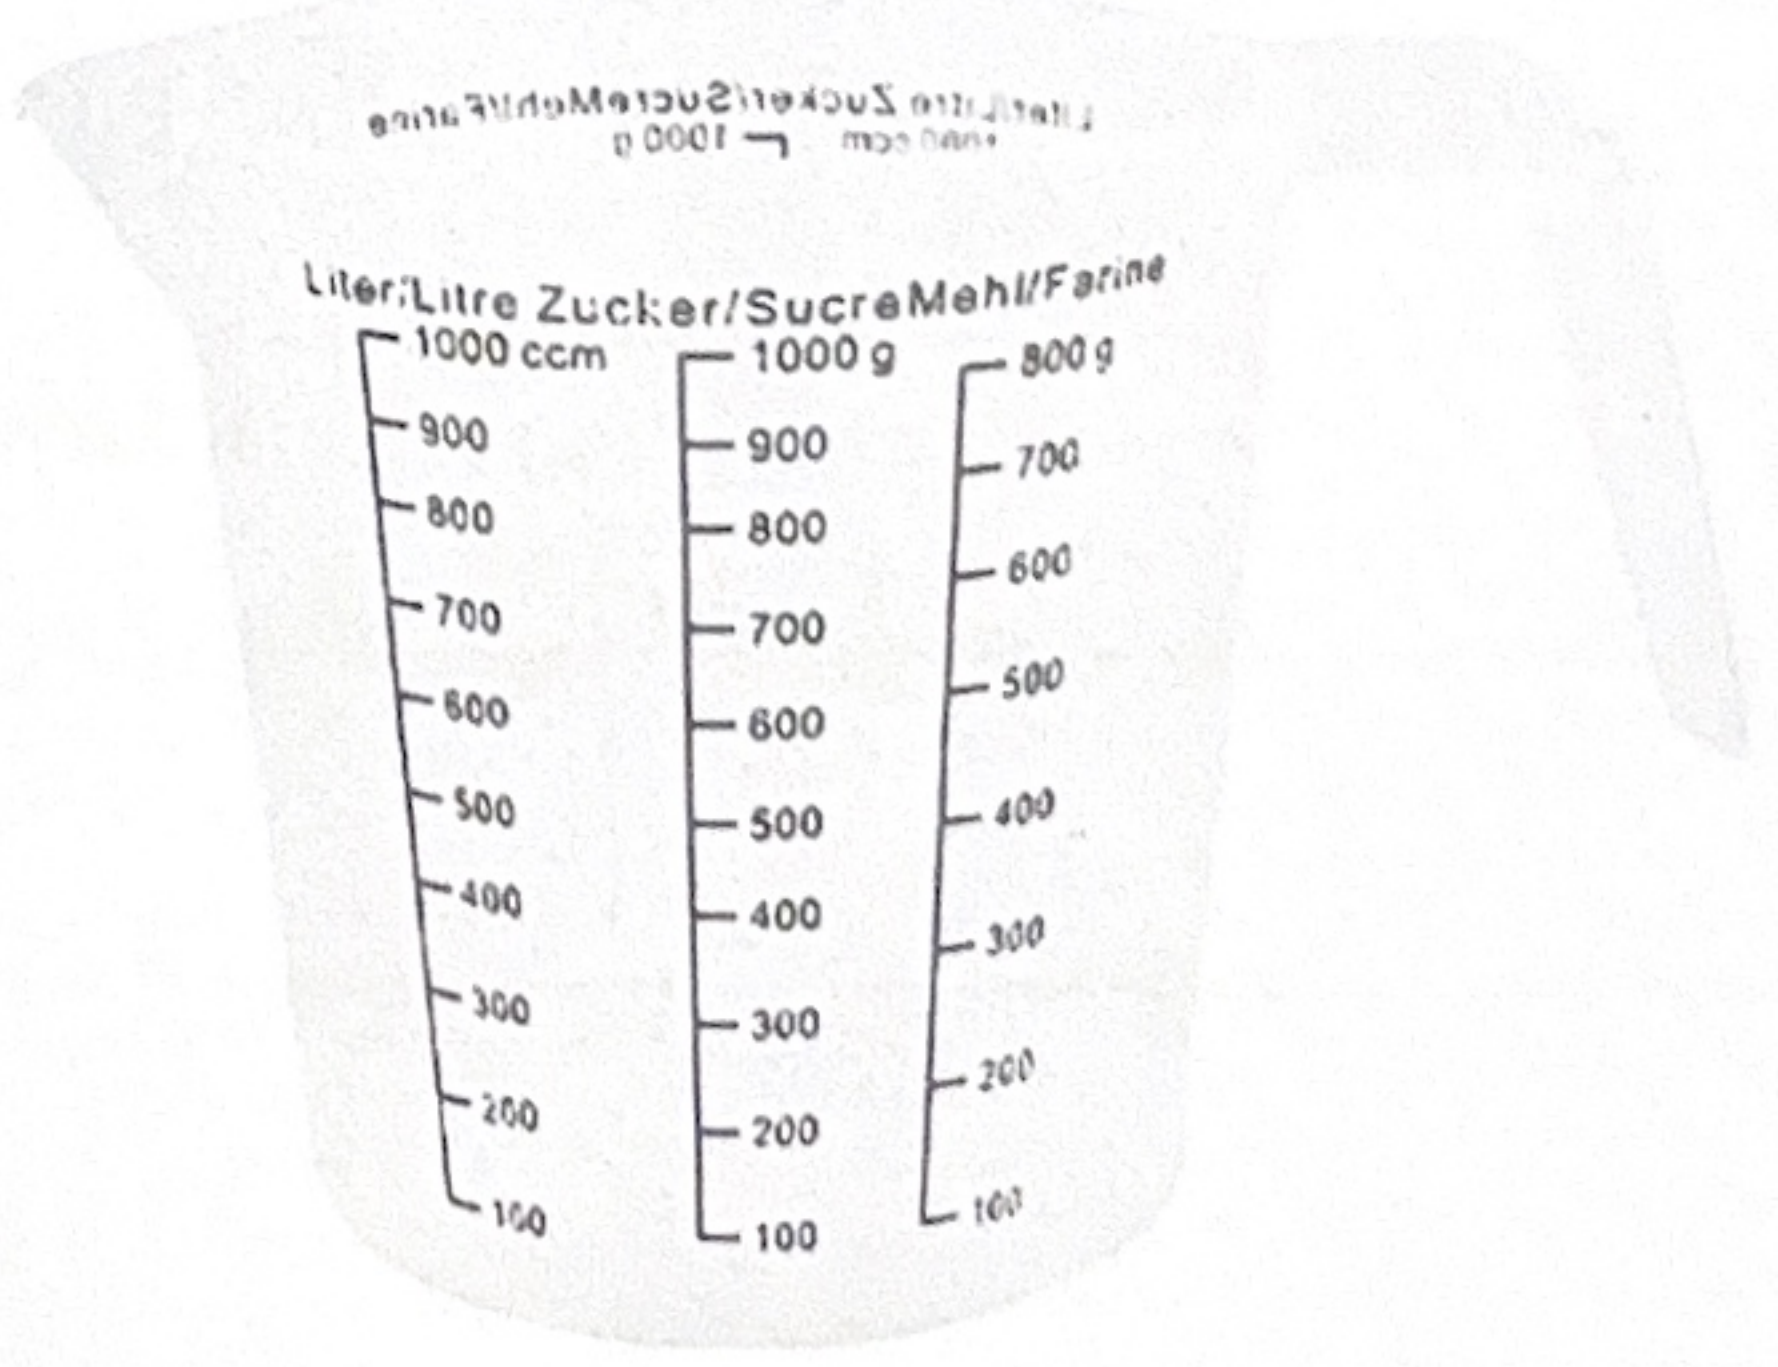
SUBDEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

FICHA TÉCNICA

La presente ficha técnica tiene por objeto establecer especificaciones, características y requisitos mínimos genéricos que deberán cumplir los productos a adquirir por el Hospital de La Serena. Su finalidad es asegurar la calidad, seguridad, eficacia y compatibilidad de los insumos, fármacos o productos requeridos, garantizando el cumplimiento de las normas vigentes del Ministerio de Salud, el Instituto de Salud Pública (ISP) y demás disposiciones aplicables.

Este documento servirá como referencia técnica y administrativa durante los procesos de compra, recepción, control y almacenamiento de los productos, contribuyendo a una gestión eficiente y transparente de los recursos hospitalarios.

1. Información General	
Nombre del Producto	Jarro Graduado de Plastico 1 litro
Categoría	Economato
Unidad de Medida	Unidad

2. Especificaciones técnicas requeridas del producto		Imagen referencial
Presentación Comercial	Jarro graduado plastico 1 litro	
Capacidad	1 litro	
Material	Plástico resistente, liviano y fácil de limpiar.	
Graduaciones	Claras y legibles en mililitros y litros	
Diseño	Con asa ergonómica y pico vertedor para un vaciado controlado.	
Uso	Adecuado para preparación, medición o traslado de soluciones liquidas.	

1. Información General	
Nombre del Producto	Jarro Graduado con tapa 2 litros
Categoría	Economato

Unidad de Medida	Unidad
------------------	--------

2. Especificaciones técnicas requeridas del producto		Imagen referencial
Presentación Comercial	Jarro graduado con tapa plástica 2 litros	
Capacidad	2 litros	
Medidas	Diametro 13x21 cm	
Material	Plástico resistente, liviano y fácil de limpiar.	
Graduaciones	Claras y legibles en mililitros y litros	
Diseño	Con asa ergonómica y pico vertedor para un vaciado controlado.	
Uso	Adecuado para preparación, medición o traslado de soluciones liquidas.	

Despacho	Cotización debe incluir despacho a Centro de Distribución del Hospital de La Serena
----------	---

3. Referente Técnico	
Nombre del referente técnico	Claudia Pizarro Thompson
Unidad / Servicio	Medicina 2 y Camas de Cardiología
Fecha	Julio 2026
Firma	