


- Contexte: Contrôle de prothèses de main via l'analyse des signaux myoélectriques (générés par les muscles)
- Utilisation d'électrodes pour la capture
- Populaire sur le marché:
 - Faible quantité d'électrodes pour le contrôle d'une prothèse
- Problèmes
 - Faible quantité/densité



Steeper Group, "Electrodes & Cables," *Steeper Group*. [Online]. [Accessed: Jul. 10, 2026]

- **Projet: Création d'une matrice d'électrode d'ultra haute densité**
 - Jusqu'à 512 électrodes
 - 5 mm entre chaque électrode
 - Microaiguilles pour chaque électrode
- **Objectif:**
 - Valider la performance des algorithmes d'analyse de signaux myoélectriques
 - Tester une méthode d'analyse des signaux myoélectriques
- **Décomposition des signaux en impulsions des neurones moteurs (Potentiel d'action de l'unité motrice)**
- **Permet d'analyser le comportement des neurones moteurs à la source**
- **Applications potentielles:**
 - Prothèses
 - Réhabilitation musculaire
 - Diagnostic des maladies neurologiques

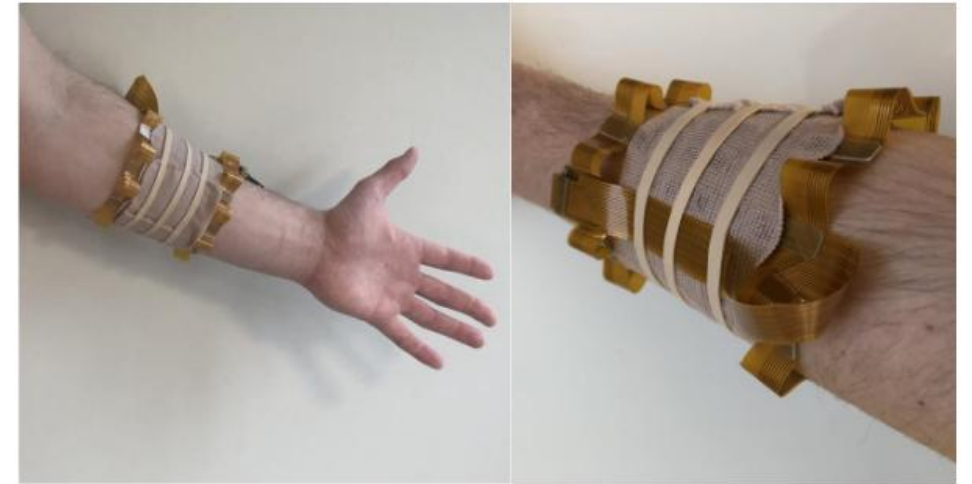