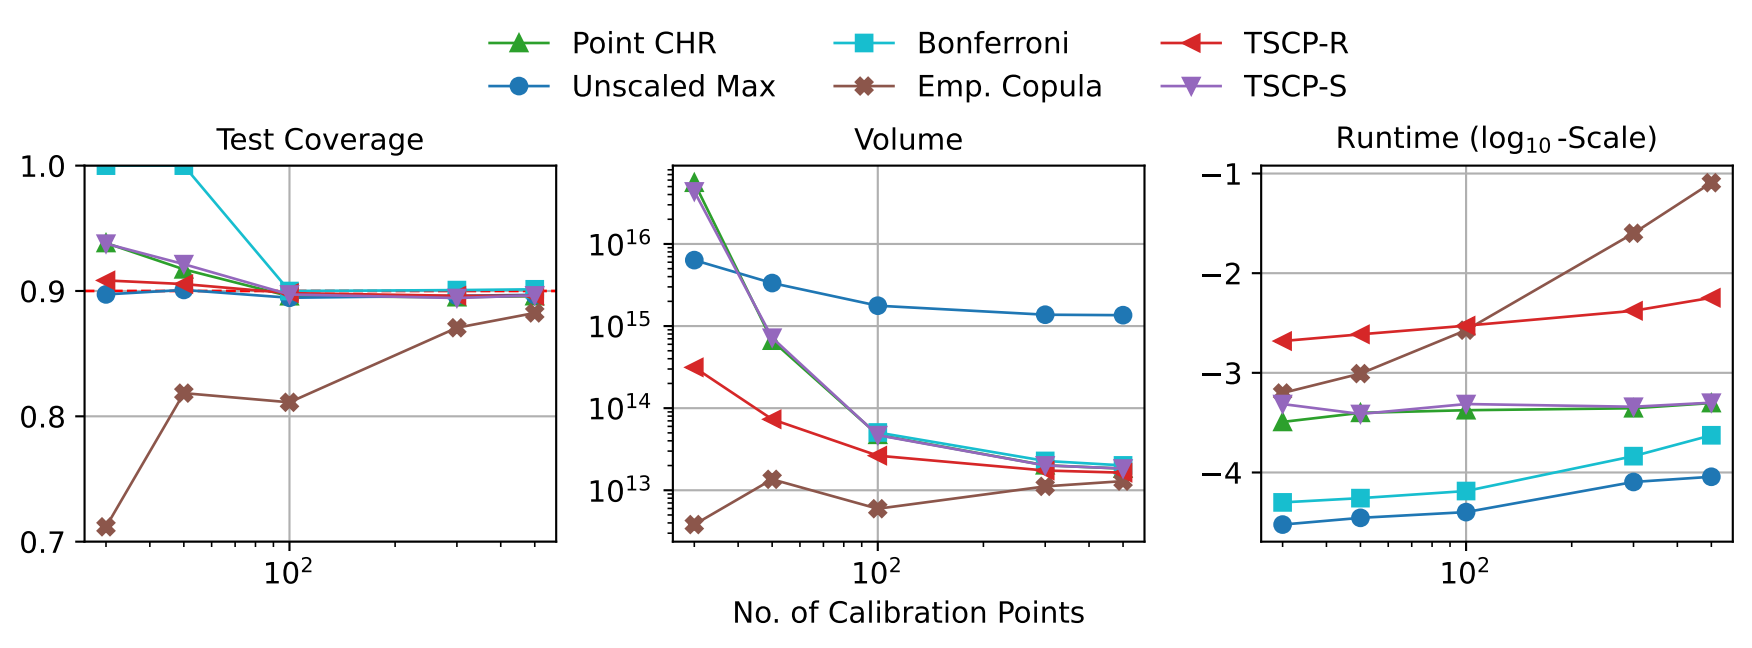
Point CHR
Unscaled Max
Bonferroni
Emp. Copula
TSCP-R
TSCP-S
Test Coverage
Volume
Runtime ($\log_{10}$-Scale)
1.0
0.9
0.8
0.7
10^{16}
10^{15}
10^{14}
10^{13}
−1
−2
−3
−4
10^2
10^2
10^2
No. of Calibration Points