

PMY 11-2

Current Data Parameters
NAME PMY11-2_dry
EXPNO 1
PROCNO 1

F2 - Acquisition Parameters

Date_ 20111028
Time 10.15
INSTRUM spect
PROBHD 5 mm QNP 1H/13
PULPROG zg
TD 32768
SOLVENT CDCl3
NS 8
DS 0
SWH 5995.204 Hz
FIDRES 0.182959 Hz
AQ 2.7329011 sec
RG 322.5
DW 83.400 use
DE 6.50 use
TE 300.0 K
D1 2.26709890 sec
TD0 1

===== CHANNEL f1 =====
NUC1 1H
P1 14.90 usec
PL1 4.50 dB
SFO1 300.1318008 MHz

F2 - Processing parameters

SI 32768
SF 300.1300067 MHz
WDW EM
SSB 0
LB 0.30 Hz
GB 0
PC 1.00



7.64
7.48
7.46
7.43
7.40
7.37
7.32
7.30
7.21
7.18
7.17
7.16
6.43

4.87

3.08

2.31

1.95

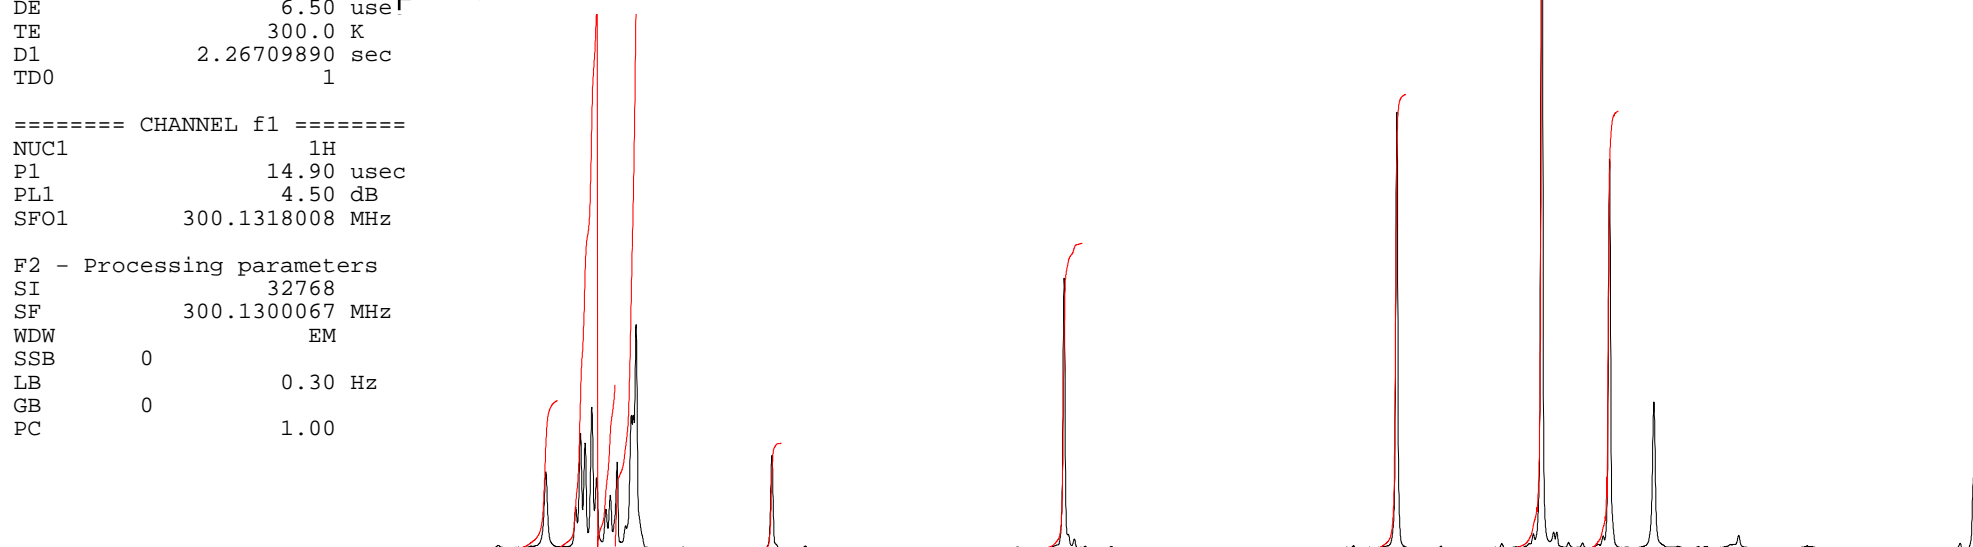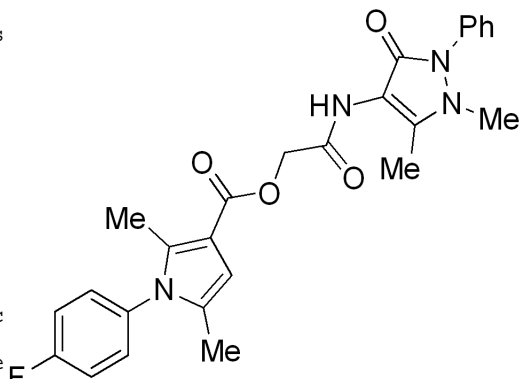

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ppm

1.01
3.86
1.11
4.19

0.72

2.08

3.09

6.02

2.97