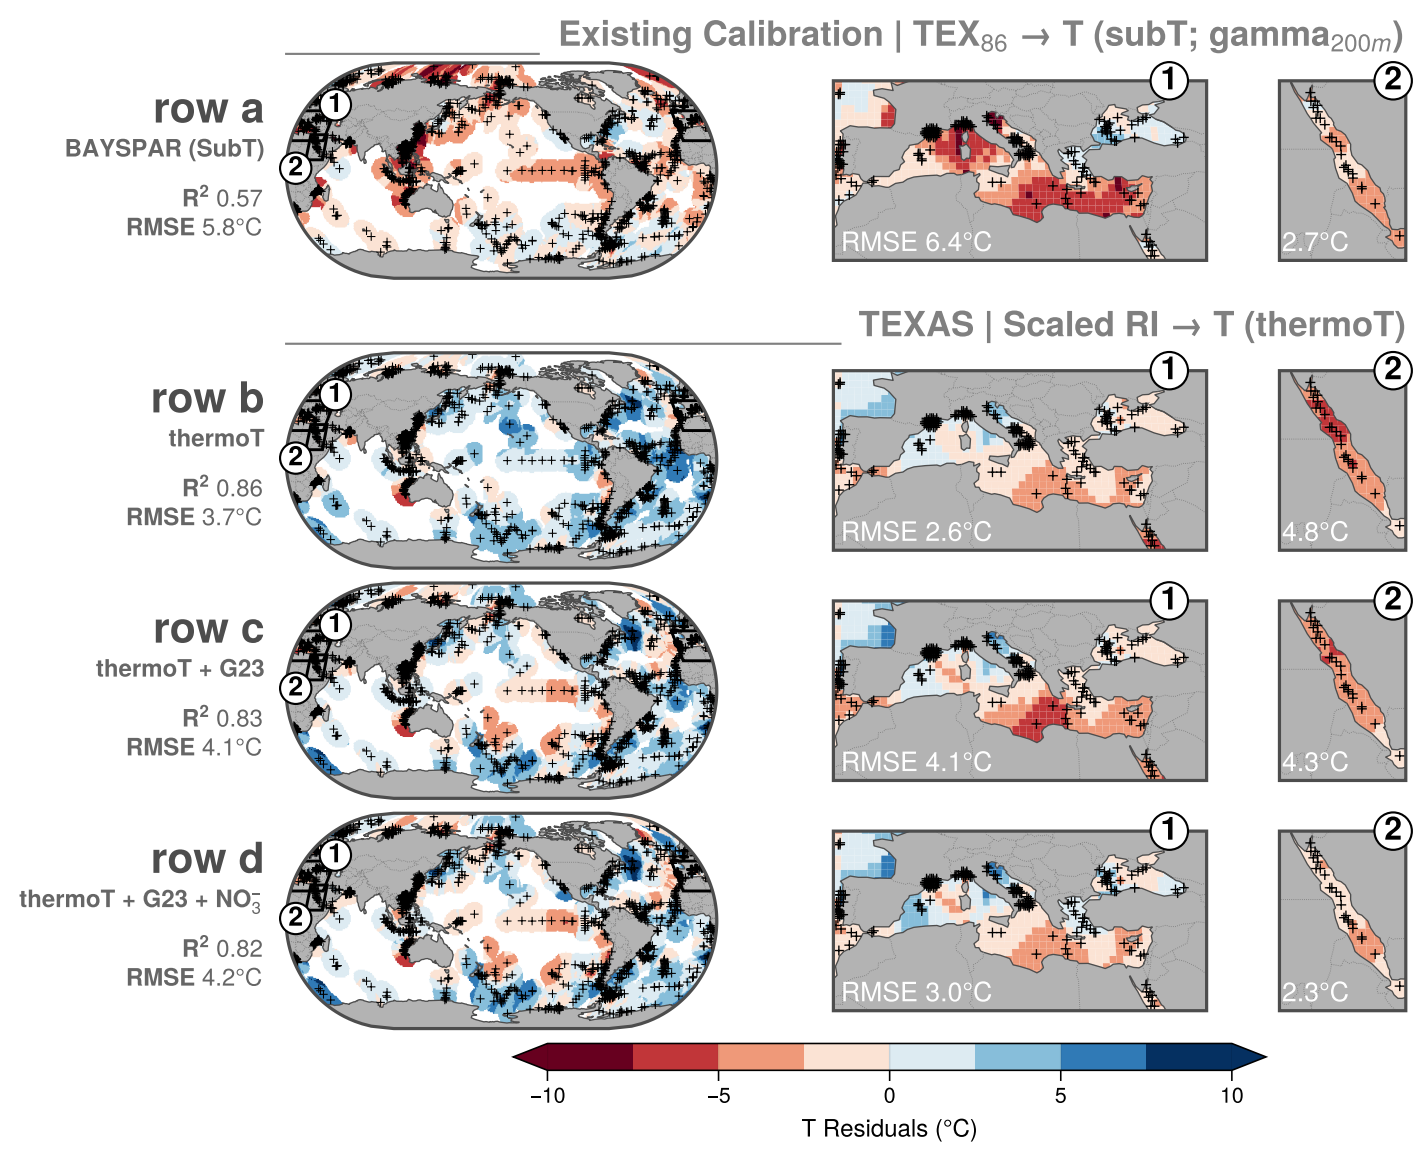

Existing Calibration | TEX86 → T (subT; gamma200m)
row a
BAYSPAR (SubT)
R2 0.57
RMSE 5.8°C
RMSE 6.4°C
2.7°C
TEXAS | Scaled RI → T (thermoT)
row b
thermoT
R2 0.86
RMSE 3.7°C
RMSE 2.6°C
4.8°C
row c
thermoT + G23
R2 0.83
RMSE 4.1°C
RMSE 4.1°C
4.3°C
row d
thermoT + G23 + NO3−
R2 0.82
RMSE 4.2°C
RMSE 3.0°C
2.3°C
−10
−5
0
5
10
T Residuals (°C)