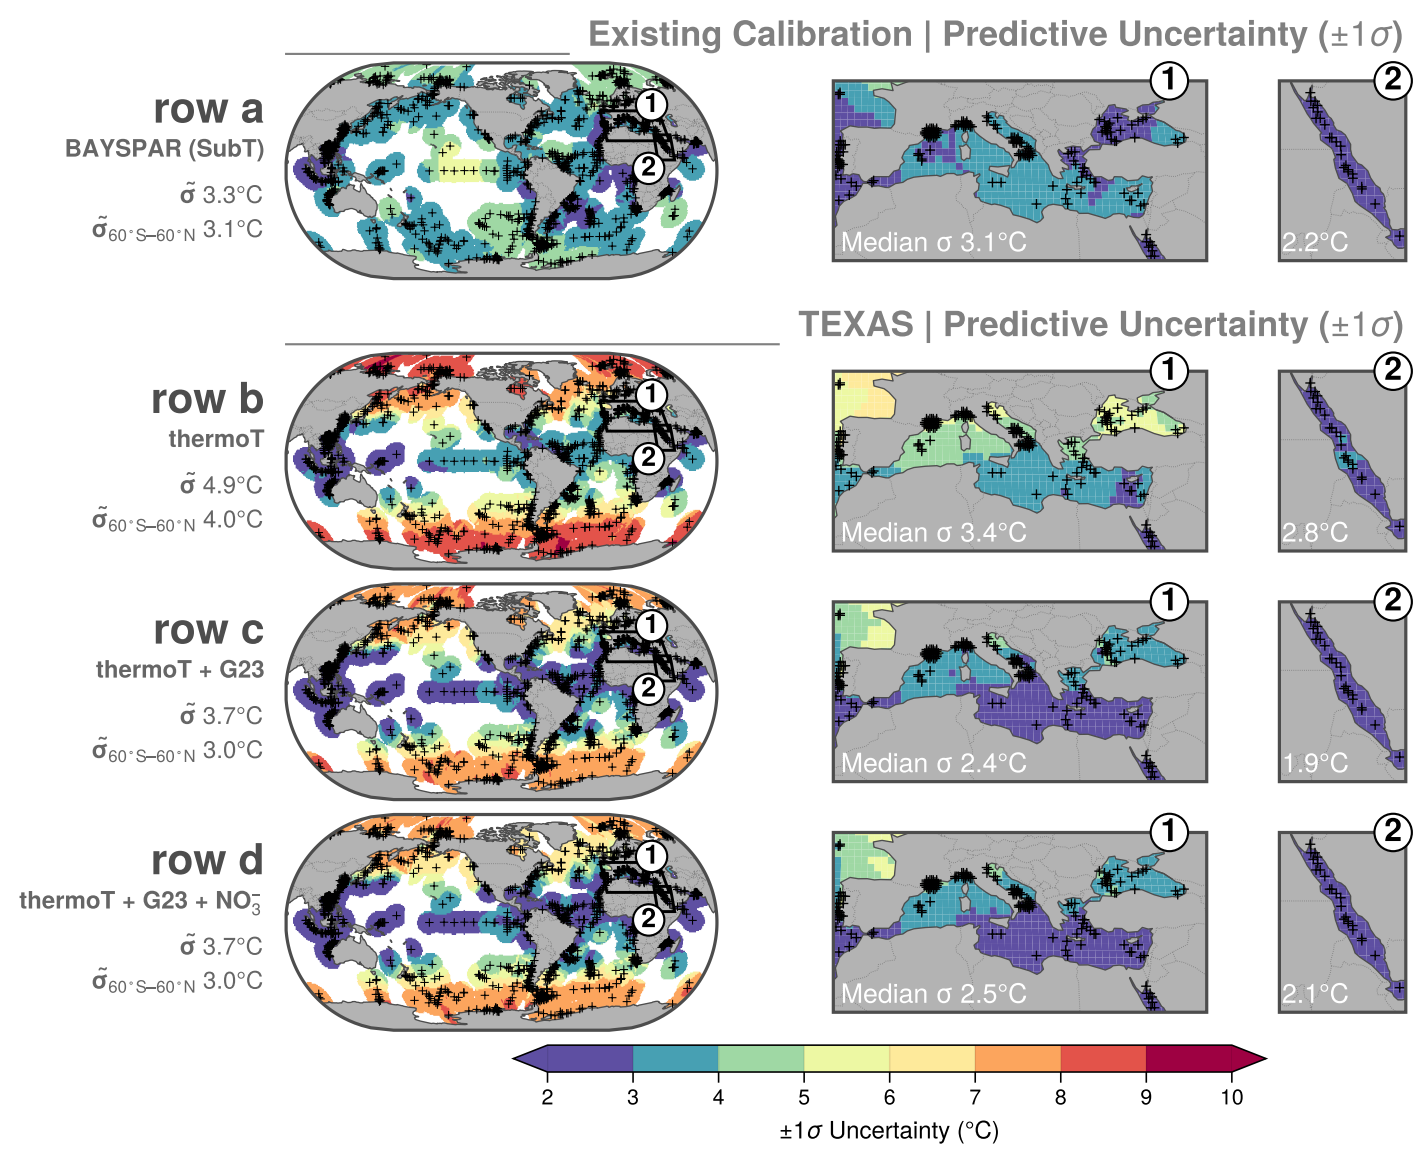

Existing Calibration | Predictive Uncertainty (±1σ)
row a
BAYSPAR (SubT)
σ̃ 3.3°C
σ̃60°S–60°N 3.1°C
Median σ 3.1°C
2.2°C
TEXAS | Predictive Uncertainty (±1σ)
row b
thermoT
σ̃ 4.9°C
σ̃60°S–60°N 4.0°C
Median σ 3.4°C
2.8°C
row c
thermoT + G23
σ̃ 3.7°C
σ̃60°S–60°N 3.0°C
Median σ 2.4°C
1.9°C
row d
thermoT + G23 + NO3−
σ̃ 3.7°C
σ̃60°S–60°N 3.0°C
Median σ 2.5°C
2.1°C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
±1σ Uncertainty (°C)