



Condiciones alternativas: DINOv2 público (referencia) · D2 (control fuente) · D3 (target_adapt clínico)
DINOv2 público omite SimSiam; D2 y D3 utilizan el aprendizaje autosupervisado mostrado abajo.

(a) Entrenamiento SimSiam (D2 / D3)

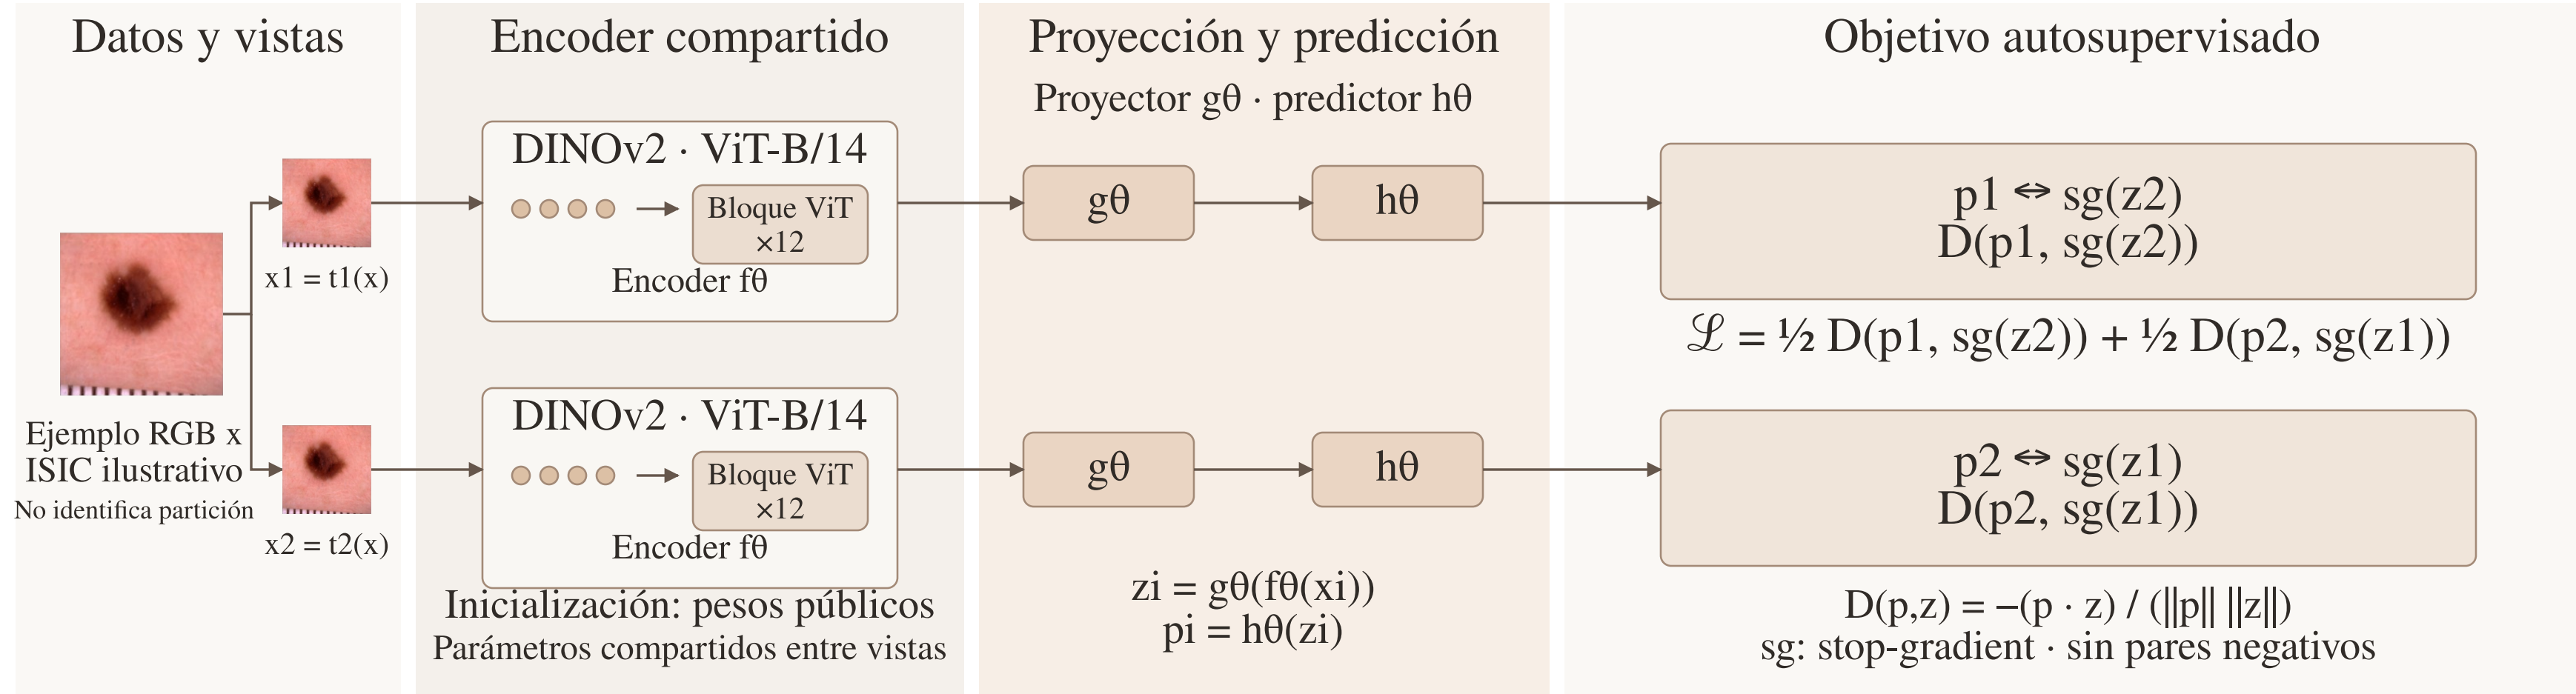

(b) Sonda supervisada · encoder conservado, sin proyector ni predictor

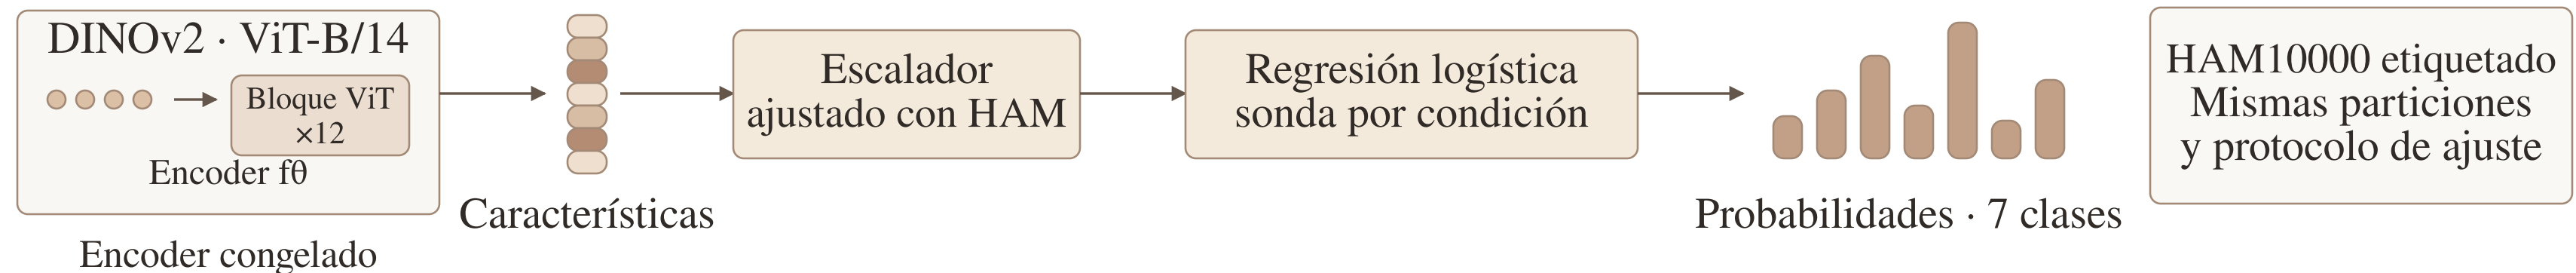

Cada condición utiliza sus características y su propio escalador y clasificador ajustados.

Evaluación externa · PAD-UFES-20 / target_test

Inferencia con componentes ya ajustados $\rightarrow$ Macro-F1 · AUC-ROC · Exactitud
 Separación por paciente respecto a target_adapt; sin actualización de parámetros.

Módulos complementarios

Segmentación: encoder + DPT $\rightarrow$ máscara binaria
 ITA: caracterización del tono cutáneo