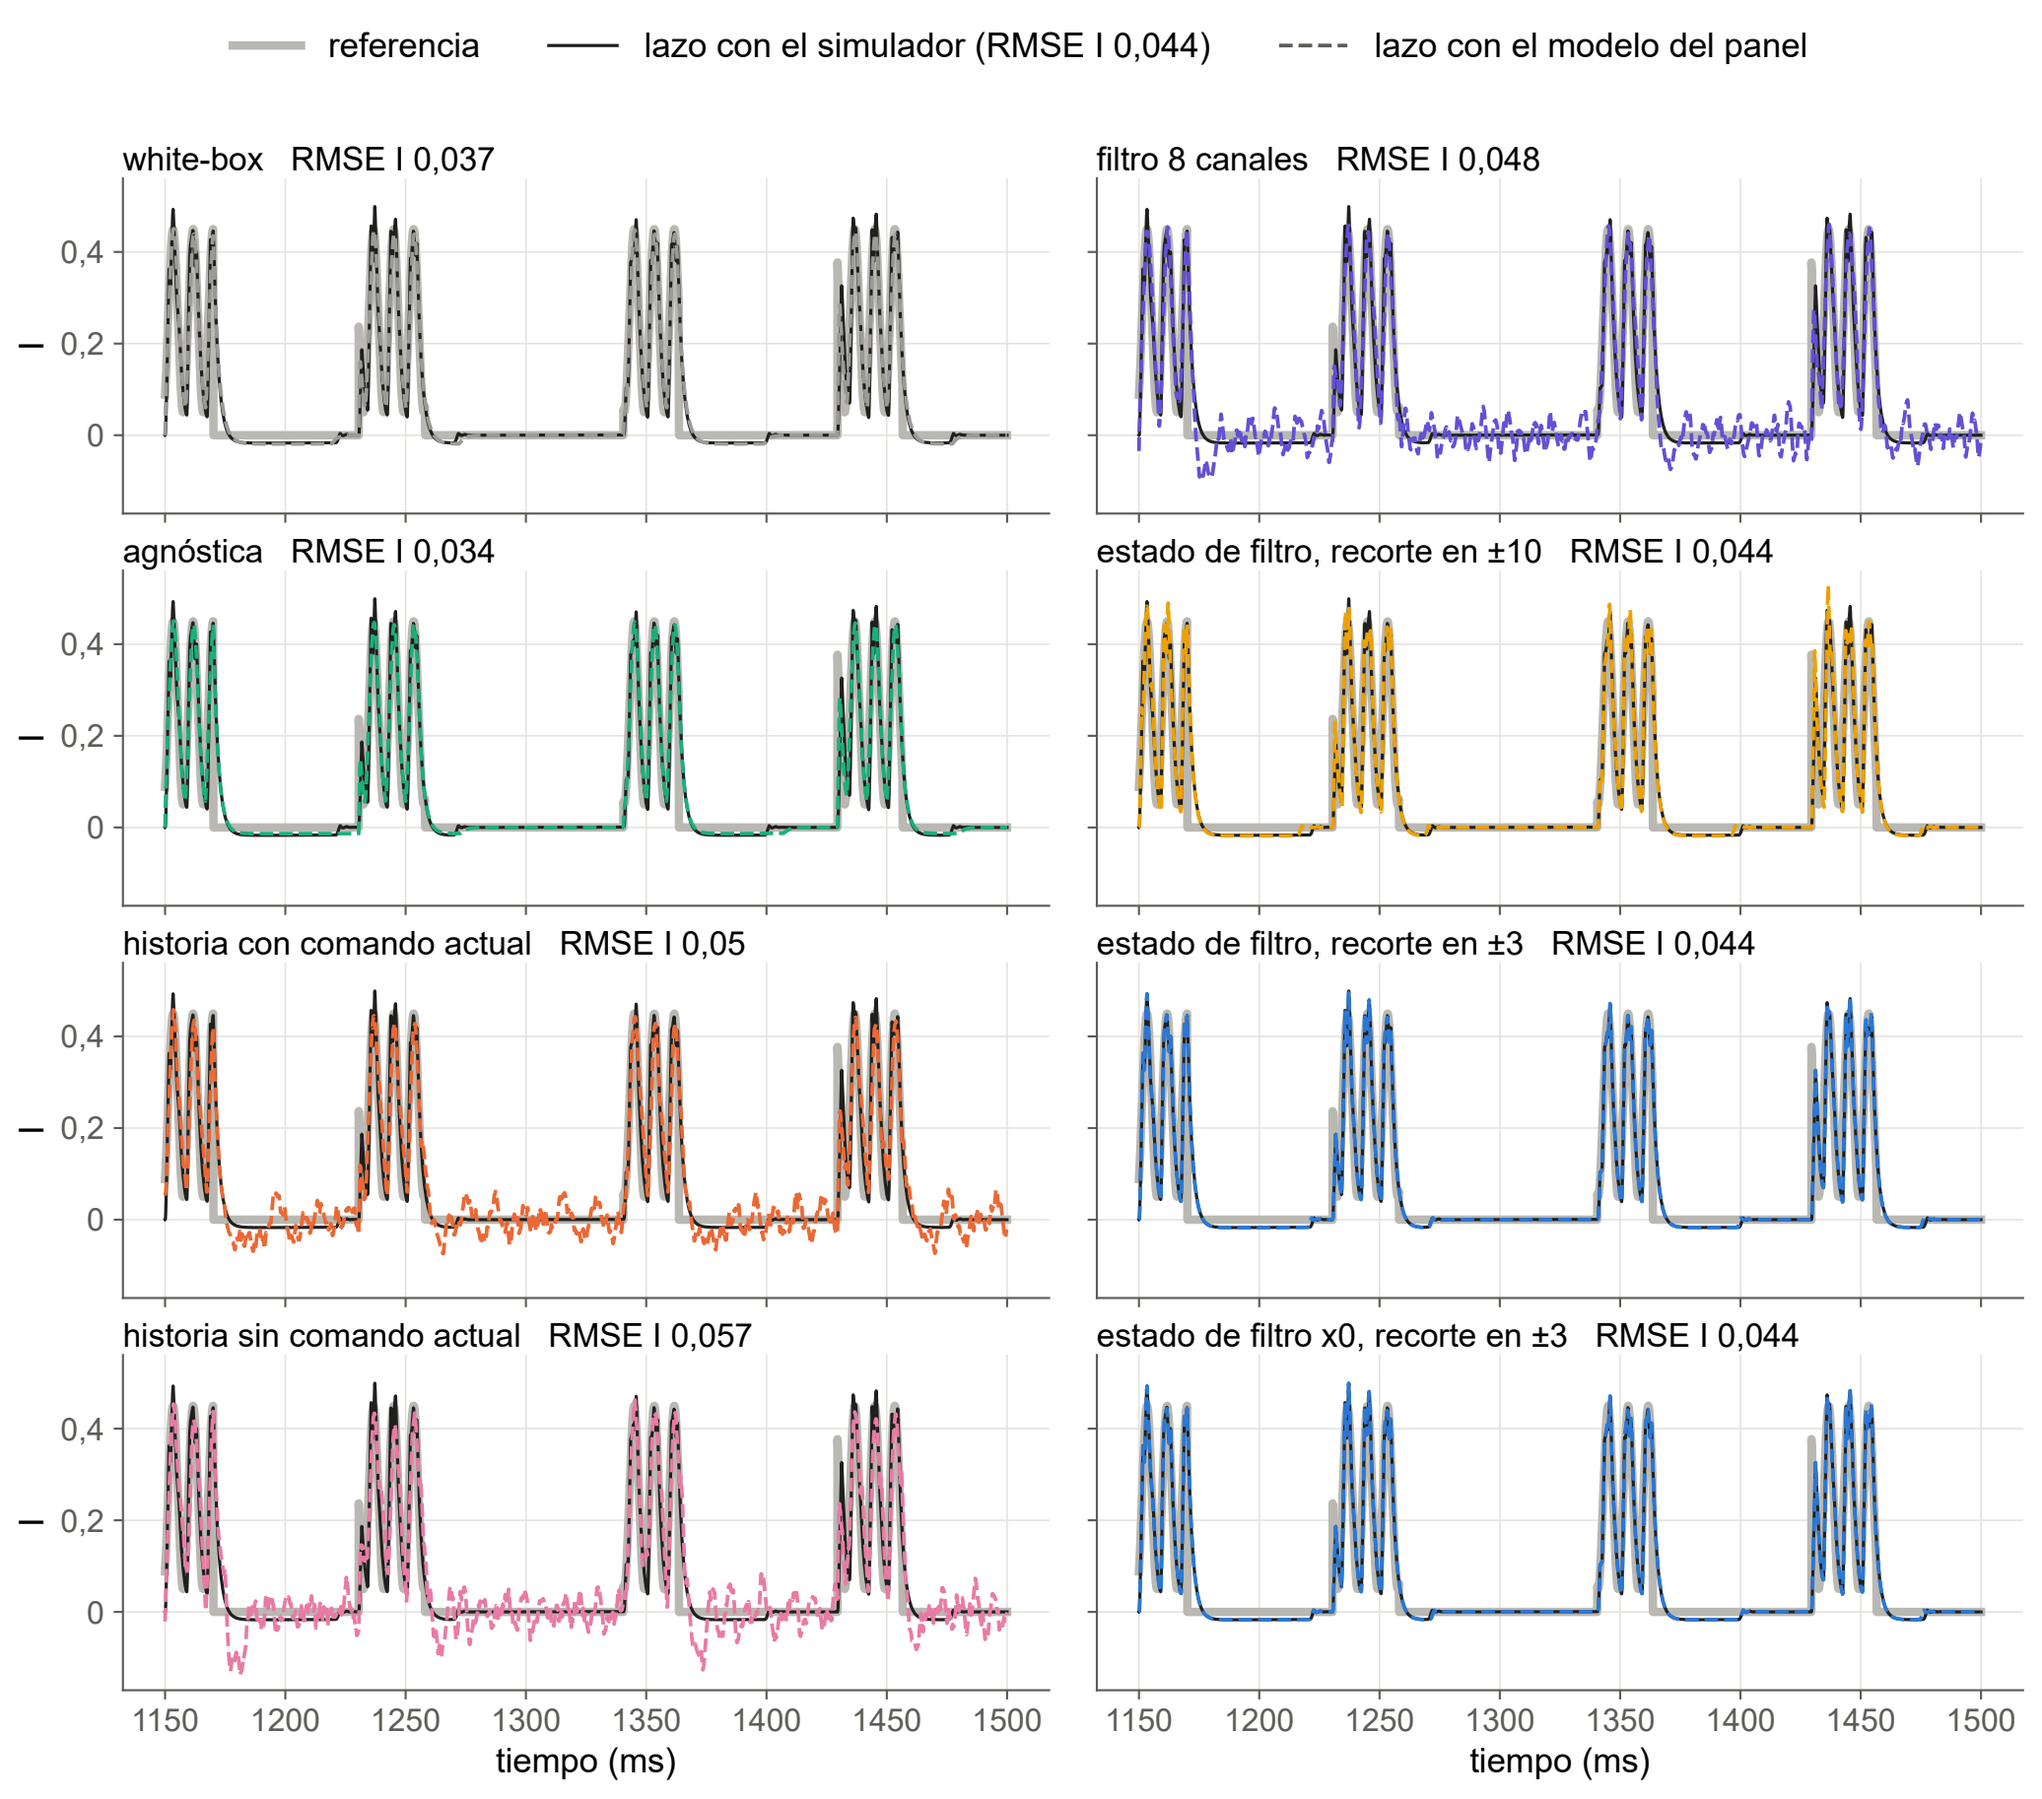

referencia
lazo con el simulador (RMSE I 0,044)
lazo con el modelo del panel
white-box RMSE I 0,037
filtro 8 canales RMSE I 0,048
agnóstica RMSE I 0,034
estado de filtro, recorte en ±10 RMSE I 0,044
historia con comando actual RMSE I 0,05
estado de filtro, recorte en ±3 RMSE I 0,044
historia sin comando actual RMSE I 0,057
estado de filtro x0, recorte en ±3 RMSE I 0,044
I
0,4
0,2
0
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
tiempo (ms)