


Analysis

Malvern Panalytical

Measurement Details	Measurement Details
操作者姓名 扣电测试	分析日期时间 2026/7/12 9:59:51
样品名称 "C17-M"的平均值	测量日期和时间 2026/7/12 9:59:51
SOP 名称 NFPP粉体 SOP.msop	结果源 平均
Analysis	Result
颗粒名称 NFPP	浓度 0.0032 %
颗粒折射率 1.692	径距 1.754
颗粒吸收率 0.100	一致性 0.540
分散剂名称 Water	比表面积 1958 m²/kg
分散剂折射率 1.330	Dv (10) 1.47 µm
散射模型 Mie	Dv (50) 3.80 µm
分析模型 通用	Dv (90) 8.13 µm
加权残差 0.51 %	Dv (99) 13.0 µm
激光遮光度 9.54 %	Dv (100) 18.6 µm

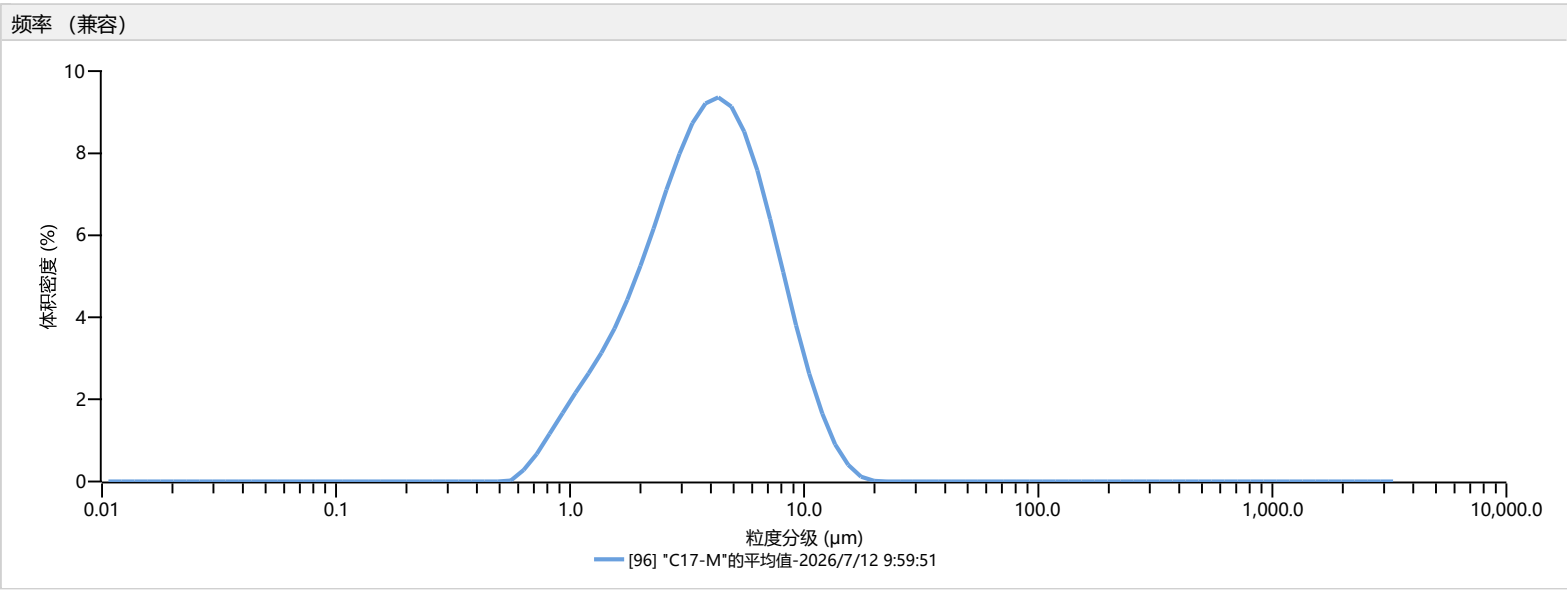

结果											
粒度 (µm)	% 体积 范围内	粒度 (µm)	% 体积 范围内	粒度 (µm)	% 体积 范围内	粒度 (µm)	% 体积 范围内	粒度 (µm)	% 体积 范围内	粒度 (µm)	% 体积 范围内
0.0100	0.00	0.0597	0.00	0.357	0.00	2.13	5.14	12.7	0.73	76.0	0.00
0.0114	0.00	0.0679	0.00	0.405	0.00	2.42	5.93	14.5	0.32	86.4	0.00
0.0129	0.00	0.0771	0.00	0.460	0.00	2.75	6.67	16.4	0.08	98.1	0.00
0.0147	0.00	0.0876	0.00	0.523	0.00	3.12	7.29	18.7	0.00	111	0.00
0.0167	0.00	0.0995	0.00	0.594	0.22	3.55	7.70	21.2	0.00	127	0.00
0.0189	0.00	0.113	0.00	0.675	0.55	4.03	7.83	24.1	0.00	144	0.00
0.0215	0.00	0.128	0.00	0.767	0.96	4.58	7.64	27.4	0.00	163	0.00
0.0244	0.00	0.146	0.00	0.872	1.39	5.21	7.13	31.1	0.00	186	0.00
0.0278	0.00	0.166	0.00	0.991	1.80	5.92	6.34	35.3	0.00	211	0.00
0.0315	0.00	0.188	0.00	1.13	2.19	6.72	5.34	40.1	0.00	240	0.00
0.0358	0.00	0.214	0.00	1.28	2.61	7.64	4.25	45.6	0.00	272	0.00
0.0407	0.00	0.243	0.00	1.45	3.10	8.68	3.17	51.8	0.00	310	0.00
0.0463	0.00	0.276	0.00	1.65	3.69	9.86	2.18	58.9	0.00	352	0.00
0.0526	0.00	0.314	0.00	1.88	4.38	11.2	1.36	66.9	0.00	400	0.00