




B² Bquadro

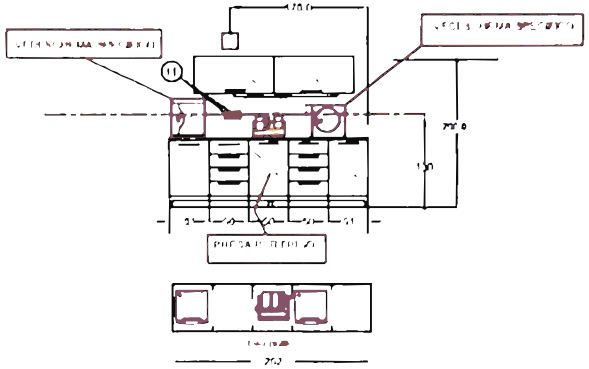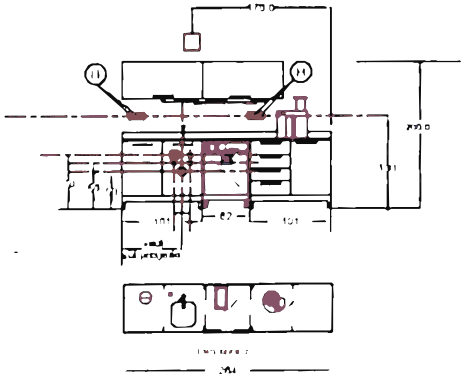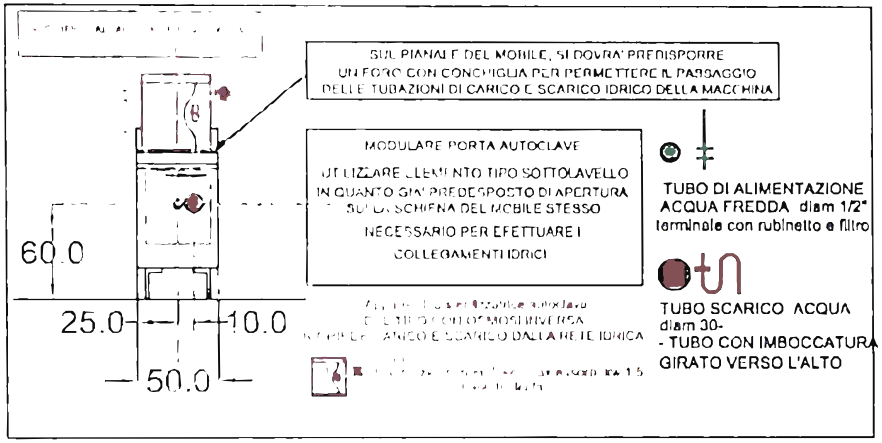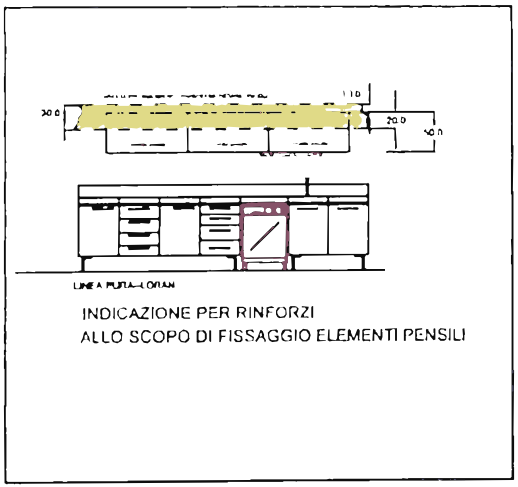


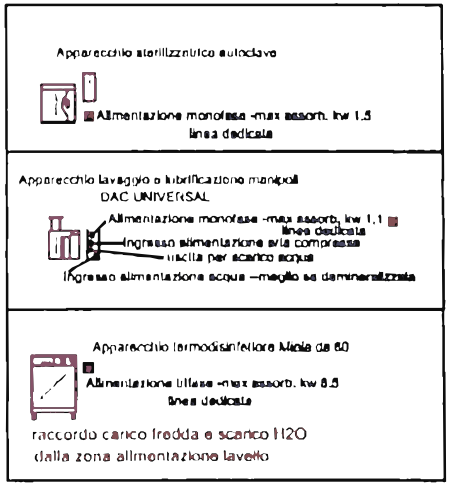


SUL PIANALE DEL MOBILE, SI DOVRA' PREDISPORRE
UN FORO CON CONDIGLIA PER PERMETTERE IL PASSAGGIO
DELLE TUBAZIONI DI CARICO E SCARICO IDRICO DELLA MACCHINA
MODULARE PORTA AUTOCLAVE
UTILIZZARE ELEMENTO TIPO SOTTOLAVELLO
IN QUANTO GIA' PREDISPOSTO DI APERTURA
SUL DI SCHIENA DEL MOBILE STESSO
NECESSARIO PER EFETTUARE I
COLLEGAMENTI IDRICI
TUBO DI ALIMENTAZIONE
ACQUA FREDDA diam 1/2"
terminale con rubinetto e filtro
TUBO SCARICO ACQUA
diam 30-
- TUBO CON IMBOCCATURA
GIRATO VERSO L'ALTO
60.0
25.0
10.0
50.0


INDICAZIONE PER RINFORZI
ALLO SCOPO DI FISSAGGIO ELEMENTI PENSILI


Apparecchio sterilizzatrice autoclave
Alimentazione monofase -max assorb. kw 1,5
linea dedicata
Apparecchio lavaggio e lubrificazione manipoli
DAC UNIVERSAL
Alimentazione monofase -max assorb. kw 1,1
linea dedicata
Ingresso alimentazione aria compressa
uscita per scarico acqua
Ingresso alimentazione acqua -meglio se demineralizzata
Apparecchio termodisinfettore Miele da 60
Alimentazione trifase -max assorb. kw 8,5
linea dedicata
raccordo carico fredda e scarico H2O
dalla zona alimentazione lavello

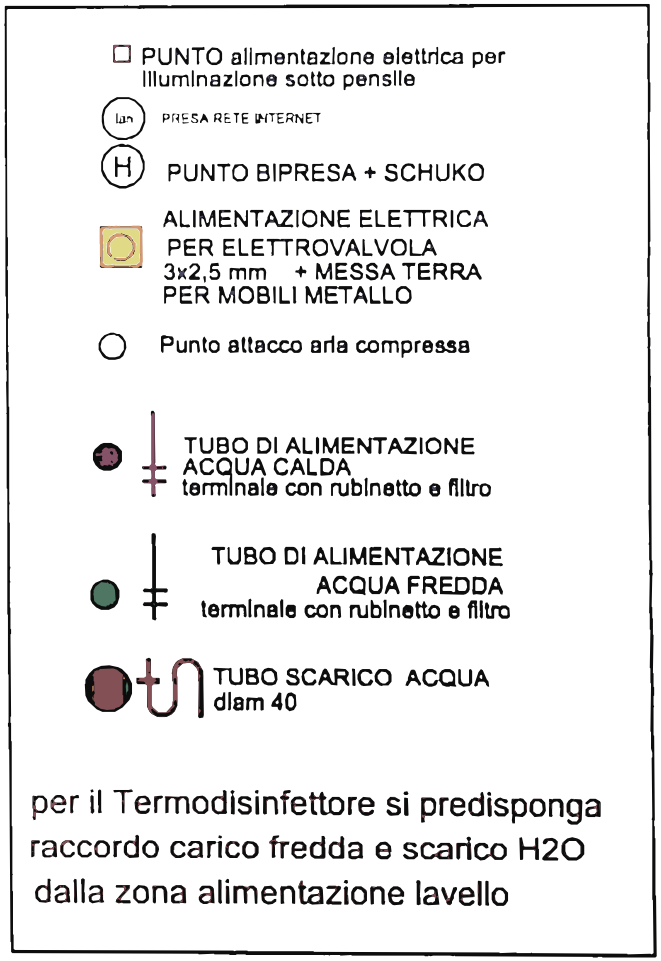
PUNTO alimentazione elettrica per
illuminazione sotto pensile
lan
PRESA RETE INTERNET
H
PUNTO BIPRESA + SCHUKO
ALIMENTAZIONE ELETTRICA
PER ELETTROVALVOLA
3x2,5 mm + MESSA TERRA
PER MOBILI METALLO
Punto attacco aria compressa
TUBO DI ALIMENTAZIONE
ACQUA CALDA
terminale con rubinetto e filtro
TUBO DI ALIMENTAZIONE
ACQUA FREDDA
terminale con rubinetto e filtro
TUBO SCARICO ACQUA
diam 40
per il Termodisinfettore si predisponga
raccordo carico fredda e scarico H2O
dalla zona alimentazione lavello