Clinic B

[Abteilung oder Praxis, Platzhalter]
[Leitung, Platzhalter]
[Straße, PLZ und Ort, Platzhalter]
[Telefon und E-Mail, Platzhalter]

LOGO CLINIC B

Quantitativer EEG- und ERP-Bericht

Patient	Mock Patient 042
Geburtsdatum	01.01.2016
Alter	10 Jahre
Geschlecht	weiblich
Aufnahme	15.09.2026
Fallnummer	MOCK-042
Frühere Messungen	23.09.2025 und 12.03.2026
Überweisung durch	[Platzhalter]
Besprechung der Ergebnisse	[Platzhalter]

Inhalt

1. Zusammenfassung 2
2. Signalqualität und Verarbeitung 2
3. Roh-EEG-Ausschnitt 2
4. Anamnese und klinisches Gespräch 2
5. Spektren und Karten 3
6. Karten je 1-Hz-Band (absolute Leistung, z) 4
7. Absolute Spektren je Elektrode 5
8. Frequenzmarker 6
9. Bandquotienten und Indizes 7
10. Asymmetrie 7
11. Kohärenz 8
12. Ereigniskorrelierte Potenziale an den Elektroden (Kanal-ERPs) 9
13. Checkliste über die Kanal-ERPs 10
14. VCPT-Aufgabenleistung 10
15. Vergleich der Messungen 11
16. Hinweise zu den Ergebnissen 11
17. Methode und Normen 12
18. Formular der Klinikerin oder des Klinikers 12
19. Interpretation 12
20. Schlussfolgerung 12

Software	V4 mockup 0.1
Normen	Mock norms 2026.1 (synthetisch)
Aufnahmesystem	Mitsar-Verstärker, WinEEG-Datei (Mockup-Bezeichnung)
Bericht	R-MOCK-042-0915 v1 · Entwurf, nicht freigegeben
Produktkennung	UDI: Platzhalter, wird bei der Zertifizierung vergeben
Verarbeitungskette	mockup pipeline 0.1.0
Prüfsumme der Eingabe (sha256)	94184e3a145d4a9294c260f9ff5cc6c611b4e1304fd6f6eedc569dd37249ca08 (synthetische Eingabe, keine Aufnahmedatei)
ICA-Startwert	33226
Verarbeitet	15.09.2026, 10:46 Uhr, in 400 s

1. Zusammenfassung

Die größten markierten Abweichungen von der Altersnorm in dieser Messung sind: relative Theta-Leistung, Augen offen: O1 (z = -4,3), O2 (z = -4,3), Pz (z = -4,0); relative Theta-Leistung, Augen geschlossen: O1 (z = -4,3), O2 (z = -4,3), Pz (z = -4,1); SMR-Asymmetrieindex, Augen offen: C3-C4 (z = 4,2); SMR-Asymmetrieindex, Augen geschlossen: C3-C4 (z = 4,2); Beta1-Kohärenz, Augen geschlossen: T3-C3 (z = 4,1), C3-T5 (z = 4,1), T3-T5 (z = 4,0), T5-O1 (z = 4,0), P3-O1 (z = 4,0), C3-P3 (z = 3,9), T5-P3 (z = 3,8); Beta1-Kohärenz, Augen offen: Fp2-T4 (z = -3,9), T3-T5 (z = 3,9), T5-O1 (z = 3,9), P3-O1 (z = 3,9), T3-C3 (z = 3,8), C3-P3 (z = 3,8), C3-T5 (z = 3,7), T5-P3 (z = 3,7); P1-Latenz, Go: O1 (z = 3,7), O2 (z = 3,7). SUM-2

Die Liste ordnet die markierten Werte dieser Analysen nach |z|: absolute und relative Bandleistung, Karten je 1-Hz-Band, Alpha-Peak-Frequenz, Theta/Beta-Quotient, frontaler Alpha-Asymmetrieindex, Asymmetriekarte, Kohärenz je Elektrodenpaar, ERP-Peakamplitude und -latenz sowie die Ergebnisse der VCPT-Aufgabe. Sie zeigt die 5 größten und jeden markierten Wert ab 3 z. Nicht eingeordnet: die Spektren je 0,5-Hz-Schritt, die als Kurven gegen die Norm gezeigt werden, und die globale Kohärenz, die noch zu bestätigen ist. SUM-RULE-2

Markierte Werte in dieser Messung: Bandleistung 6 von 456, Karten je 1-Hz-Band 0 von 1102, Alpha-Peak und Quotienten 0 von 6, Asymmetriekarte 2 von 96, Kohärenz 15 von 2052, ERP-Peaks 2 von 21 und VCPT-Aufgabe 0 von 4. SUM-COUNT-1

2. Signalqualität und Verarbeitung

Augen offen: 164 von 180 Sekunden wurden nach der Artefaktentfernung ausgewertet. Q-DUR-1

Augen geschlossen: 171 von 180 Sekunden wurden nach der Artefaktentfernung ausgewertet. Q-DUR-1

VCPT: 1168 von 1220 Sekunden wurden nach der Artefaktentfernung ausgewertet. Q-DUR-1


Akzeptierte VCPT-Durchgänge: Go 95, NoGo 92, Ignore 93, Novelty 95 (von je 100). Q-TRIALS-1

Artefaktentfernung durch die Klinikerin oder den Kliniker geändert: Komponente 6 (Muskel, links temporal) wurde beibehalten, obwohl die automatische Bereinigung ihre Entfernung vorschlug; 2 von 19 Komponenten wurden entfernt. Q-ICA-MAN-1

Die ausgewerteten Segmente wurden von der Klinikerin oder dem Kliniker wie vorgeschlagen bestätigt. Q-SEG-AUTO-1

Alpha-Peak-Frequenz, Augen geschlossen (posteriorer Mittelwert): vorgeschlagen 9,2 Hz, von der Klinikerin oder dem Kliniker unverändert bestätigt; nicht markiert (z = 0,0). MK-AUTO-1

3. Roh-EEG-Ausschnitt

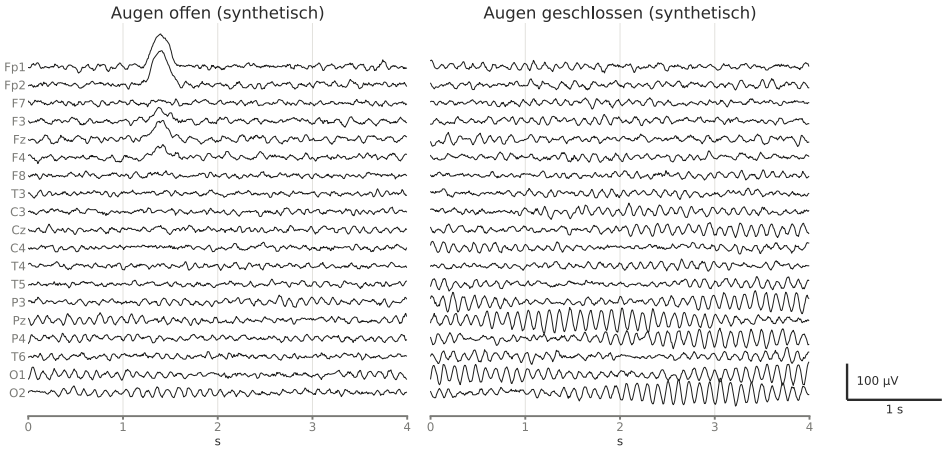

Synthetisches Signal, keine Aufnahme: die ersten 4 s der ausgewerteten Segmente, Augen offen und Augen geschlossen, Durchschnittsreferenz, 19 Kanäle. Maßstab: 100 µV und 1 s.


4. Anamnese und klinisches Gespräch

Anamnese	Synthetischer Beispieltext. Vorstellung zur quantitativen EEG- und ERP-Untersuchung auf Wunsch der Familie; dritte Messung in dieser Klinik.
Vorgeschichte	Synthetischer Beispieltext. Die Eltern berichten keine relevanten Ereignisse.
Medikation	Synthetischer Beispieltext. Keine angegeben.
Aktuelle Symptome	Synthetischer Beispieltext. Schlaf und Appetit wie gewohnt, laut den Eltern.


5. Spektren und Karten

Augen offen

Absolute Leistung, z gegen die Altersnorm, Augen offen

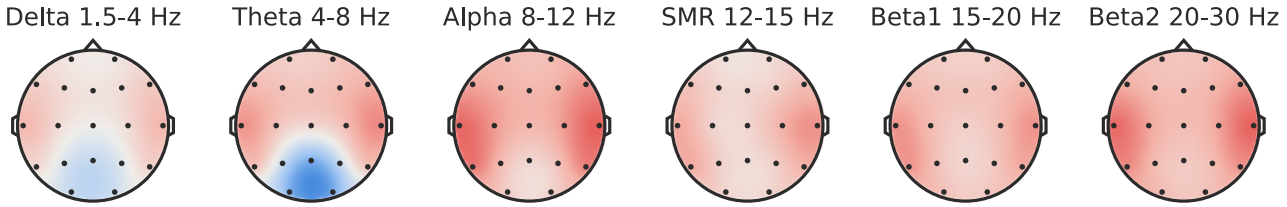

Relative Leistung, z gegen die Altersnorm, Augen offen

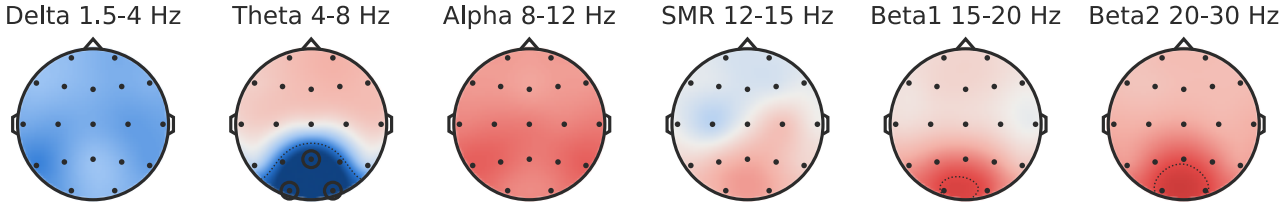


Die relative Theta-Leistung, Augen offen, liegt an Pz (z = -4,0), O1 (z = -4,3) und O2 (z = -4,3) unter der Altersnorm. SP-REL-1


Die Alpha-Peak-Frequenz, Augen offen, beträgt 9,2 Hz und ist nicht markiert (z = 0,1). APF-IN-2

Augen geschlossen

Absolute Leistung, z gegen die Altersnorm, Augen geschlossen

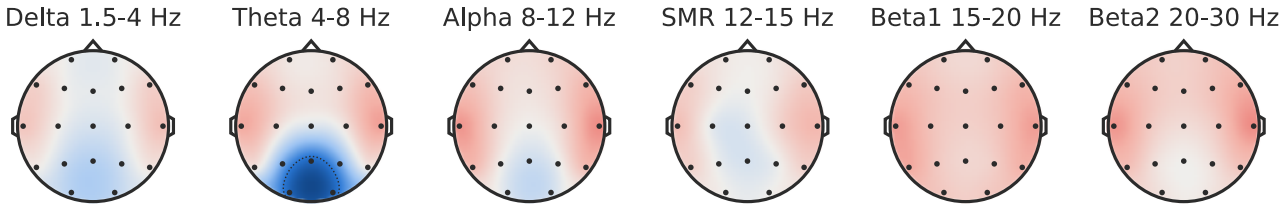


Relative Leistung, z gegen die Altersnorm, Augen geschlossen

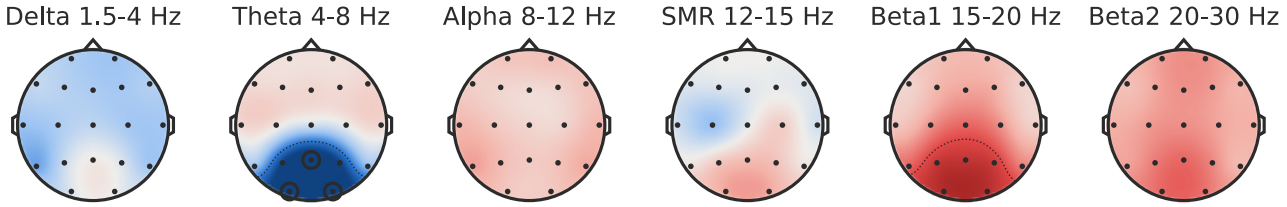

Die relative Theta-Leistung, Augen geschlossen, liegt an Pz (z = -4,1), O1 (z = -4,3) und O2 (z = -4,3) unter der Altersnorm. SP-REL-1

Die Alpha-Peak-Frequenz, Augen geschlossen, beträgt 9,2 Hz und ist nicht markiert (z = 0,0). APF-IN-2



Ring: markierter Wert (nach Korrektur für multiple Vergleiche).


Kommentar der Klinikerin oder des Klinikers

Platzhalter für den Text der Klinikerin oder des Klinikers. Geschrieben im V4-Berichtseditor; das System schreibt hier nicht.

6. Karten je 1-Hz-Band (absolute Leistung, z)

Augen geschlossen

Karten je 1-Hz-Band (absolute Leistung, z), Augen geschlossen

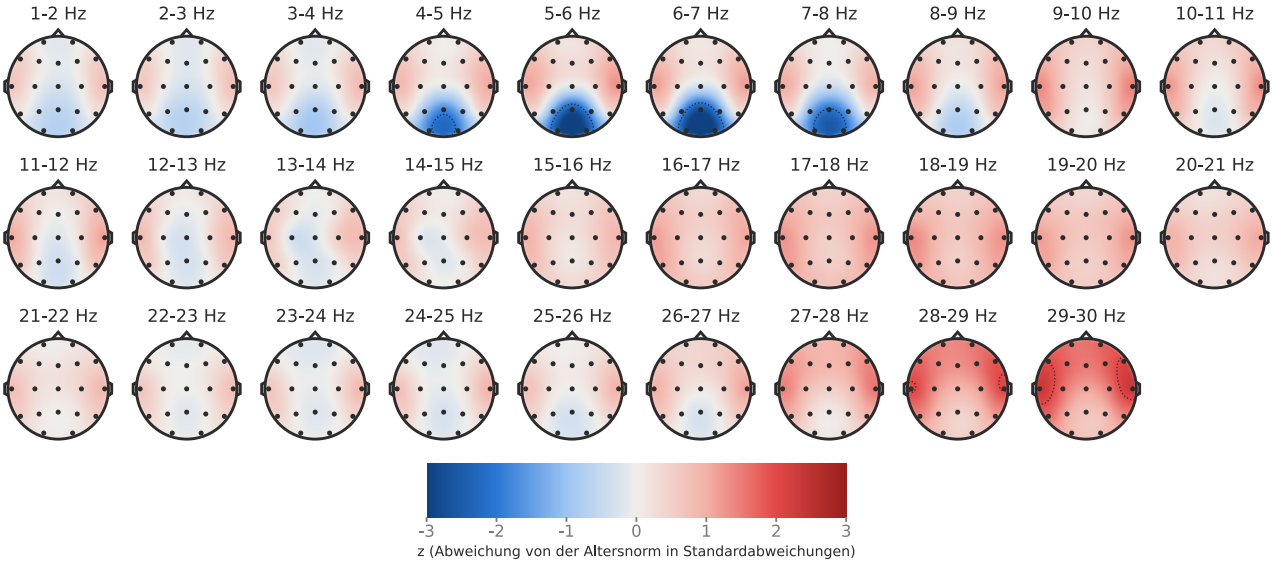


Ring: markierter Wert (nach Korrektur für multiple Vergleiche).

7. Absolute Spektren je Elektrode


Augen offen

Absolute Spektren je Elektrode, Augen offen

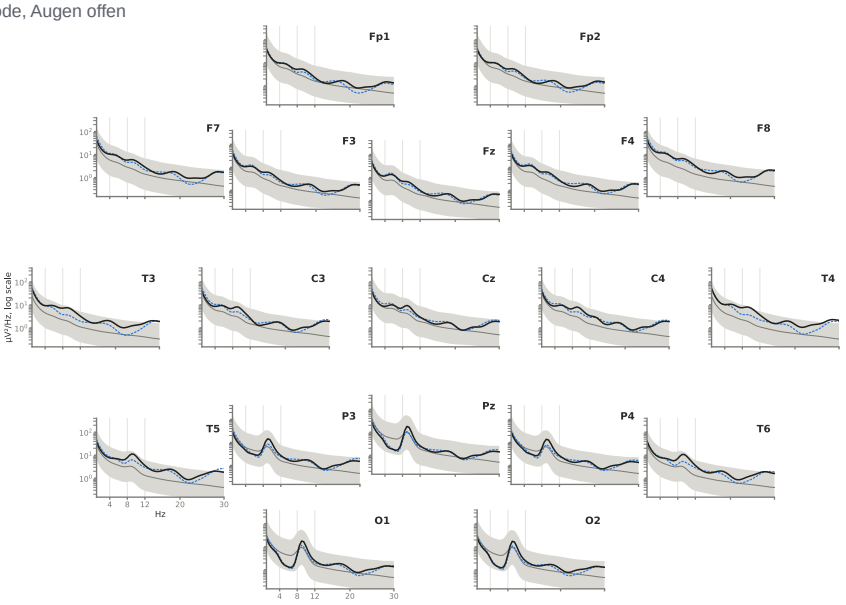

Augen geschlossen

Absolute Spektren je Elektrode, Augen geschlossen

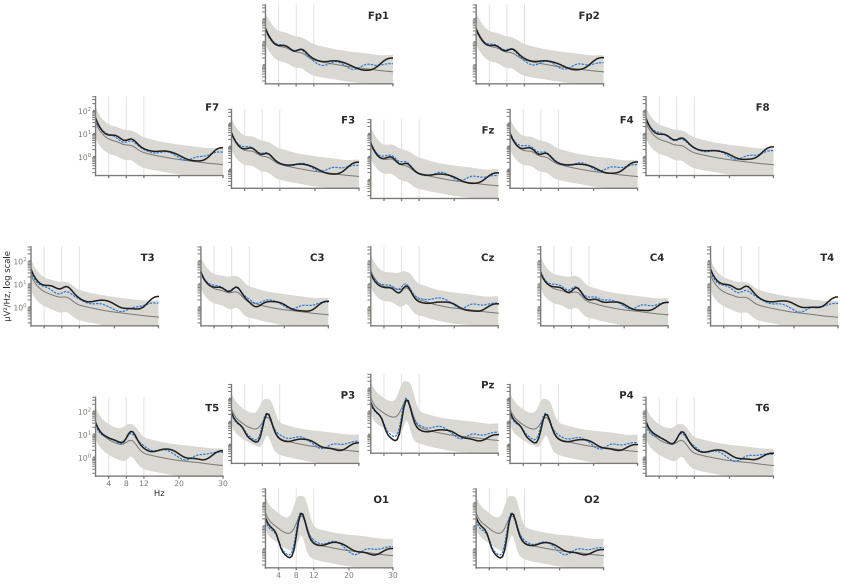

Schwarz: diese Messung. Graue Linie und Band: normativer Mittelwert und Mittelwert ± 2 SD. Blau gestrichelt: frühere Messung.

8. Frequenzmarker


Frequenzmarker und automatische Peak-Vorschläge: Kern, zu bestätigen


Frequenzmarker


Nr.		Elektrode	Frequenz (Hz)	z	Frage, Antwort	Auswahl
1	Augen offen	T5	9,0	1,6	-	vorgeschlagen, bestätigt
2	Augen offen	T5	17,5	1,5	-	vorgeschlagen, bestätigt
3	Augen offen	Fz	5,5	0,8	-	vorgeschlagen, bestätigt
1	Augen geschlossen	T4	9,0	1,5	-	vorgeschlagen, bestätigt
2	Augen geschlossen	T5	17,0	1,2	-	vorgeschlagen, bestätigt
3	Augen geschlossen	Fz	5,5	0,3	-	vorgeschlagen, bestätigt

Fett mit Ring: markierter z-Wert (nach Korrektur für multiple Vergleiche); die Zellfarbe zeigt z.


z bei der Frequenz des Markers, Augen offen









z bei der Frequenz des Markers, Augen geschlossen







Quadrat: Elektrode des Markers. Ring: markierter Wert (nach Korrektur für multiple Vergleiche).

Frequenzmarker, Augen offen: vom System vorgeschlagen und von der Klinikerin oder dem Kliniker unverändert bestätigt; Marker: 3. FM-AUTO-1

Frequenzmarker, Augen geschlossen: vom System vorgeschlagen und von der Klinikerin oder dem Kliniker unverändert bestätigt; Marker: 3. FM-AUTO-1

Das System schlägt je Bedingung bis zu 3 Peaks des Spektrums vor, und zwar die mit dem größten positiven z (absolute Leistung je 0,5-Hz-Schritt); die Klinikerin oder der Kliniker bestätigt, verschiebt, entfernt oder ergänzt Marker. Jeder Marker zeigt sein z und ob dieser Wert markiert ist. FM-RULE-1

9. Bandquotienten und Indizes

Messgröße		Wert	Normmittel	z
Theta/Beta-Quotient an Cz	Augen offen	2,74	2,76	0,0
Frontaler Alpha-Asymmetrieindex (ln F4 minus ln F3)	Augen offen	0,03	-0,01	0,4
Alpha-Peak-Frequenz (Hz)	Augen offen	9,2	9,1	0,1
Theta/Beta-Quotient an Cz	Augen geschlossen	1,95	2,82	-1,1
Frontaler Alpha-Asymmetrieindex (ln F4 minus ln F3)	Augen geschlossen	0,03	-0,01	0,4
Alpha-Peak-Frequenz (Hz)	Augen geschlossen	9,2	9,2	0,0

Fett mit Ring: markierter z-Wert (nach Korrektur für multiple Vergleiche); die Zellfarbe zeigt z.

Der Theta/Beta-Quotient an Cz, Augen offen, beträgt 2,74 (z = 0,0). TBR-1


Der frontale Alpha-Asymmetrieindex (ln F4 minus ln F3), Augen offen, beträgt 0,03 (z = 0,4). FAA-1

Der Theta/Beta-Quotient an Cz, Augen geschlossen, beträgt 1,95 (z = -1,1). TBR-1

Der frontale Alpha-Asymmetrieindex (ln F4 minus ln F3), Augen geschlossen, beträgt 0,03 (z = 0,4). FAA-1


10. Asymmetrie

Augen offen

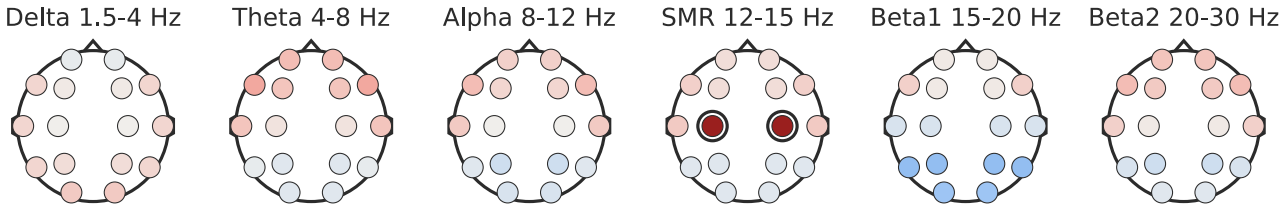


Der SMR-Asymmetrieindex, Augen offen, liegt für C3-C4 (z = 4,2) über der Altersnorm. ASY-1

Augen geschlossen

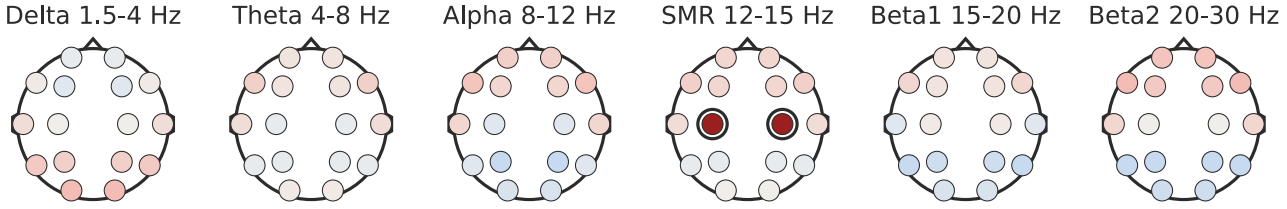

Der SMR-Asymmetrieindex, Augen geschlossen, liegt für C3-C4 (z = 4,2) über der Altersnorm. ASY-1




Asymmetrieindex (rechts minus links) / (rechts plus links) je Elektrodenpaar, z gegen die Altersnorm. Ring: markierter Wert (nach Korrektur für multiple Vergleiche).

Kommentar der Klinikerin oder des Klinikers

Platzhalter für den Text der Klinikerin oder des Klinikers. Geschrieben im V4-Berichtseditor; das System schreibt hier nicht.

11. Kohärenz

Augen offen

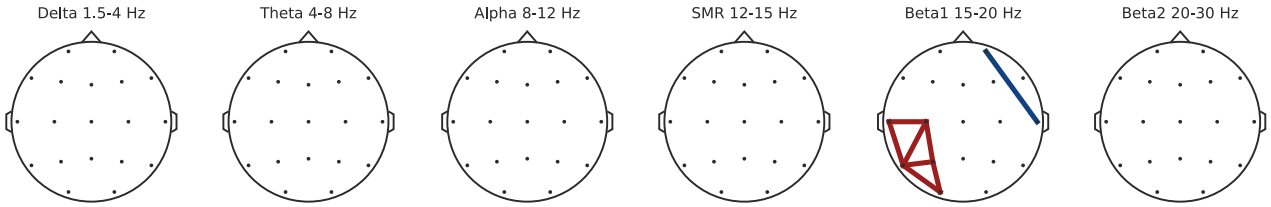


Die Beta1-Kohärenz, Augen offen, liegt für 7 Elektrodenpaare über der Altersnorm: T3-T5 (z = 3,9), T5-O1 (z = 3,9), P3-O1 (z = 3,9), T3-C3 (z = 3,8), C3-P3 (z = 3,8), C3-T5 (z = 3,7) und 1 weitere in der Tabelle. COH-1

Die Beta1-Kohärenz, Augen offen, liegt für 1 Elektrodenpaar unter der Altersnorm: Fp2-T4 (z = -3,9). COH-1

Markierte Elektrodenpaare, Augen offen

Band	Beta1							
Paar	Fp2-T4	T3-T5	T5-O1	P3-O1	T3-C3	C3-P3	C3-T5	T5-P3
Kohärenz	0,01	0,62	0,62	0,71	0,67	0,64	0,59	0,70
z	**-3,9**	**3,9**	**3,9**	**3,9**	**3,8**	**3,8**	**3,7**	**3,7**

Augen geschlossen

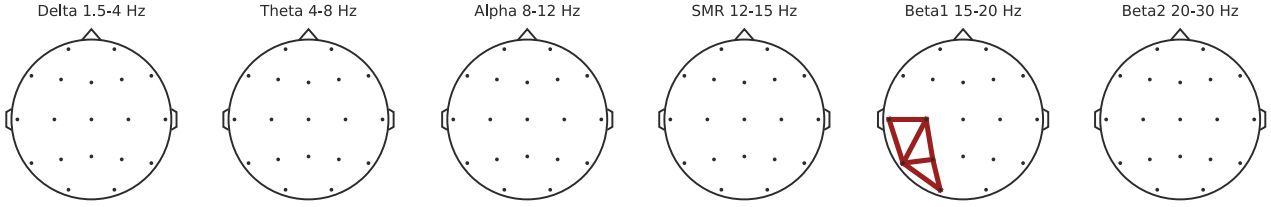


Die Beta1-Kohärenz, Augen geschlossen, liegt für 7 Elektrodenpaare über der Altersnorm: T3-C3 (z = 4,1), C3-T5 (z = 4,1), T3-T5 (z = 4,0), T5-O1 (z = 4,0), P3-O1 (z = 4,0), C3-P3 (z = 3,9) und 1 weitere in der Tabelle. COH-1

Markierte Elektrodenpaare, Augen geschlossen

Band	Beta1						
Paar	T3-C3	C3-T5	T3-T5	T5-O1	P3-O1	C3-P3	T5-P3
Kohärenz	0,68	0,62	0,63	0,63	0,71	0,66	0,71
z	**4,1**	**4,1**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**3,9**	**3,8**

Globale Kohärenz (Mittel über alle Paare), zu bestätigen


	Delta	Theta	Alpha	SMR	Beta1	Beta2
Augen offen, Wert	0,16	0,18	0,23	0,22	0,21	0,17
Augen offen, z	-2,2	-1,9	-0,3	0,0	0,1	-0,6
Augen geschlossen, Wert	0,18	0,19	0,24	0,22	0,21	0,19
Augen geschlossen, z	-1,6	-1,5	-0,7	-0,1	0,1	-0,1




Linien: markierte Elektrodenpaare, nach z eingefärbt. Fett mit Ring: markierter z-Wert (nach Korrektur für multiple Vergleiche); die Zellfarbe zeigt z. Die globale Kohärenz ist eine Kernfunktion, die noch zu bestätigen ist; sie wird in der Zusammenfassung nicht eingeordnet.

12. Ereigniskorrelierte Potenziale an den Elektroden (Kanal-ERPs)

Ereigniskorrelierte Potenziale an den Elektroden (Kanal-ERPs): Go

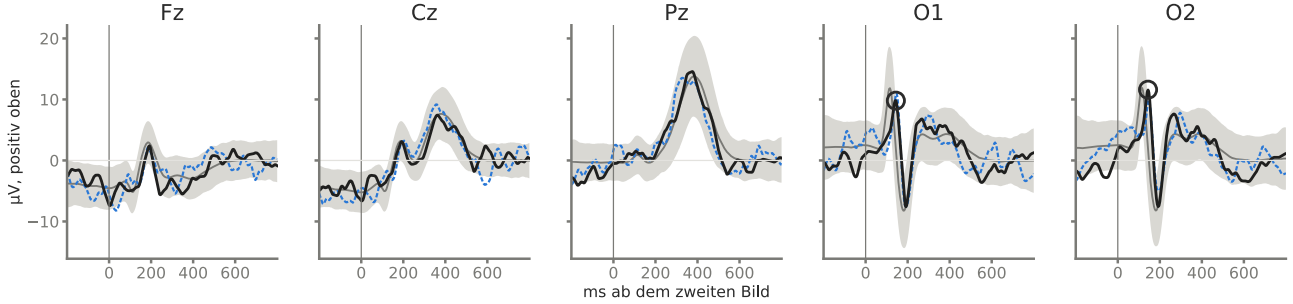

Ereigniskorrelierte Potenziale an den Elektroden (Kanal-ERPs): NoGo

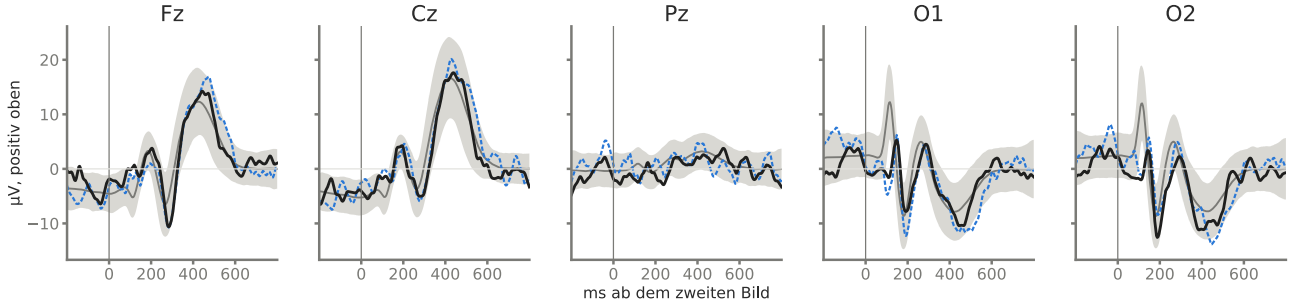

Schwarz: diese Messung. Graue Linie und Band: normativer Mittelwert und Mittelwert ± 2 SD. Zeit 0: zweiter Reiz. Ring: markierter Wert (nach Korrektur für multiple Vergleiche). Blau gestrichelt: frühere Messung.

ERP-Peakwerte

Komponente	Durchgangstyp	Elektrode	Amplitude (µV)	z	Latenz (ms)	z
P1	Go	O1	9,8	-1,0	144	**3,7**
P1	Go	O2	11,6	-0,5	144	**3,7**
N1	Go	O1	-7,6	0,6	192	0,9
N1	Go	O2	-7,6	0,6	192	1,0
N2	NoGo	Fz	-10,7	-1,1	284	1,2
N2	NoGo	Cz	-5,0	-0,2	280	1,1
P3	Go	Pz	14,6	-0,1	372	-0,4
P3	NoGo	Cz	17,6	-0,2	440	0,5
P3	NoGo	Fz	14,3	0,2	444	0,6
P3a	Novelty	Cz	16,4	0,4	360	1,2
CNV	Go	Cz	-4,8	0,0	-200 bis 0	

Fett mit Ring: markierter z-Wert (nach Korrektur für multiple Vergleiche); die Zellfarbe zeigt z.

ERP-Peaks, Go-Durchgänge: Die vorgeschlagenen Peaks wurden von der Klinikerin oder dem Kliniker unverändert bestätigt. ERP-PEAK-AUTO-1

ERP-Peaks, NoGo-Durchgänge: Die vorgeschlagenen Peaks wurden von der Klinikerin oder dem Kliniker unverändert bestätigt. ERP-PEAK-AUTO-1

ERP-Peaks, Novelty-Durchgänge: Die vorgeschlagenen Peaks wurden von der Klinikerin oder dem Kliniker unverändert bestätigt. ERP-PEAK-AUTO-1

Die P1-Latenz an O1, Go-Durchgänge, ist später als die Altersnorm (144 ms, z = 3,7). ERP-LAT-1

Die P1-Latenz an O2, Go-Durchgänge, ist später als die Altersnorm (144 ms, z = 3,7). ERP-LAT-1

13. Checkliste über die Kanal-ERPs

Checkliste über die Kanal-ERPs: Kern, zu bestätigen (Vorschlag an die klinische Leitung)

Komponente	Durchgangstyp	Elektrode	Fenster (ms)	Latenz früher	Latenz später	Amplitude größer	Amplitude kleiner	Form abweichend
P1	Go	O1	70 bis 170		✓			
P1	Go	O2	70 bis 170		✓			
N1	Go	O1	140 bis 250					
N1	Go	O2	140 bis 250					
N2	NoGo	Fz	210 bis 330					
N2	NoGo	Cz	210 bis 330					
P3	Go	Pz	280 bis 560					
P3	NoGo	Cz	300 bis 600					
P3	NoGo	Fz	300 bis 600					
P3a	Novelty	Cz	250 bis 420					
CNV	Go	Cz	-200 bis 0	-	-			

Kreuze der Klinikerin oder des Klinikers, gegenüber den Normkurven der Abbildungen der Kanal-ERPs. Bei N1, N2 und CNV bedeutet größer negativer. Strich: Punkt für diese Zeile nicht angeboten.

Checkliste über die Kanal-ERPs, P1 an O1, Go-Durchgänge (70 bis 170 ms), von der Klinikerin oder dem Kliniker angekreuzt: spätere Latenz als die Normkurve. ERPCL-TICK-1

Checkliste über die Kanal-ERPs, P1 an O2, Go-Durchgänge (70 bis 170 ms), von der Klinikerin oder dem Kliniker angekreuzt: spätere Latenz als die Normkurve. ERPCL-TICK-1

Checkliste über die Kanal-ERPs: Zeilen ohne Kreuz: 9. ERPCL-REST-1

In dieser Checkliste kreuzt die Klinikerin oder der Kliniker an, was die Abbildungen der Kanal-ERPs gegenüber den Normkurven zeigen; das System berechnet aus den Kreuzen nichts und gibt sie wie angekreuzt wieder. ERPCL-RULE-1


Kommentar der Klinikerin oder des Klinikers

Platzhalter für den Text der Klinikerin oder des Klinikers. Geschrieben im V4-Berichtseditor; das System schreibt hier nicht.

14. VCPT-Aufgabenleistung

Messgröße	Wert	Perzentil	z
Auslassungsfehler	2	46	-0,1
Fehlreaktionen (Kommissionsfehler)	4	81	0,9
Mittlere Reaktionszeit	409 ms	47	-0,1
Variabilität der Reaktionszeit (SD)	86 ms	42	-0,2

Fett mit Ring: markierter z-Wert (nach Korrektur für multiple Vergleiche); die Zellfarbe zeigt z.

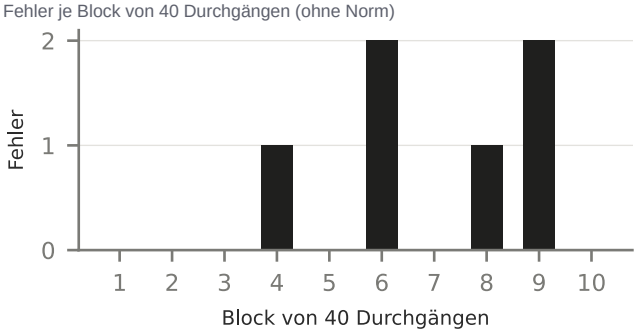

Auslassungsfehler: 2, nicht markiert (Perzentil 46). BEH-IN-2

Fehlreaktionen (Kommissionsfehler): 4, nicht markiert (Perzentil 81). BEH-IN-2

Mittlere Reaktionszeit: 409 ms, nicht markiert (Perzentil 47). BEH-IN-2


Variabilität der Reaktionszeit (SD): 86 ms, nicht markiert (Perzentil 42). BEH-IN-2

15. Vergleich der Messungen


Messgröße	Früher 23.09.2025 (später hochgeladen)	z	Früher 12.03.2026	z	Aktuell 15.09.2026	z
Auslassungsfehler	3	0,3	3	0,3	2	-0,1
Fehlreaktionen (Kommissionsfehler)	6	1,5	5	1,2	4	0,9
Mittlere Reaktionszeit	431 ms	0,2	421 ms	0,1	409 ms	-0,1
Variabilität der Reaktionszeit (SD)	97 ms	0,2	95 ms	0,2	86 ms	-0,2
Theta/Beta-Quotient an Cz, Augen offen	2,22	-0,7	2,61	-0,2	2,74	0,0
Alpha-Peak-Frequenz (Hz), Augen offen	8,9	-0,2	9,1	0,0	9,2	0,1
Theta/Beta-Quotient an Cz, Augen geschlossen	2,09	-0,9	1,93	-1,1	1,95	-1,1
Alpha-Peak-Frequenz (Hz), Augen geschlossen	9,1	-0,1	9,1	-0,1	9,2	0,0

Fett mit Ring: markierter z-Wert (nach Korrektur für multiple Vergleiche); die Zellfarbe zeigt z.


Früher 23.09.2025: Absolute Leistung, z gegen die Altersnorm, Augen geschlossen

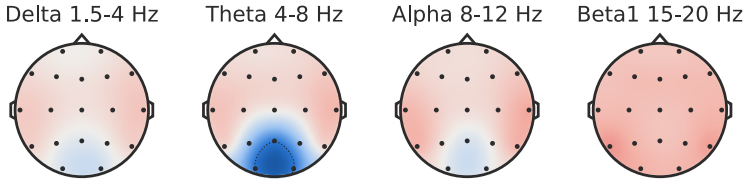

Früher 12.03.2026: Absolute Leistung, z gegen die Altersnorm, Augen geschlossen

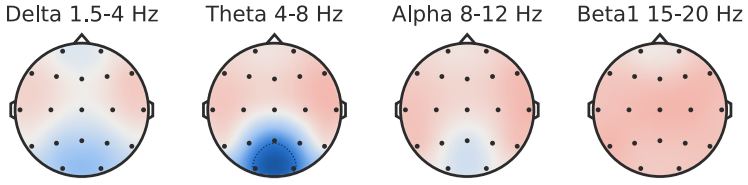

Aktuell 15.09.2026: Absolute Leistung, z gegen die Altersnorm, Augen geschlossen

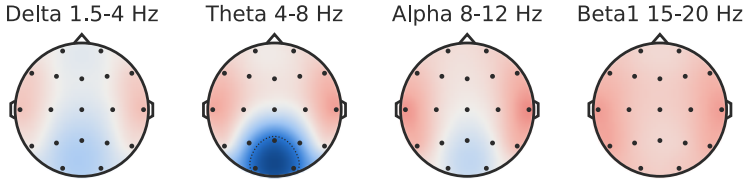

Ring: markierter Wert (nach Korrektur für multiple Vergleiche).

Beta1-Kohärenz T3-C3, Augen geschlossen: z = 4,7 am 23.09.2025, z = 4,1 am 12.03.2026 und z = 4,1 am 15.09.2026. CMP-N-1

Beta1-Kohärenz T3-T5, Augen geschlossen: z = 4,6 am 23.09.2025, z = 4,3 am 12.03.2026 und z = 4,0 am 15.09.2026. CMP-N-1

Beta1-Kohärenz T5-O1, Augen geschlossen: z = 4,6 am 23.09.2025, z = 4,0 am 12.03.2026 und z = 4,0 am 15.09.2026. CMP-N-1

Beta1-Kohärenz P3-O1, Augen geschlossen: z = 4,6 am 23.09.2025, z = 4,2 am 12.03.2026 und z = 4,0 am 15.09.2026. CMP-N-1

Beta1-Kohärenz C3-P3, Augen geschlossen: z = 4,5 am 23.09.2025, z = 4,2 am 12.03.2026 und z = 3,9 am 15.09.2026. CMP-N-1

Beta1-Kohärenz T5-P3, Augen geschlossen: z = 4,5 am 23.09.2025, z = 4,3 am 12.03.2026 und z = 3,8 am 15.09.2026. CMP-N-1

Die frühere Messung vom 23.09.2025 wurde mit der aktuellen Software und den aktuellen Normen erneut ausgewertet (V4 mockup 0.1; Mock norms 2026.1 (synthetisch)). L-REPROC-1

Die frühere Messung vom 12.03.2026 wurde mit der aktuellen Software und den aktuellen Normen erneut ausgewertet (V4 mockup 0.1; Mock norms 2026.1 (synthetisch)). L-REPROC-1

Die Messungen stehen nebeneinander, jede gegen ihre eigene Altersnorm; Unterschiede zwischen ihnen werden nicht auf statistische Signifikanz geprüft. L-SIDE-1

Später hochgeladene Messungen werden aus ihren Aufnahmen ausgewertet; Berichte und Zahlen früherer Software werden nicht übernommen. L-IMPORT-1

16. Hinweise zu den Ergebnissen

Die Ergebnisse sind ein Baustein der klinischen Beurteilung. Die Software stellt keine Diagnose und gibt keine Therapieempfehlung. L-AID-1

z ist der Abstand eines Werts vom normativen Mittelwert in Standardabweichungen der Normstichprobe; etwa 95 % der Normstichprobe liegen zwischen z = -2 und z = 2. L-Z-1

Markierte Werte weichen nach Korrektur für multiple Vergleiche von der Altersnorm ab; die Korrektur hält Zufallsergebnisse unter den vielen Vergleichen selten. Ein nicht markierter Wert jenseits von 2 z kann allein durch Zufall abweichen. Die Korrekturmethode ist noch festzulegen. L-MC-1

17. Methode und Normen

Aufnahme: Mitsar-Verstärker, WinEEG-Datei (Mockup-Bezeichnung); 19 Kopfhautelektroden des 10-20-Systems (Fp1 bis O2); Bedingungen: Augen offen, Augen geschlossen und VCPT. MET-REC-1

Verarbeitung: Durchschnittsreferenz der 19 Kopfhautkanäle; Netzfilter bei 50 Hz; Analyserate 250 Hz; Artefakte durch Analyse unabhängiger Komponenten (ICA) mit Referenzkarten entfernt, danach verbliebene Artefaktsegmente ausgeschlossen. MET-PROC-1

Spektren: 1 bis 30 Hz in Schritten von 0,5 Hz, mit der Norm als log10-Leistung verglichen. Bänder: Delta 1,5 bis 4 Hz, Theta 4 bis 8 Hz, Alpha 8 bis 12 Hz, SMR 12 bis 15 Hz, Beta1 15 bis 20 Hz und Beta2 20 bis 30 Hz. Theta/Beta-Quotient an Cz mit Theta 4 bis 8 Hz und Beta 13 bis 21 Hz. MET-SPEC-1

ERPs: VCPT mit je 100 Durchgängen Go, NoGo, Ignore und Novelty; Epochen von -200 bis 800 ms um das zweite Bild, Baseline vor dem Hinweisreiz; Peaks in festen Fenstern von den Kurven abgelesen. MET-ERP-1

Normen: Mock norms, Version 2026.1 (synthetisch); Altersbereich der Normen 6 bis 67 Jahre; verglichen beim Alter zur Aufnahme, 10 Jahre. MET-NORM-1

Markierung: Ein Wert wird markiert, wenn er nach Korrektur für multiple Vergleiche von der Altersnorm abweicht; bis die Methode festgelegt ist, verwendet dieses Mockup die Falscherkennungsrate nach Benjamini-Hochberg (q = 0,05) innerhalb jedes Analyseblocks. MET-MC-1

Aufnahmebedingungen (beim Hochladen dokumentiert)

Uhrzeit der Aufnahme	09:40
Medikation am Aufnahmetag	keine angegeben
Schlaf in der Nacht davor	wie gewohnt
Müdigkeit während der Aufnahme beobachtet	nein

18. Formular der Klinikerin oder des Klinikers

Überweisung erhalten	01.09.2026
Roh-EEG von der Klinikerin oder dem Kliniker geprüft	ja
Ergebnisse mit Patient oder Familie besprochen	22.09.2026
Kopie des Berichts an die überweisende Ärztin oder den überweisenden Arzt	ja

19. Interpretation

Platzhalter für den Text der Klinikerin oder des Klinikers. Geschrieben im V4-Berichtseditor; das System schreibt hier nicht.

20. Schlussfolgerung

Platzhalter für den Text der Klinikerin oder des Klinikers. Geschrieben im V4-Berichtseditor; das System schreibt hier nicht.

Freigabe

Freigegeben von	_____ (wird bei der Freigabe durch die Klinikerin oder den Kliniker eingetragen)
Datum der Freigabe	_____ (wird bei der Freigabe durch die Klinikerin oder den Kliniker eingetragen)
Version	1 · Entwurf, nicht freigegeben
Ersetzt	keine, erste Version