Clinic B

[Abteilung oder Praxis, Platzhalter]
[Leitung, Platzhalter]
[Straße, PLZ und Ort, Platzhalter]
[Telefon und E-Mail, Platzhalter]

LOGO CLINIC B

Quantitativer EEG- und ERP-Bericht

Patient	Mock Patient 042
Geburtsdatum	01.01.2016
Alter	10 Jahre
Geschlecht	weiblich
Aufnahme	15.09.2026
Fallnummer	MOCK-042
Frühere Messung	12.03.2026
Überweisung durch	[Platzhalter]
Besprechung der Ergebnisse	[Platzhalter]

Inhalt

1. Zusammenfassung 2
2. Signalqualität und Verarbeitung 2
3. Anamnese 2
4. Spektren und Karten 3
5. Karten je 1-Hz-Band (absolute Leistung, z) 4
6. Absolute Spektren je Elektrode 5
7. Bandquotienten und Indizes 6
8. Asymmetrie 6
9. Kohärenz 7
10. Ereigniskorrelierte Potenziale an den Elektroden (Kanal-ERPs) 8
11. VCPT-Aufgabenleistung 9
12. Vergleich der Messungen 10
13. Hinweise zu den Ergebnissen 10
14. Interpretation 10
15. Schlussfolgerung 10

Software	V4 mockup 0.1
Normen	Mock norms 2026.1 (synthetisch)
Aufnahmesystem	Mitsar amplifier, WinEEG file (mockup label)
Bericht	R-MOCK-042-B01 · Version 1 · Entwurf, nicht freigegeben

1. Zusammenfassung

Die größten markierten Abweichungen von der Altersnorm in dieser Messung sind: relative Theta-Leistung, Augen offen: Pz (z = -4,6), O1 (z = -4,0), O2 (z = -4,0); relative Theta-Leistung, Augen geschlossen: Pz (z = -4,4), O2 (z = -4,2), O1 (z = -4,0), P4 (z = -3,5), P3 (z = -3,2); SMR-Asymmetrieindex, Augen offen: C3-C4 (z = 4,2); SMR-Asymmetrieindex, Augen geschlossen: C3-C4 (z = 4,2); Beta1-Kohärenz, Augen geschlossen: T5-O1 (z = 4,0), C3-T5 (z = 4,0), T5-P3 (z = 4,0), P3-O1 (z = 3,9), T3-T5 (z = 3,8), T3-C3 (z = 3,8), C3-P3 (z = 3,7); Beta1-Kohärenz, Augen offen: T3-C3 (z = 3,9), C3-T5 (z = 3,9), T5-P3 (z = 3,8), P3-O1 (z = 3,8), C3-P3 (z = 3,7), T3-T5 (z = 3,7), T5-O1 (z = 3,6); P1-Latenz, Go: O1 (z = 3,7), O2 (z = 3,2); Delta-Kohärenz, Augen geschlossen: Cz-T6 (z = -3,5). SUM-2

Die Liste ordnet die markierten Werte dieser Analysen nach |z|: absolute und relative Bandleistung, Karten je 1-Hz-Band, Alpha-Peak-Frequenz, Theta/Beta-Quotient, frontaler Alpha-Asymmetrieindex, Asymmetriekarte, Kohärenz je Elektrodenpaar, ERP-Peakamplitude und -latenz sowie die Ergebnisse der VCPT-Aufgabe. Sie zeigt die 5 größten und jeden markierten Wert ab 3 z. Nicht eingeordnet: die Spektren je 0,5-Hz-Schritt, die als Kurven gegen die Norm gezeigt werden, und die globale Kohärenz, die noch zu bestätigen ist. SUM-RULE-2

Markierte Werte in dieser Messung: Bandleistung 8 von 456, Karten je 1-Hz-Band 0 von 1102, Alpha-Peak und Quotienten 0 von 6, Asymmetriekarte 2 von 96, Kohärenz 15 von 2052, ERP-Peaks 2 von 21 und VCPT-Aufgabe 0 von 4. SUM-COUNT-1

2. Signalqualität und Verarbeitung

Augen offen: 164 von 180 Sekunden wurden nach der Artefaktentfernung ausgewertet. Q-DUR-1

Augen geschlossen: 171 von 180 Sekunden wurden nach der Artefaktentfernung ausgewertet. Q-DUR-1

VCPT: 1168 von 1220 Sekunden wurden nach der Artefaktentfernung ausgewertet. Q-DUR-1

Akzeptierte VCPT-Durchgänge: Go 95, NoGo 92, Ignore 93, Novelty 95 (von je 100). Q-TRIALS-1

Artefaktentfernung durch die Klinikerin oder den Kliniker geändert: Komponente 6 (Muskel, links temporal) wurde beibehalten, obwohl die automatische Bereinigung ihre Entfernung vorschlug; 2 von 19 Komponenten wurden entfernt. Q-ICA-MAN-1


3. Anamnese

Platzhalter für den Text der Klinikerin oder des Klinikers. Geschrieben im V4-Berichtseditor; das System schreibt hier nicht.


4. Spektren und Karten

Augen offen

Absolute Leistung, z gegen die Altersnorm, Augen offen

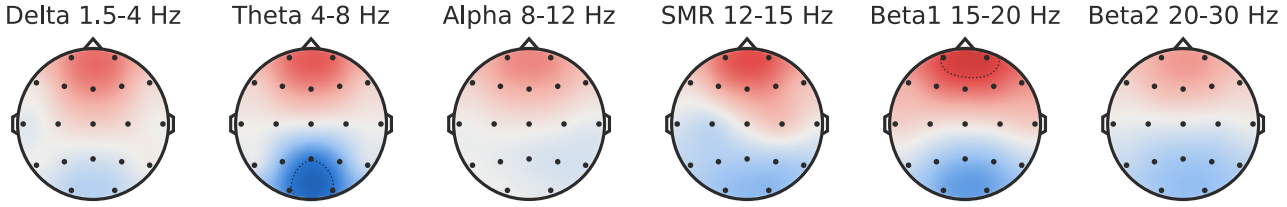

Relative Leistung, z gegen die Altersnorm, Augen offen

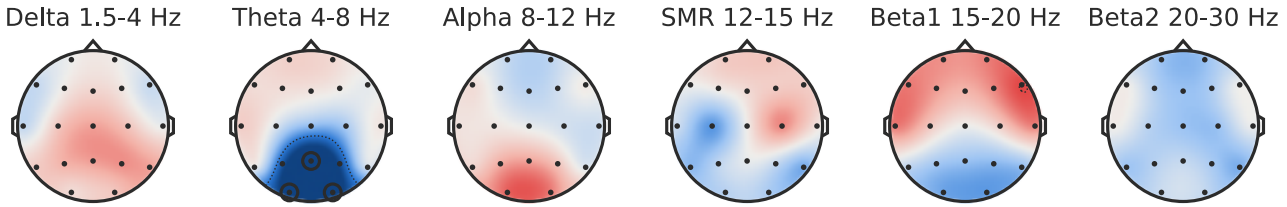


Die relative Theta-Leistung, Augen offen, liegt an Pz (z = -4,6), O1 (z = -4,0) und O2 (z = -4,0) unter der Altersnorm. SP-REL-1


Die Alpha-Peak-Frequenz, Augen offen, beträgt 9,2 Hz und ist nicht markiert (z = 0,2). APF-IN-2

Augen geschlossen

Absolute Leistung, z gegen die Altersnorm, Augen geschlossen

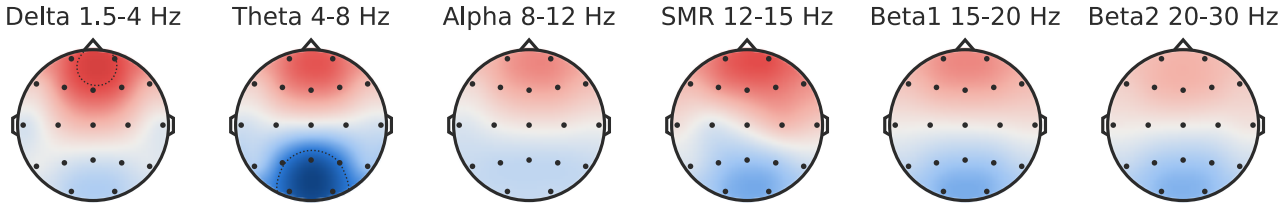


Relative Leistung, z gegen die Altersnorm, Augen geschlossen

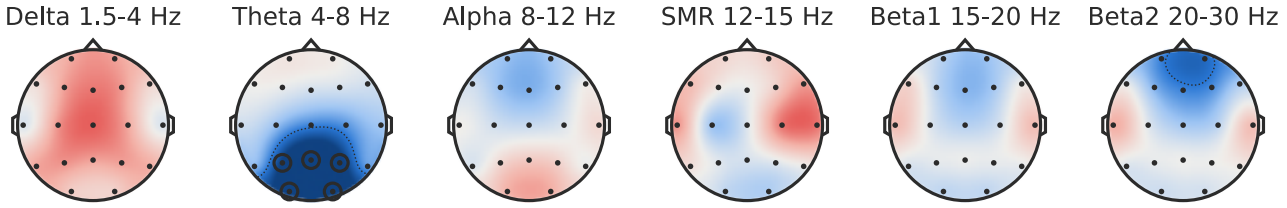

Die relative Theta-Leistung, Augen geschlossen, liegt an P3 (z = -3,2), Pz (z = -4,4), P4 (z = -3,5), O1 (z = -4,0) und O2 (z = -4,2) unter der Altersnorm. SP-REL-1

Die Alpha-Peak-Frequenz, Augen geschlossen, beträgt 9,3 Hz und ist nicht markiert (z = 0,2). APF-IN-2

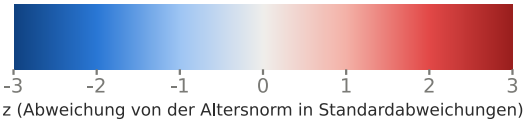

Schwarze Ringe: nach Korrektur für multiple Vergleiche markierte Werte.


Kommentar der Klinikerin oder des Klinikers

Platzhalter für den Text der Klinikerin oder des Klinikers. Geschrieben im V4-Berichtseditor; das System schreibt hier nicht.

5. Karten je 1-Hz-Band (absolute Leistung, z)

Augen geschlossen

Karten je 1-Hz-Band (absolute Leistung, z), Augen geschlossen

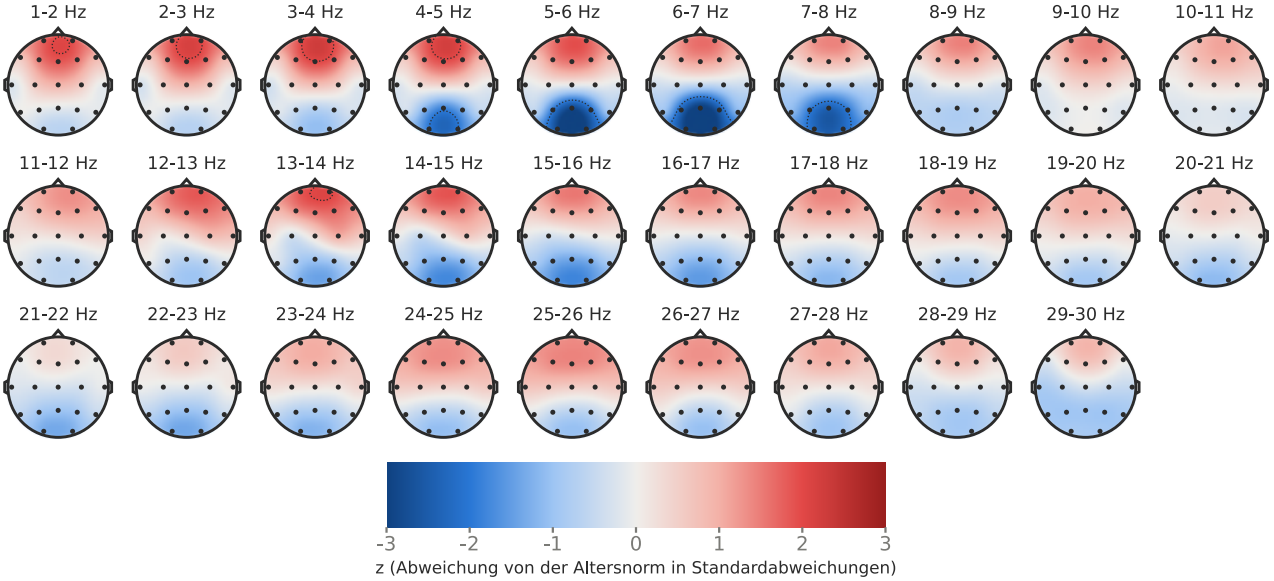


Schwarze Ringe: nach Korrektur für multiple Vergleiche markierte Werte.

6. Absolute Spektren je Elektrode


Augen offen

Absolute Spektren je Elektrode, Augen offen

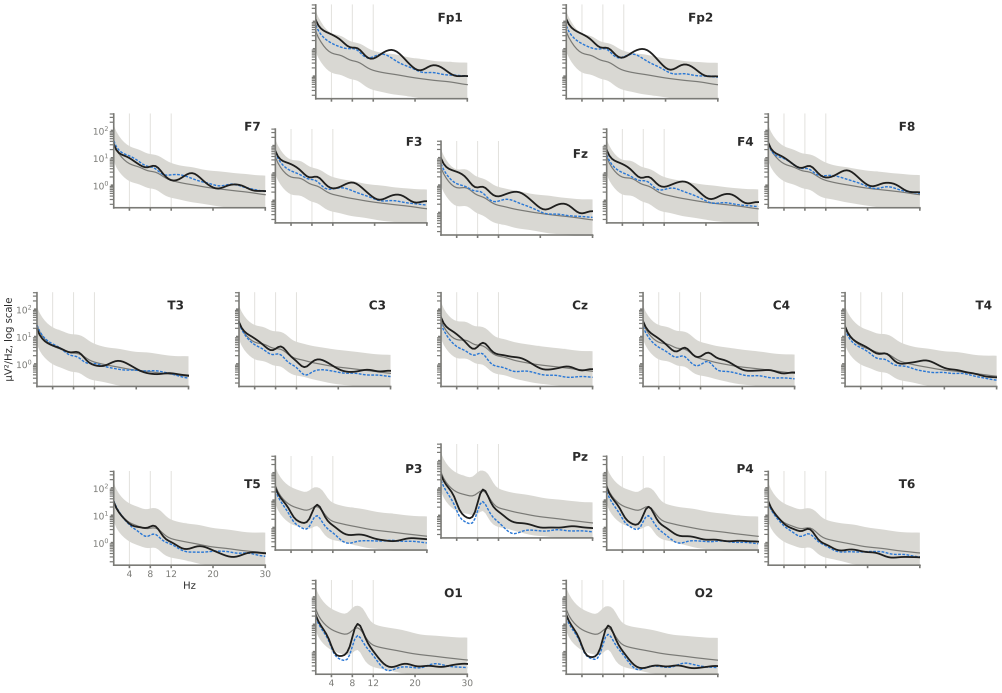

Augen geschlossen

Absolute Spektren je Elektrode, Augen geschlossen

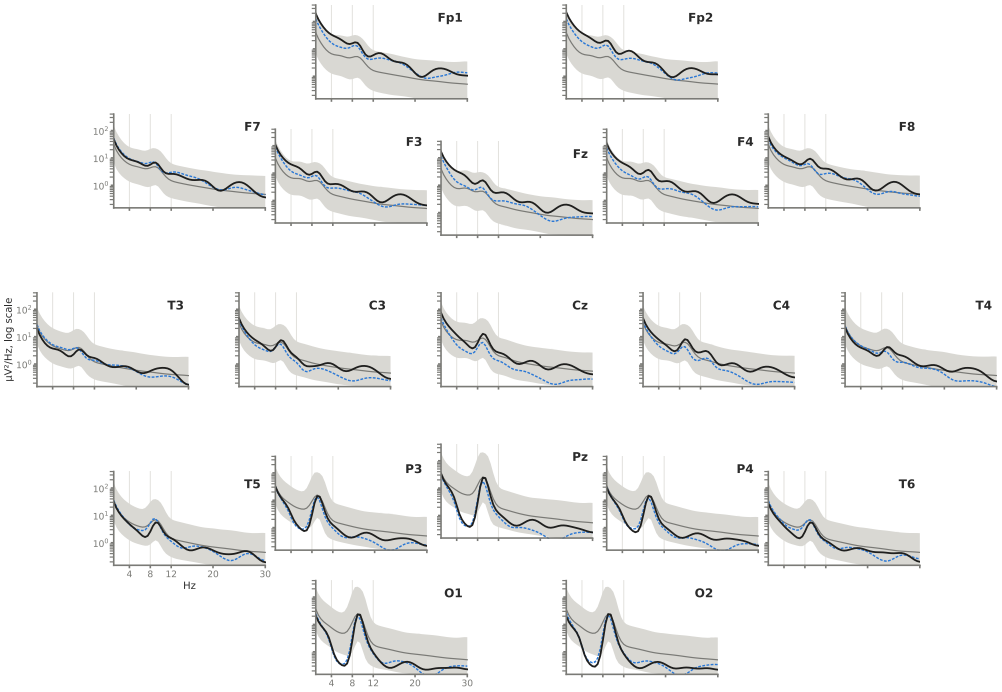

Schwarz: diese Messung. Graue Linie und Band: normativer Mittelwert und Mittelwert ± 2 SD. Blau gestrichelt: frühere Messung.

7. Bandquotienten und Indizes

Messgröße		Wert	Normmittel	z
Theta/Beta-Quotient an Cz	Augen offen	2,42	2,75	-0.4
Frontaler Alpha-Asymmetrieindex (ln F4 minus ln F3)	Augen offen	0,01	-0,01	0.1
Alpha-Peak-Frequenz (Hz)	Augen offen	9,2	9,1	0.2
Theta/Beta-Quotient an Cz	Augen geschlossen	2,56	3,00	-0.4
Frontaler Alpha-Asymmetrieindex (ln F4 minus ln F3)	Augen geschlossen	0,16	-0,00	0.9
Alpha-Peak-Frequenz (Hz)	Augen geschlossen	9,3	9,2	0.2

Der Theta/Beta-Quotient an Cz, Augen offen, beträgt 2,42 (z = -0,4). TBR-1


Der frontale Alpha-Asymmetrieindex (ln F4 minus ln F3), Augen offen, beträgt 0,01 (z = 0,1). FAA-1

Der Theta/Beta-Quotient an Cz, Augen geschlossen, beträgt 2,56 (z = -0,4). TBR-1

Der frontale Alpha-Asymmetrieindex (ln F4 minus ln F3), Augen geschlossen, beträgt 0,16 (z = 0,9). FAA-1


8. Asymmetrie

Augen offen

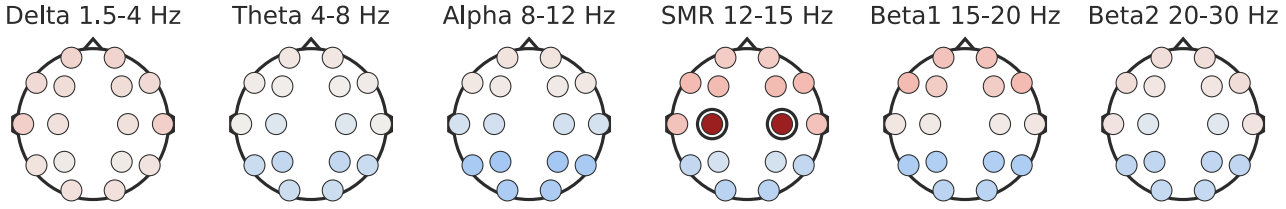


Der SMR-Asymmetrieindex, Augen offen, liegt für C3-C4 (z = 4,2) über der Altersnorm. ASY-1

Augen geschlossen

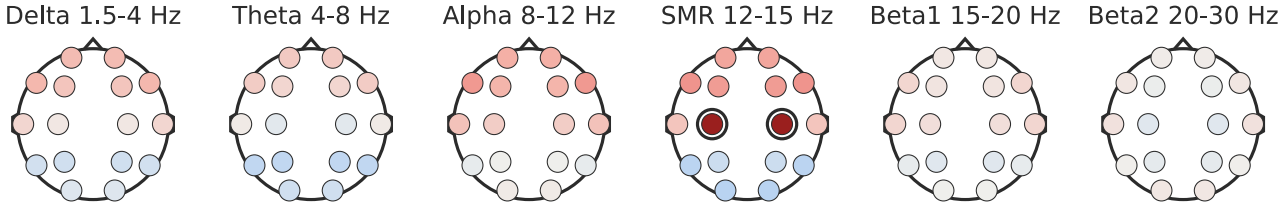

Der SMR-Asymmetrieindex, Augen geschlossen, liegt für C3-C4 (z = 4,2) über der Altersnorm. ASY-1

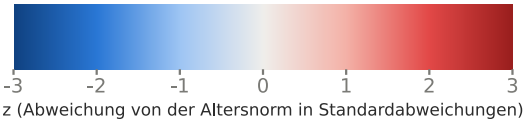


Asymmetrieindex (rechts minus links) / (rechts plus links) je Elektrodenpaar, z gegen die Altersnorm. Schwarze Ringe: nach Korrektur für multiple Vergleiche markierte Werte.

Kommentar der Klinikerin oder des Klinikers

Platzhalter für den Text der Klinikerin oder des Klinikers. Geschrieben im V4-Berichtseditor; das System schreibt hier nicht.

9. Kohärenz

Augen offen

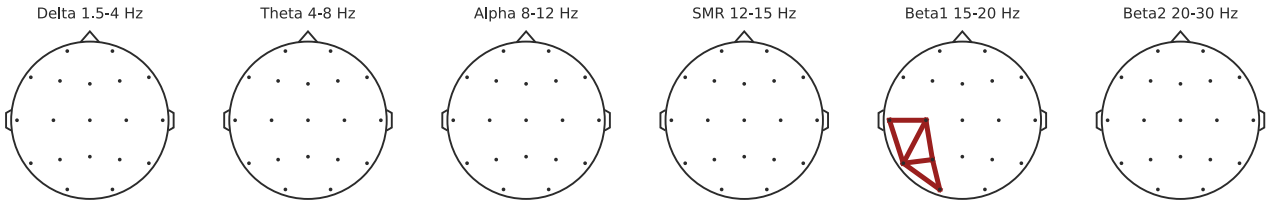


Die Beta1-Kohärenz, Augen offen, liegt für 7 Elektrodenpaare über der Altersnorm: T3-C3 (z = 3,9), C3-T5 (z = 3,9), T5-P3 (z = 3,8), P3-O1 (z = 3,8), C3-P3 (z = 3,7), T3-T5 (z = 3,7) und 1 weitere in der Tabelle. COH-1

Globale Kohärenz (Mittel über alle Paare), zu bestätigen, Augen offen

	Delta	Theta	Alpha	SMR	Beta1	Beta2
Wert	0,22	0,22	0,22	0,20	0,24	0,23
z	-0.5	-0.7	-0.8	-0.4	0.9	1.2

Augen geschlossen

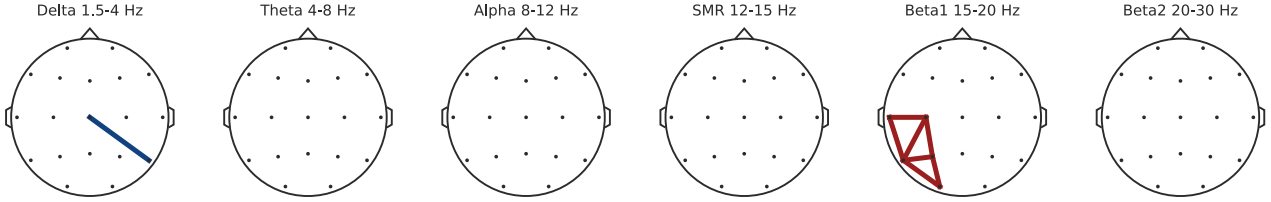


Die Delta-Kohärenz, Augen geschlossen, liegt für 1 Elektrodenpaar unter der Altersnorm: Cz-T6 (z = -3,5). COH-1

Die Beta1-Kohärenz, Augen geschlossen, liegt für 7 Elektrodenpaare über der Altersnorm: T5-O1 (z = 4,0), C3-T5 (z = 4,0), T5-P3 (z = 4,0), P3-O1 (z = 3,9), T3-T5 (z = 3,8), T3-C3 (z = 3,8) und 1 weitere in der Tabelle. COH-1

Globale Kohärenz (Mittel über alle Paare), zu bestätigen, Augen geschlossen


	Delta	Theta	Alpha	SMR	Beta1	Beta2
Wert	0,17	0,17	0,21	0,23	0,25	0,20
z	-1.8	-1.9	-1.5	0.2	1.4	0.4




Linien: Elektrodenpaare mit |z| ab 2. Die globale Kohärenz ist eine Kernfunktion, die noch zu bestätigen ist; sie wird in der Zusammenfassung nicht eingeordnet.

10. Ereigniskorrelierte Potenziale an den Elektroden (Kanal-ERPs)

Ereigniskorrelierte Potenziale an den Elektroden (Kanal-ERPs): Go

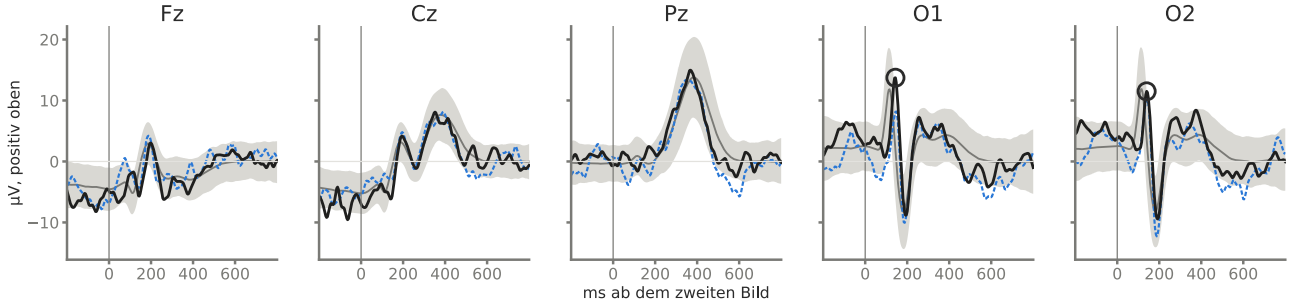

Ereigniskorrelierte Potenziale an den Elektroden (Kanal-ERPs): NoGo

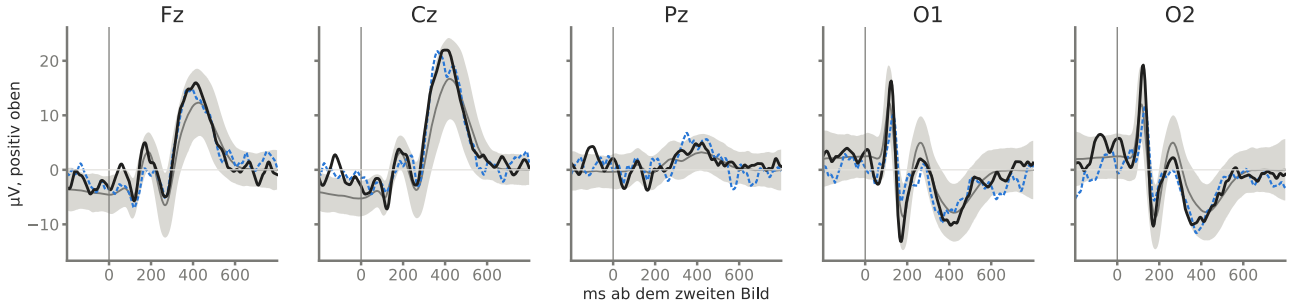

Schwarz: diese Messung. Graue Linie und Band: normativer Mittelwert und Mittelwert ± 2 SD. Zeit 0: zweiter Reiz. Schwarze Ringe: nach Korrektur für multiple Vergleiche markierte Werte. Blau gestrichelt: frühere Messung.

ERP-Peakwerte

Komponente	Durchgangstyp	Elektrode	Amplitude (µV)	z	Latenz (ms)	z
P1	Go	O1	13,7	0.2	144	3.7
P1	Go	O2	11,5	-0.5	140	3.2
N1	Go	O1	-8,8	0.2	192	0.9
N1	Go	O2	-9,4	0.0	192	0.9
N2	NoGo	Fz	-5,0	0.9	268	0.1
N2	NoGo	Cz	-2,8	0.7	260	-0.2
P3	Go	Pz	15,0	0.0	368	-0.6
P3	NoGo	Cz	22,0	1.1	396	-1.0
P3	NoGo	Fz	16,0	0.8	412	-0.4
P3a	Novelty	Cz	15,8	0.2	360	1.2
CNV	Go	Cz	-7,0	-1.8	-200 to 0	

Die P1-Latenz an O1, Go-Durchgänge, ist später als die Altersnorm (144 ms, z = 3,7). ERP-LAT-1


Die P1-Latenz an O2, Go-Durchgänge, ist später als die Altersnorm (140 ms, z = 3,2). ERP-LAT-1

Kommentar der Klinikerin oder des Klinikers

Platzhalter für den Text der Klinikerin oder des Klinikers. Geschrieben im V4-Berichtseditor; das System schreibt hier nicht.

11. VCPT-Aufgabenleistung

Messgröße	Wert	Perzentil	z
Auslassungsfehler	2	46	-0.1
Fehlreaktionen (Kommissionsfehler)	4	81	0.9
Mittlere Reaktionszeit	409 ms	47	-0.1
Variabilität der Reaktionszeit (SD)	86 ms	42	-0.2

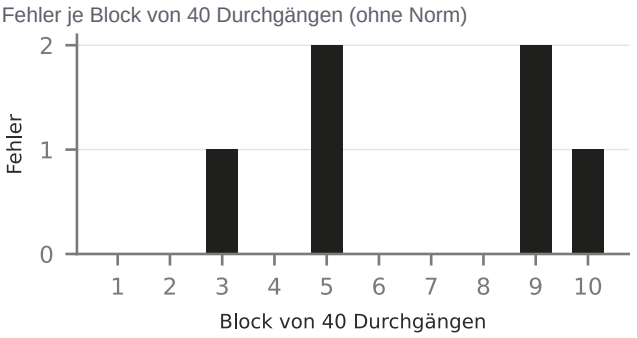

Auslassungsfehler: 2, nicht markiert (Perzentil 46). BEH-IN-2

Fehlreaktionen (Kommissionsfehler): 4, nicht markiert (Perzentil 81). BEH-IN-2


Mittlere Reaktionszeit: 409 ms, nicht markiert (Perzentil 47). BEH-IN-2

Variabilität der Reaktionszeit (SD): 86 ms, nicht markiert (Perzentil 42). BEH-IN-2


12. Vergleich der Messungen

Messgröße	Früher 12.03.2026	z	Aktuell 15.09.2026	z
Auslassungsfehler	3	0.3	2	-0.1
Fehlreaktionen (Kommissionsfehler)	5	1.2	4	0.9
Mittlere Reaktionszeit	421 ms	0.1	409 ms	-0.1
Variabilität der Reaktionszeit (SD)	95 ms	0.1	86 ms	-0.2
Theta/Beta-Quotient an Cz, Augen offen	2,81	0.0	2,42	-0.4
Alpha-Peak-Frequenz (Hz), Augen offen	9,1	0.1	9,2	0.2
Theta/Beta-Quotient an Cz, Augen geschlossen	2,88	-0.1	2,56	-0.4
Alpha-Peak-Frequenz (Hz), Augen geschlossen	9,1	-0.1	9,3	0.2

Früher 12.03.2026: Absolute Leistung, z gegen die Altersnorm, Augen geschlossen



Aktuell 15.09.2026: Absolute Leistung, z gegen die Altersnorm, Augen geschlossen

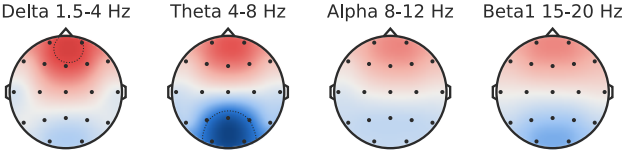

Relative Theta-Leistung an Pz, Augen offen: z = -4,0 am 12.03.2026, z = -4,6 am 15.09.2026. CMP-1

Beta1-Kohärenz T3-T5, Augen geschlossen: z = 4,5 am 12.03.2026, z = 3,8 am 15.09.2026. CMP-1

Relative Theta-Leistung an Pz, Augen geschlossen: z = -3,9 am 12.03.2026, z = -4,4 am 15.09.2026. CMP-1

Beta1-Kohärenz C3-P3, Augen geschlossen: z = 4,4 am 12.03.2026, z = 3,7 am 15.09.2026. CMP-1

Beta1-Kohärenz P3-O1, Augen geschlossen: z = 4,4 am 12.03.2026, z = 3,9 am 15.09.2026. CMP-1

Beta1-Kohärenz T3-C3, Augen geschlossen: z = 4,3 am 12.03.2026, z = 3,8 am 15.09.2026. CMP-1

Die frühere Messung vom 12.03.2026 wurde mit der aktuellen Software und den aktuellen Normen erneut ausgewertet (V4 mockup 0.1; Mock norms 2026.1 (synthetisch)). L-REPROC-1

Die Messungen stehen nebeneinander, jede gegen ihre eigene Altersnorm; Unterschiede zwischen ihnen werden nicht auf statistische Signifikanz geprüft. L-SIDE-1

13. Hinweise zu den Ergebnissen

Die Ergebnisse sind ein Baustein der klinischen Beurteilung. Die Software stellt keine Diagnose und gibt keine Therapieempfehlung. L-AID-1

z ist der Abstand eines Werts vom normativen Mittelwert in Standardabweichungen der Normstichprobe; etwa 95 % der Normstichprobe liegen zwischen z = -2 und z = 2. L-Z-1

Markierte Werte weichen nach Korrektur für multiple Vergleiche von der Altersnorm ab; die Korrektur hält Zufallsergebnisse unter den vielen Vergleichen selten. Ein nicht markierter Wert jenseits von 2 z kann allein durch Zufall abweichen. Die Korrekturmethode ist noch festzulegen. L-MC-1

14. Interpretation

Platzhalter für den Text der Klinikerin oder des Klinikers. Geschrieben im V4-Berichtseditor; das System schreibt hier nicht.

15. Schlussfolgerung

Platzhalter für den Text der Klinikerin oder des Klinikers. Geschrieben im V4-Berichtseditor; das System schreibt hier nicht.

Freigabe

Freigegeben von	_____ (wird bei der Freigabe durch die Klinikerin oder den Kliniker eingetragen)
Datum der Freigabe	_____ (wird bei der Freigabe durch die Klinikerin oder den Kliniker eingetragen)
Version	1 · Entwurf, nicht freigegeben
Ersetzt	keine, erste Version