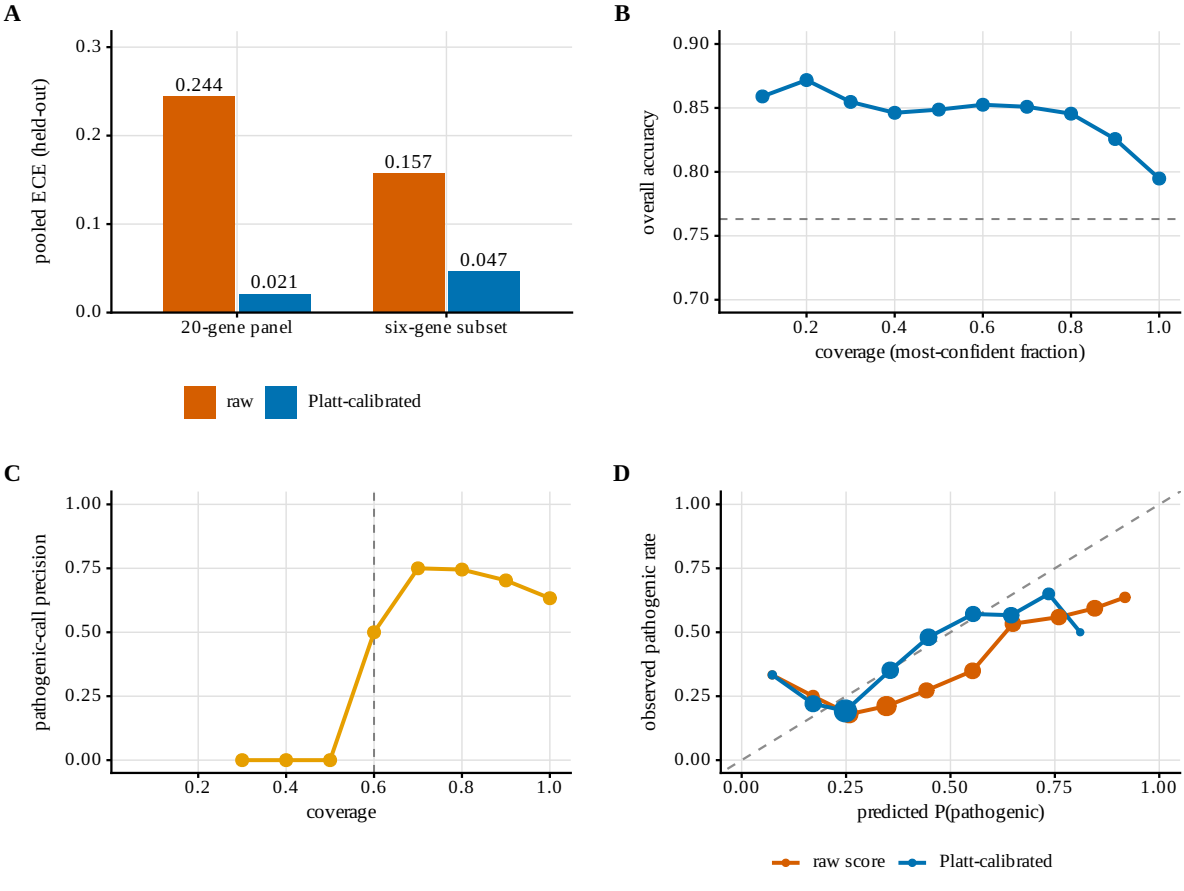
A
pooled ECE (held-out)
0.3
0.2
0.1
0.0
0.244
0.021
0.157
0.047
20-gene panel
six-gene subset
raw
Platt-calibrated
B
overall accuracy
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
coverage (most-confident fraction)
C
pathogenic-call precision
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
coverage
D
observed pathogenic rate
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
predicted P(pathogenic)
raw score
Platt-calibrated