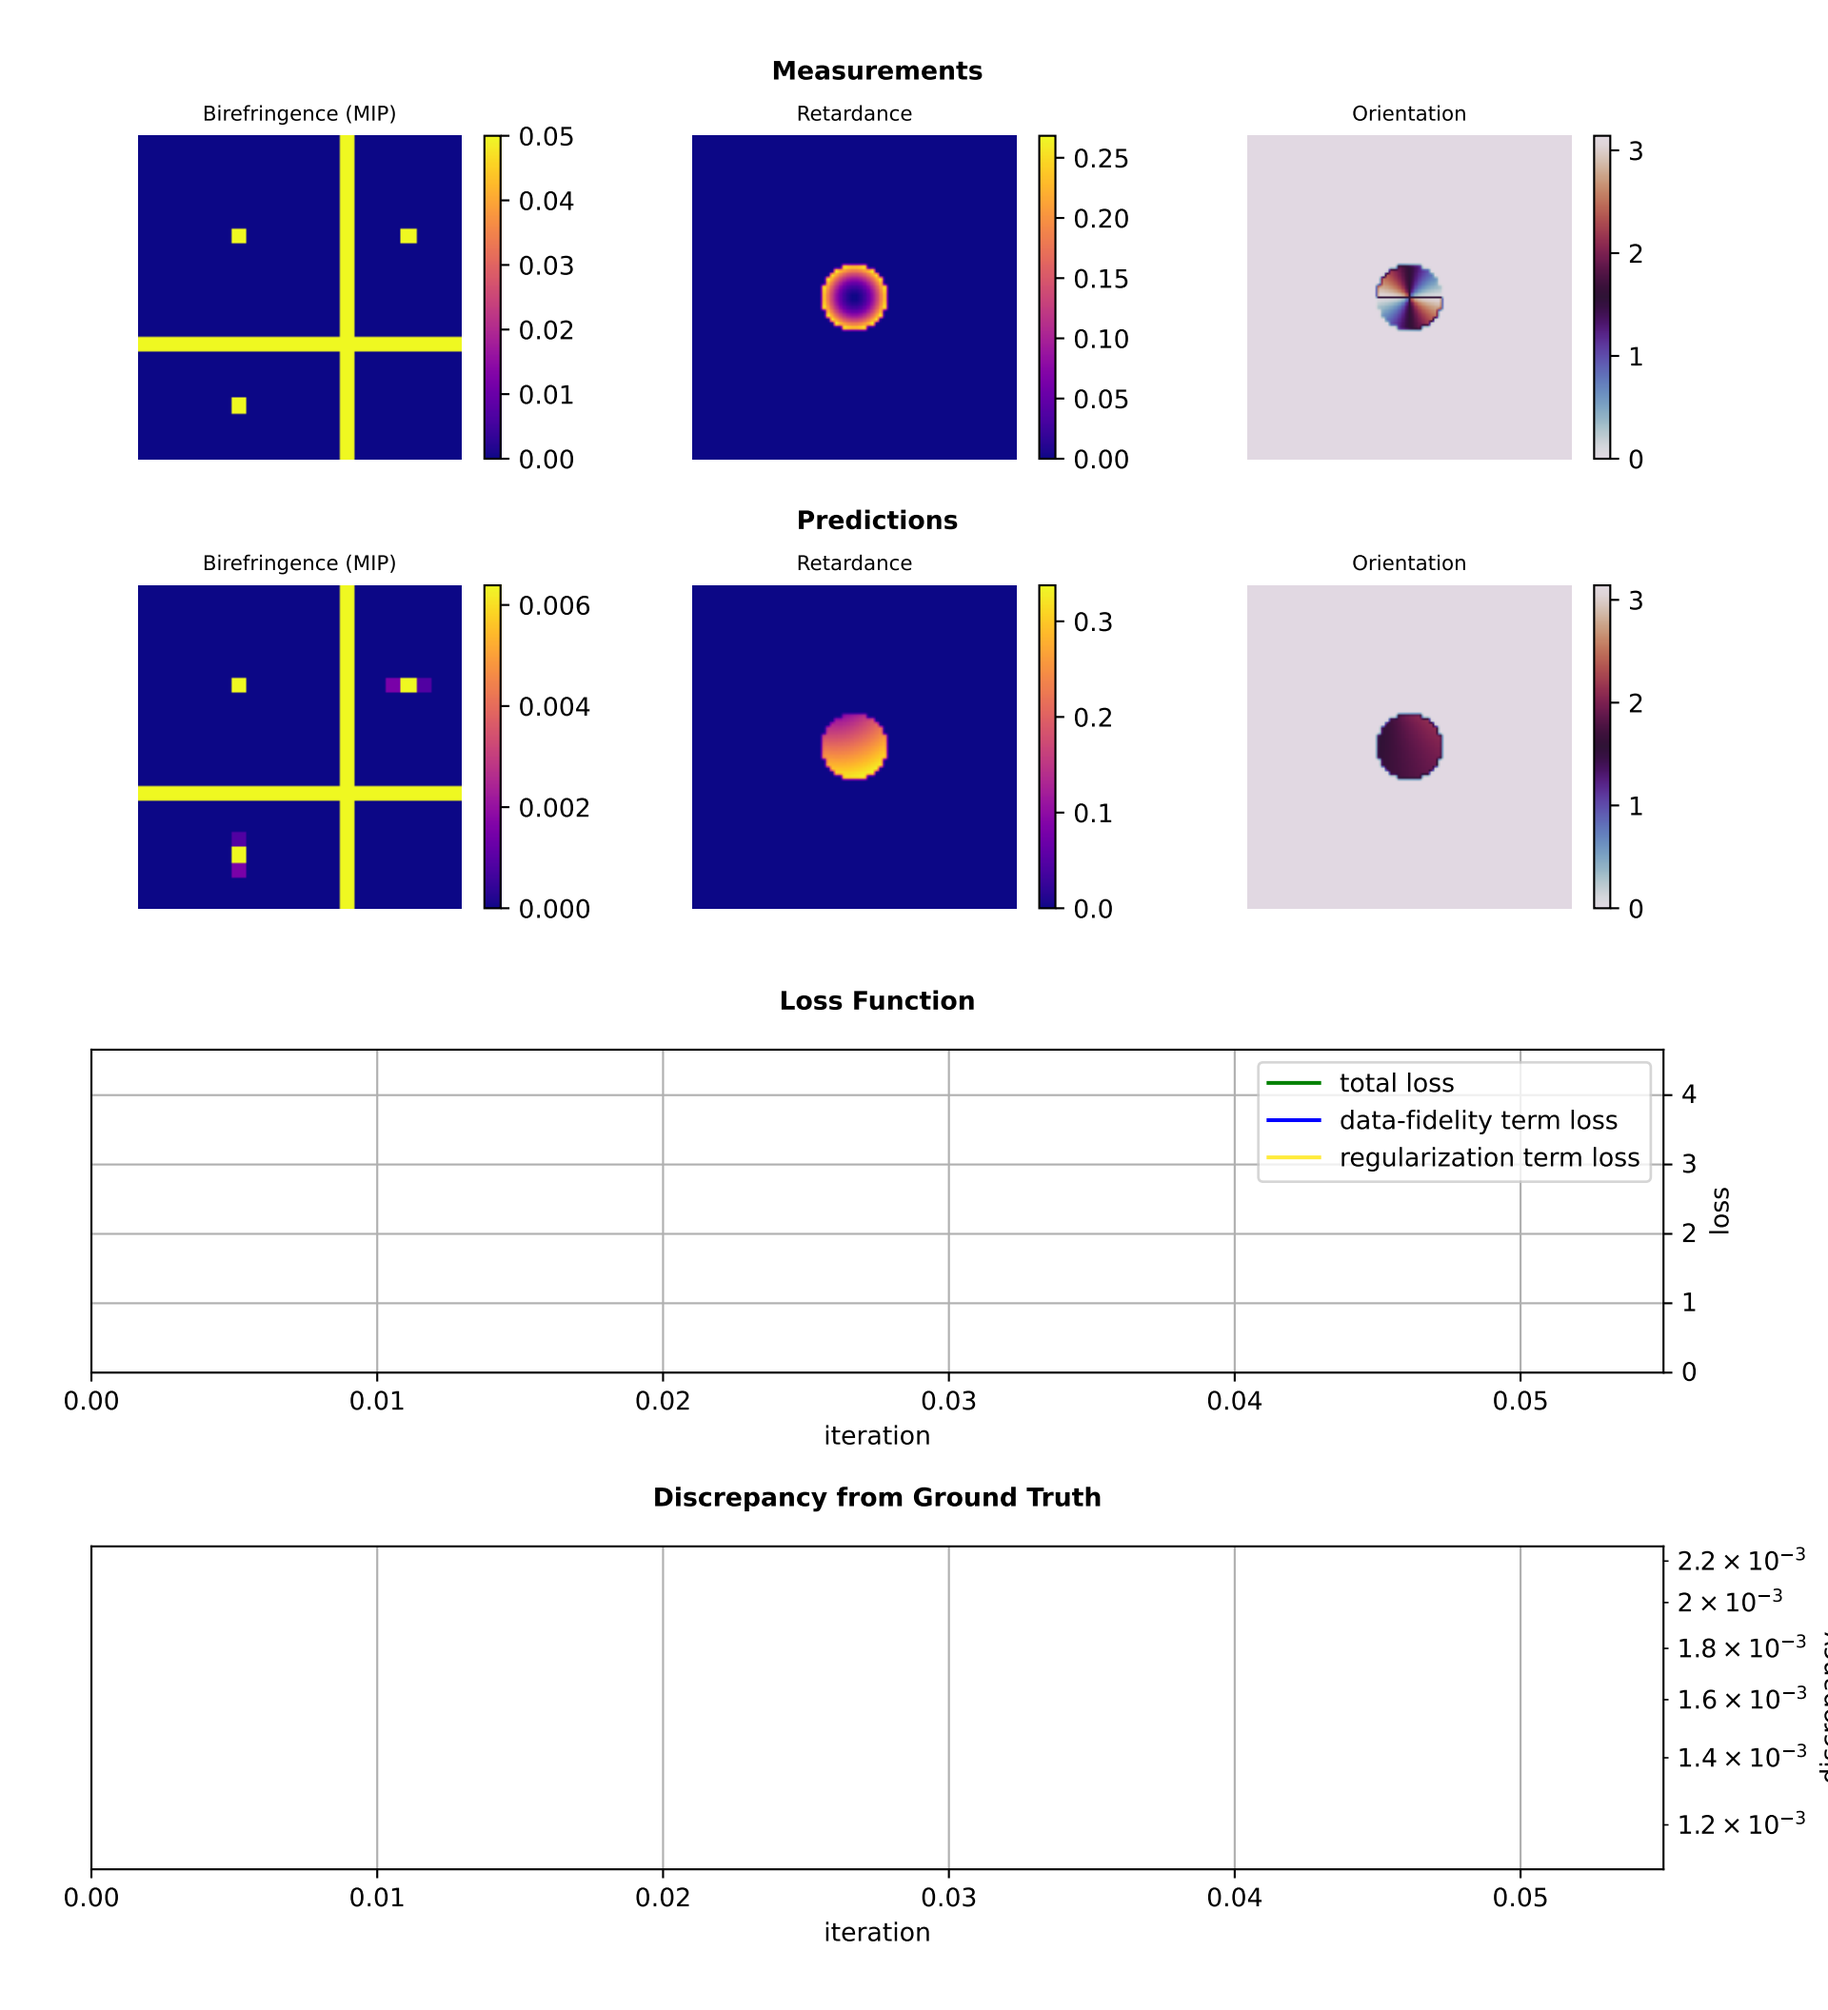
Measurements
Birefringence (MIP)
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
Retardance
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Orientation
3
2
1
0
Predictions
Birefringence (MIP)
0.006
0.004
0.002
0.000
Retardance
0.3
0.2
0.1
0.0
Orientation
3
2
1
0
Loss Function
total loss
data-fidelity term loss
regularization term loss
loss
4
3
2
1
0
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
iteration
Discrepancy from Ground Truth
2.2×10^{-3}
2×10^{-3}
1.8×10^{-3}
1.6×10^{-3}
1.4×10^{-3}
1.2×10^{-3}
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
iteration