B

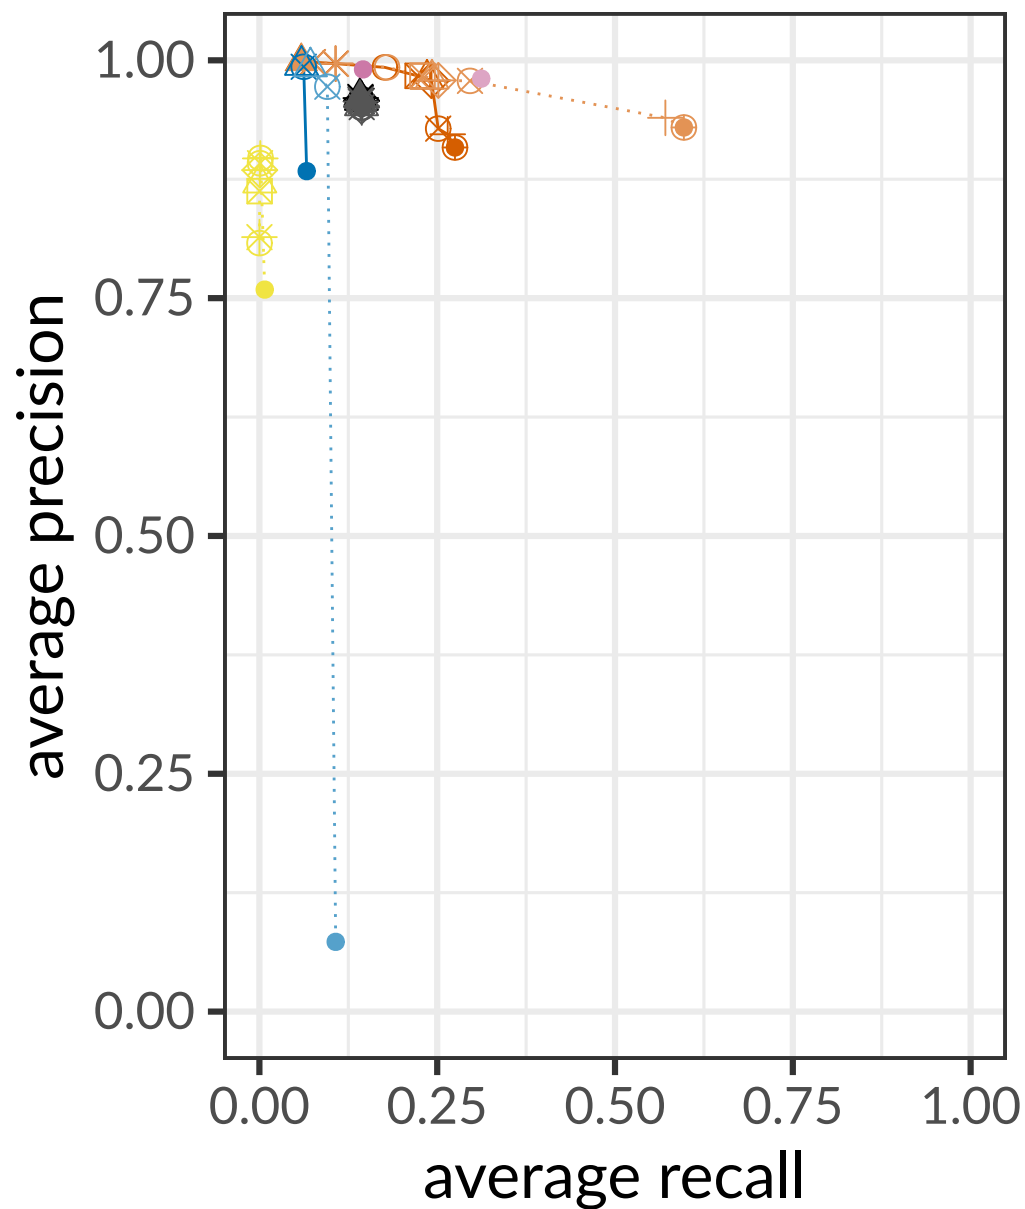## 5 granulocytes

software

— ● MonoVar default
⋯ ● MonoVar no consensus
— ● ProSolo default
⋯ ● ProSolo imputation
⋯ ● SCAN-SNV sensitive
— ● SCcaller default dbsnp
⋯ ● SCcaller sensitive dbsnp
— ● SCIPhI default
⋯ ● SCIPhI sensitive

threshold used

▲ 1e-06
✕ 1e-05
✳ 1e-04
○ 0.001
⊠ 0.005
△ 0.01
⬦ 0.02
⊗ 0.05
+ 0.1
⊕ 0.2
• 1

average recall

average precision